


2025 08 12, 08:58

Real Tempo Modo

1.0mm/mV

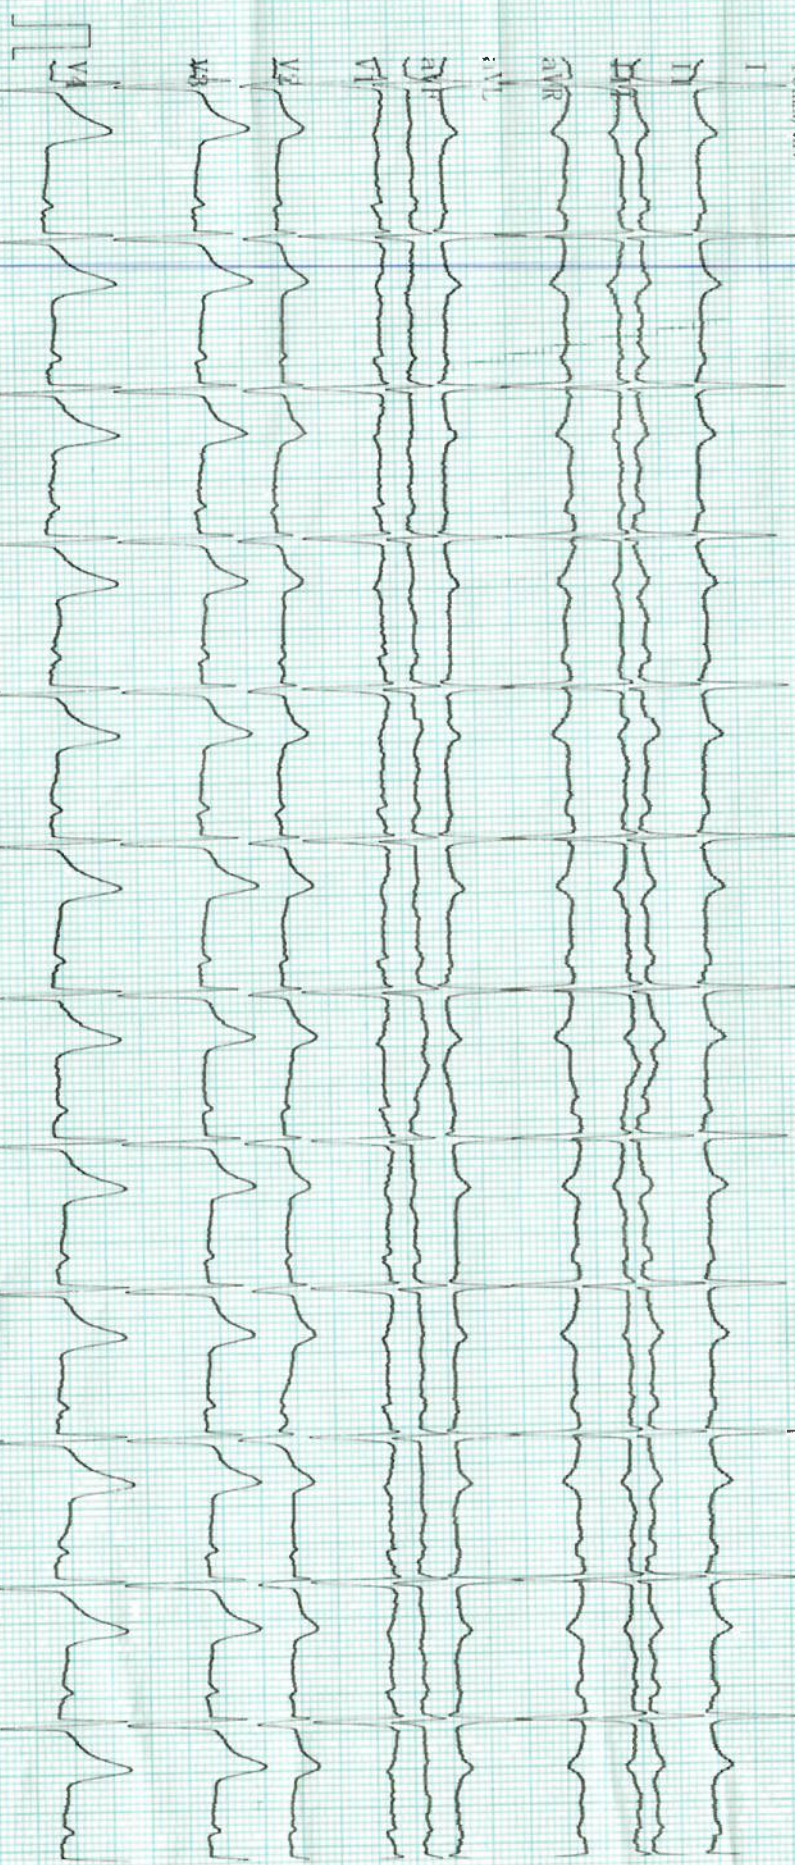

carlos Ribeiro de Jesus

Velocidade: 25mm/s Filtro: H30 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARE ECG 1200 V4.06.000