


Carlos Henrique Inácio dos Santos Costa.
20 anos

2025-07-01, 09:53

Real Tempo Modo

1.0mm/mV

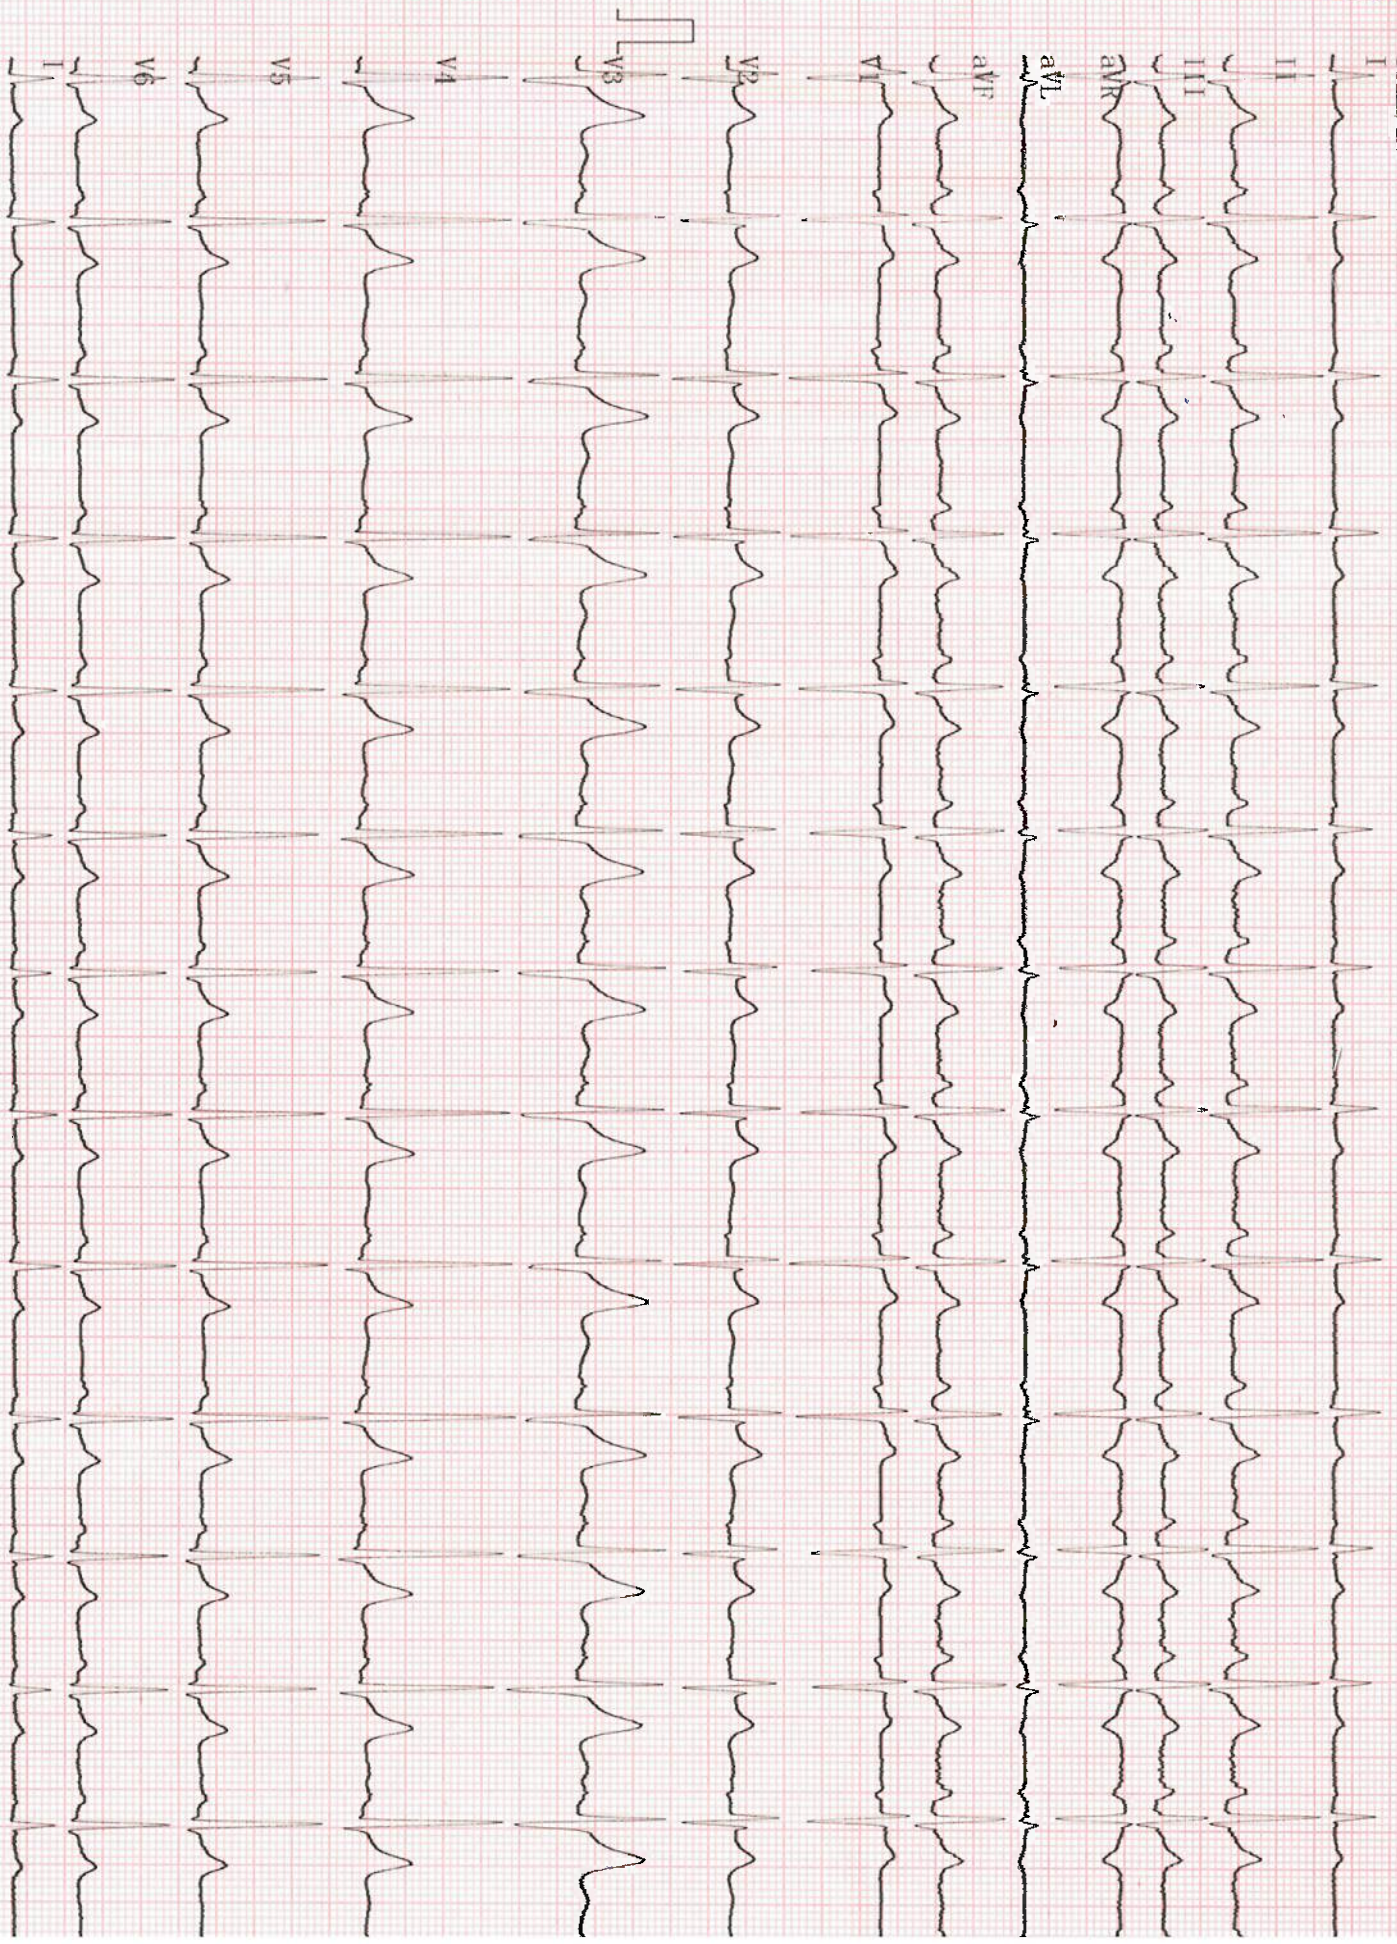

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARD ECG 1200 V4.06.000