


loucas da silva Nascimento

2025-07-28, 09:50

Real - Tempo Modo

10mm/mV

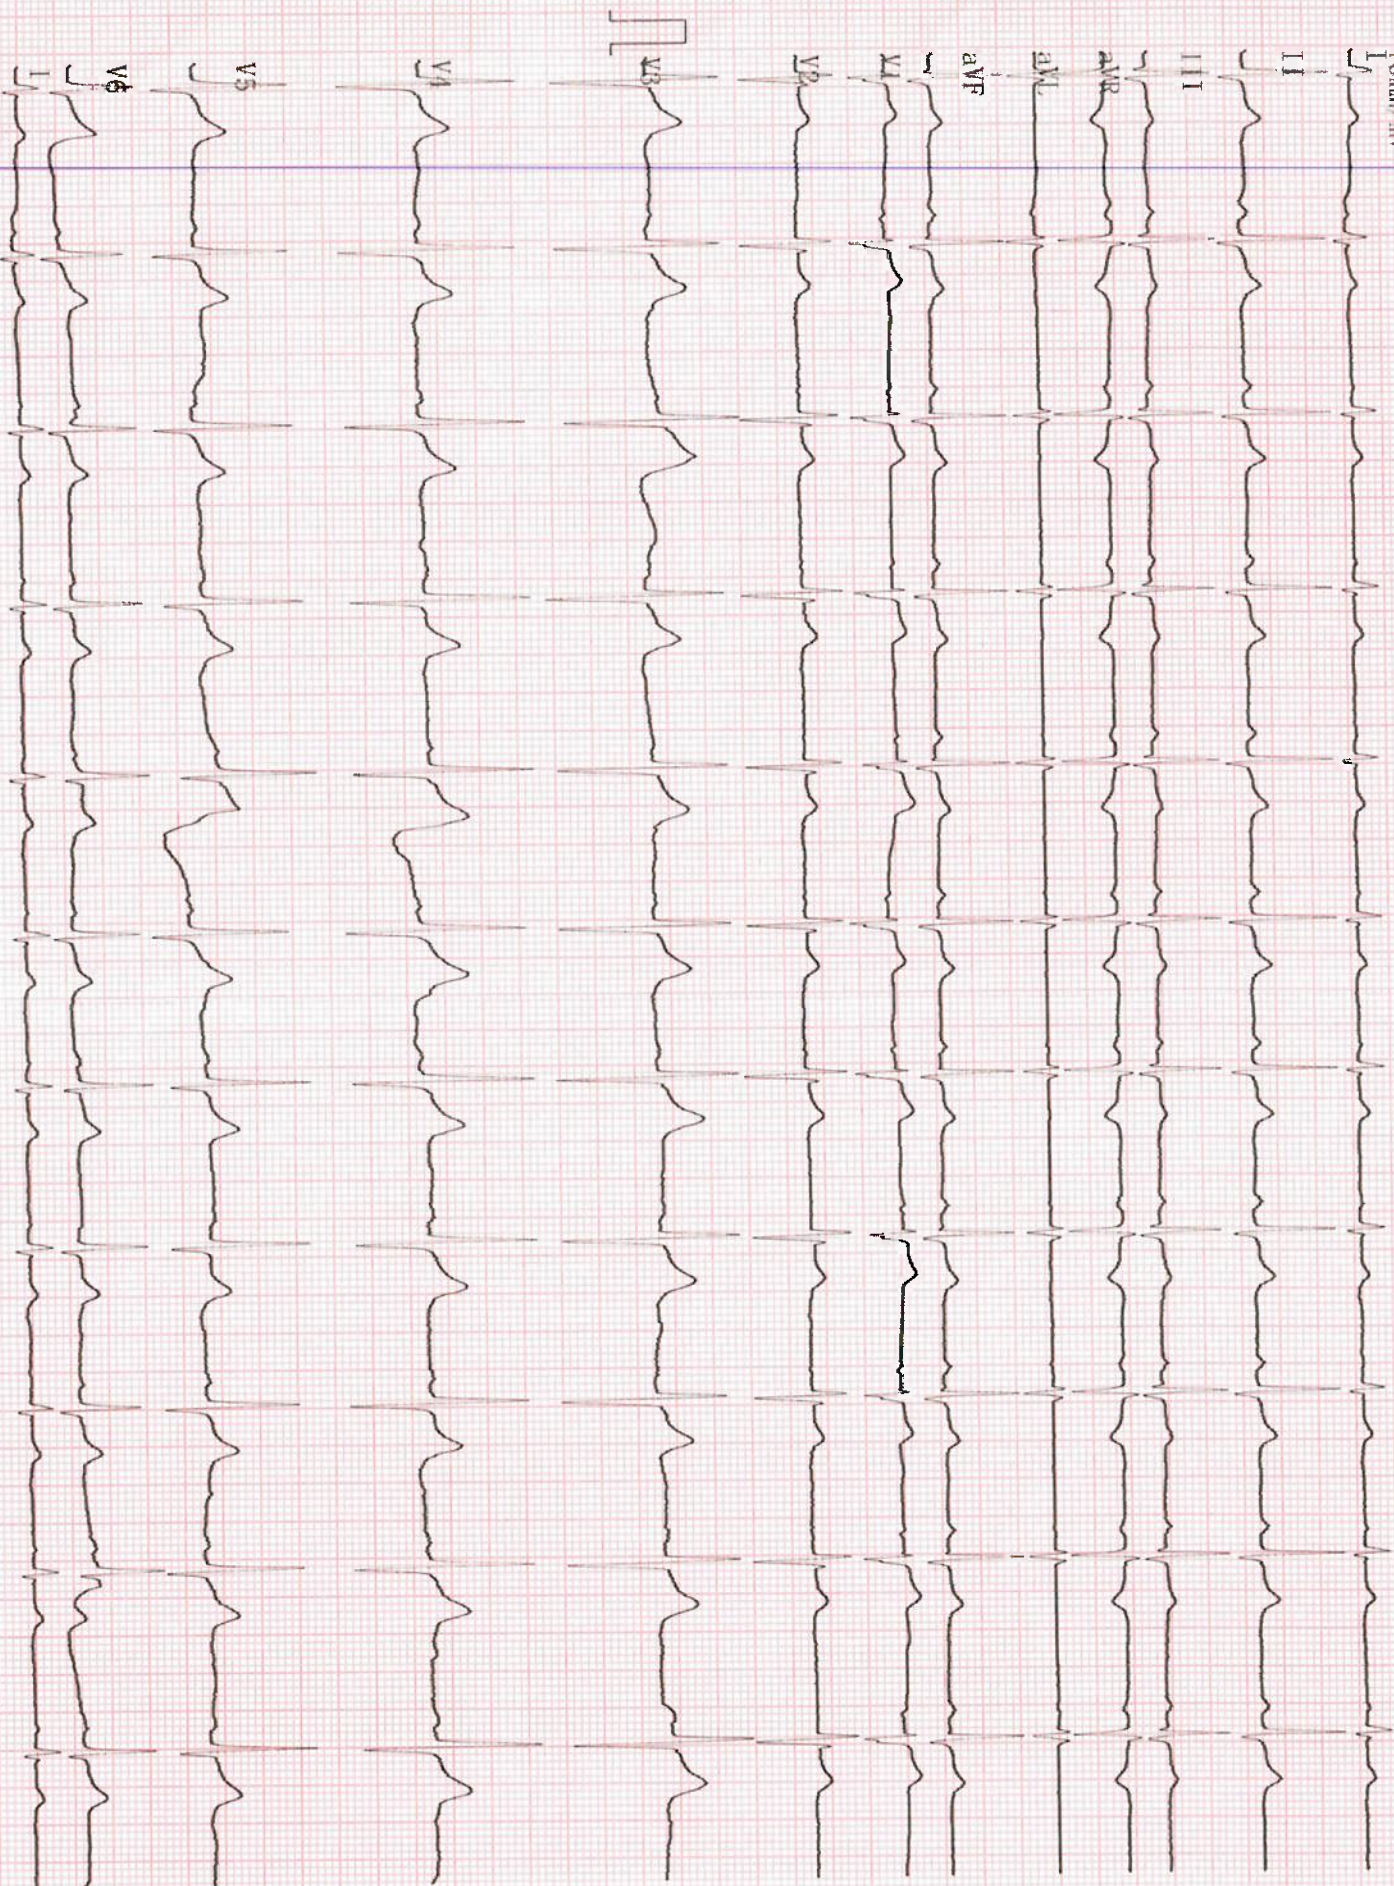

Velocidade: 25mm/s

Filtro: H50 d 35Hz

AC: 50 Hz

BIOCARE

ECG-1200

V4.06.000