


João Lopes dos Santos

2025 08 12, 08:44

Real-Time Modo

10mm/mV

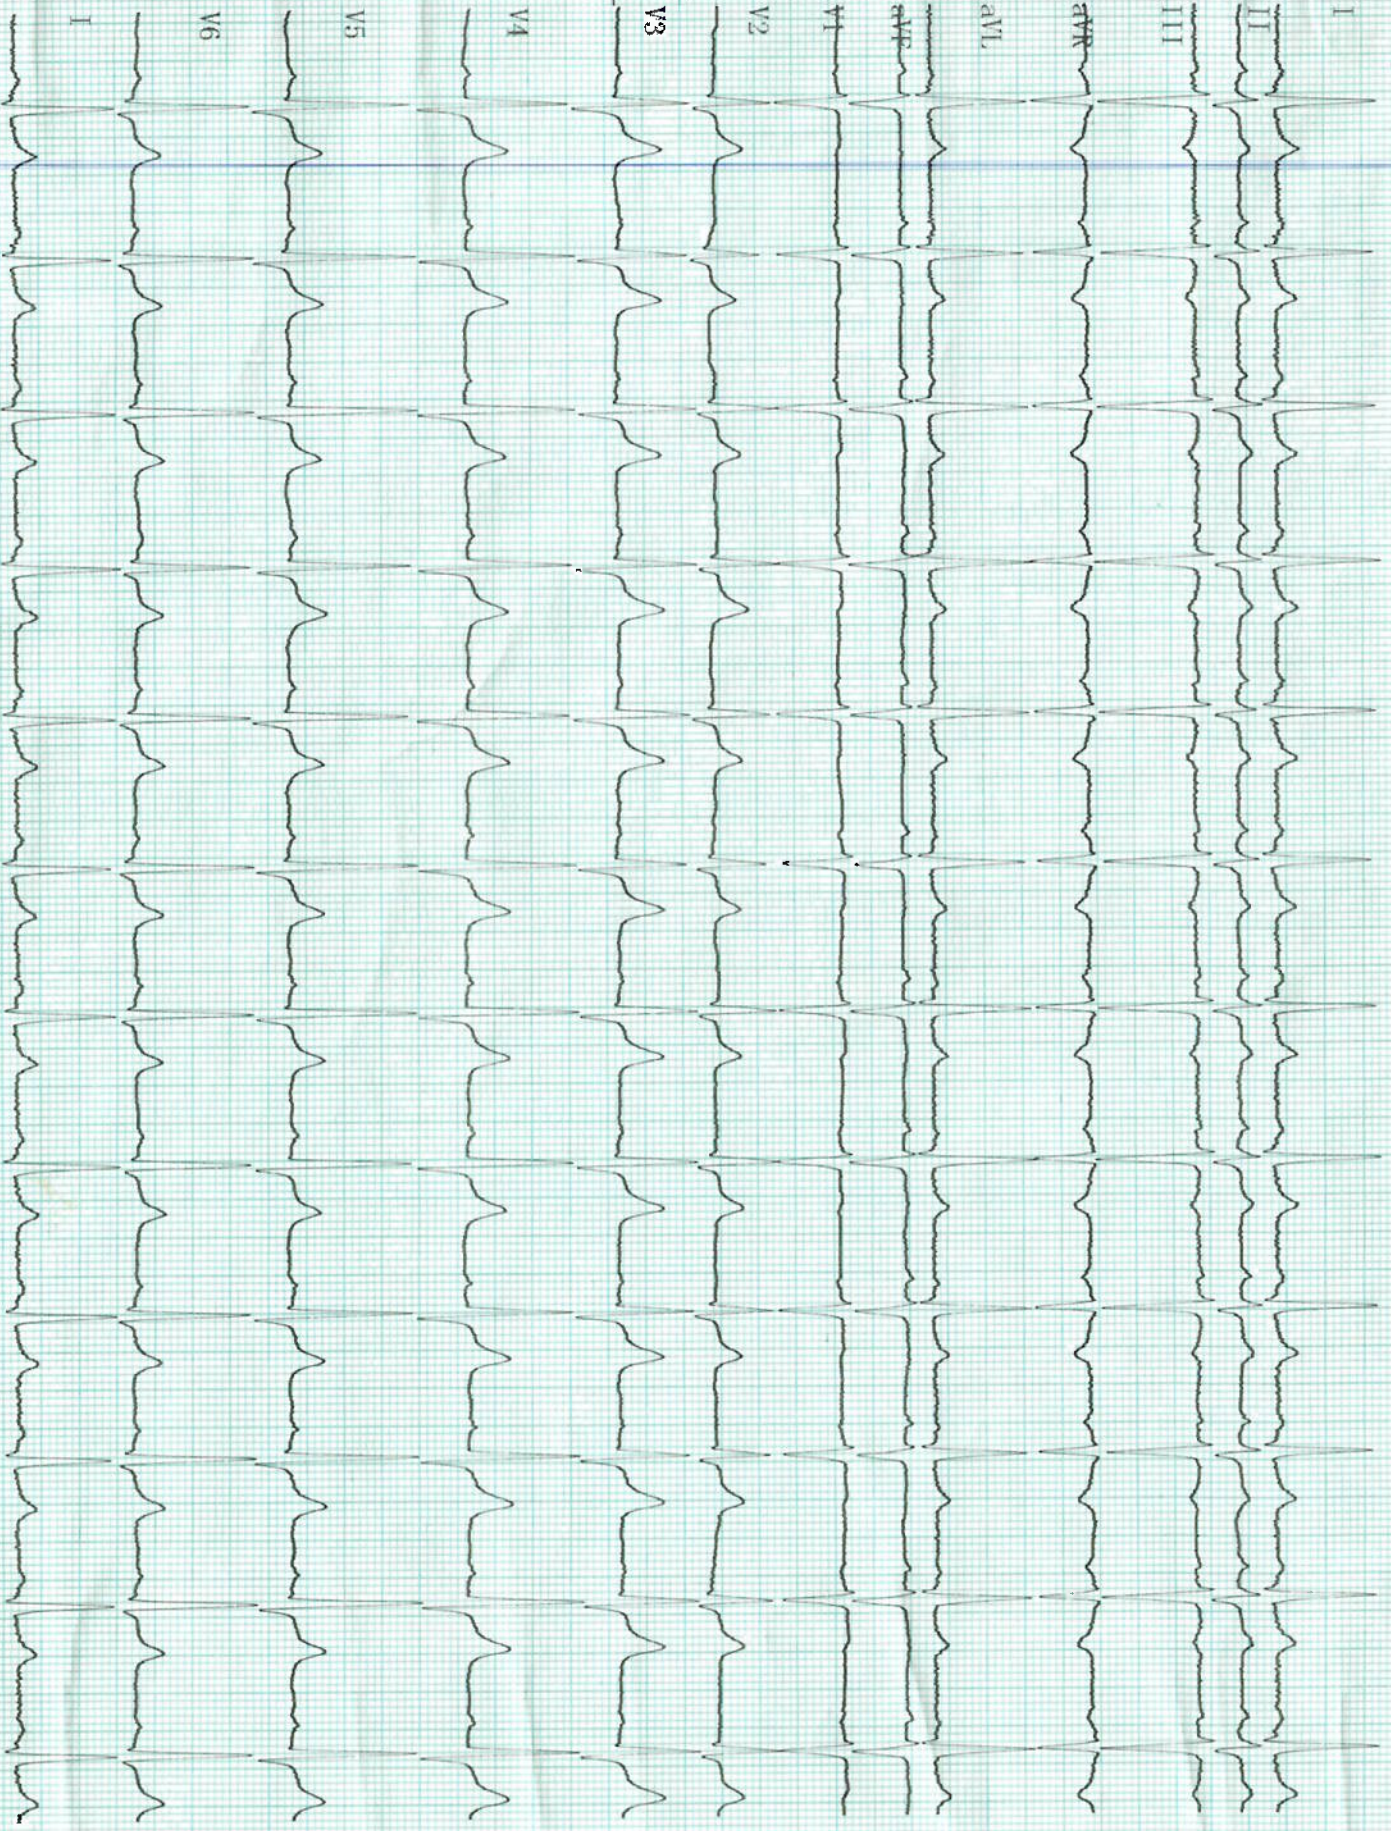

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARD ECG-1200 VA. 06.000