


Benton de Souza Barbosa DN. 20/03/1991

Real Tempo Modo

10mm/mV

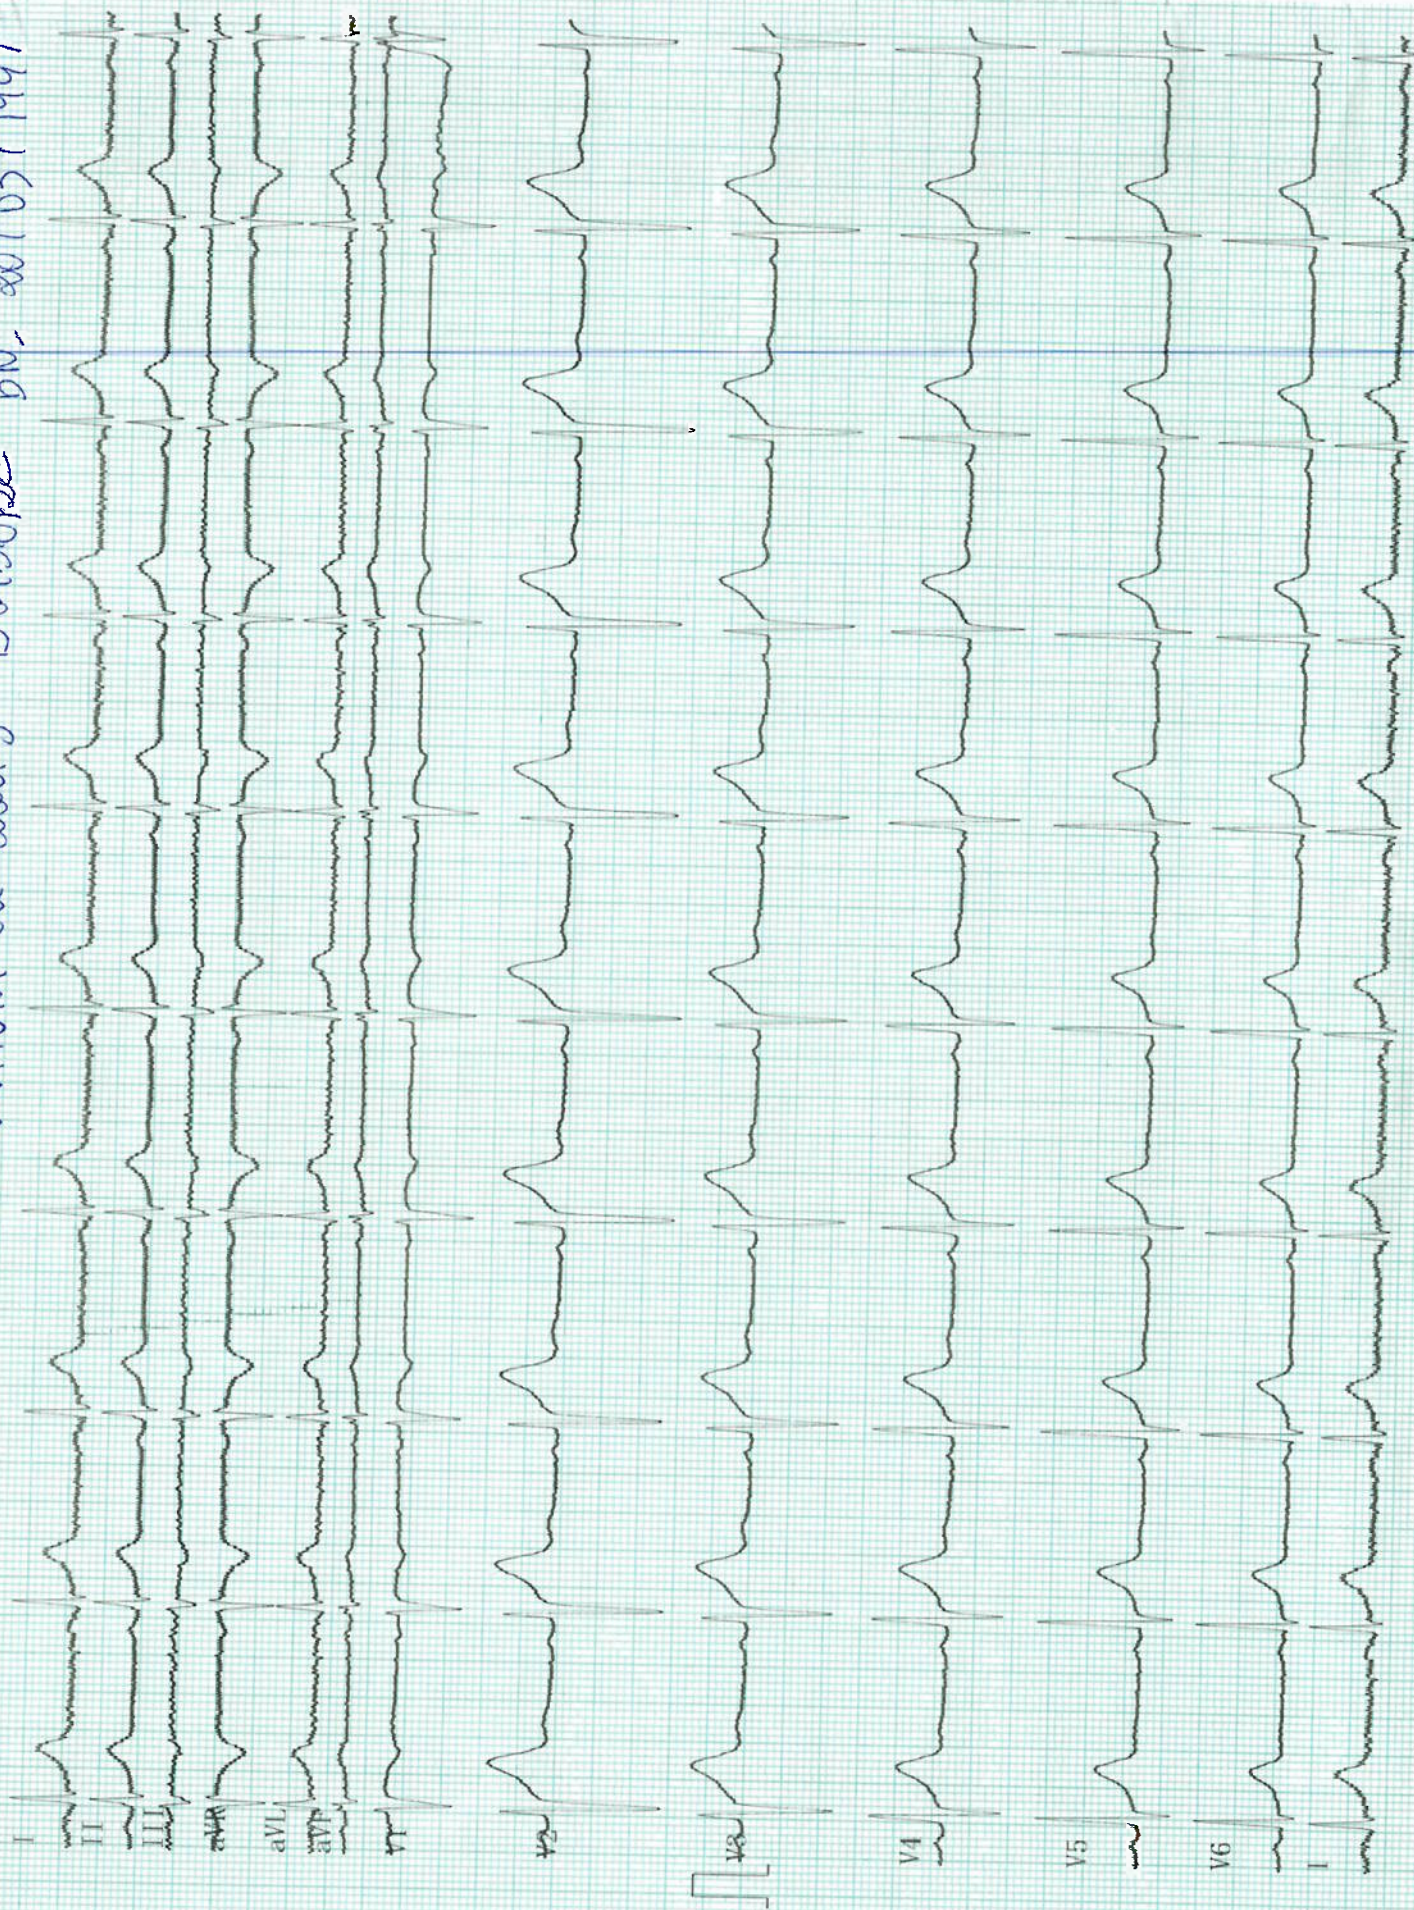

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIO CARE ECG-1200 V4.06.000