


Real Tempo Modo

10mm/mV

Paulson Jose da Silva DN- 18/08/1992

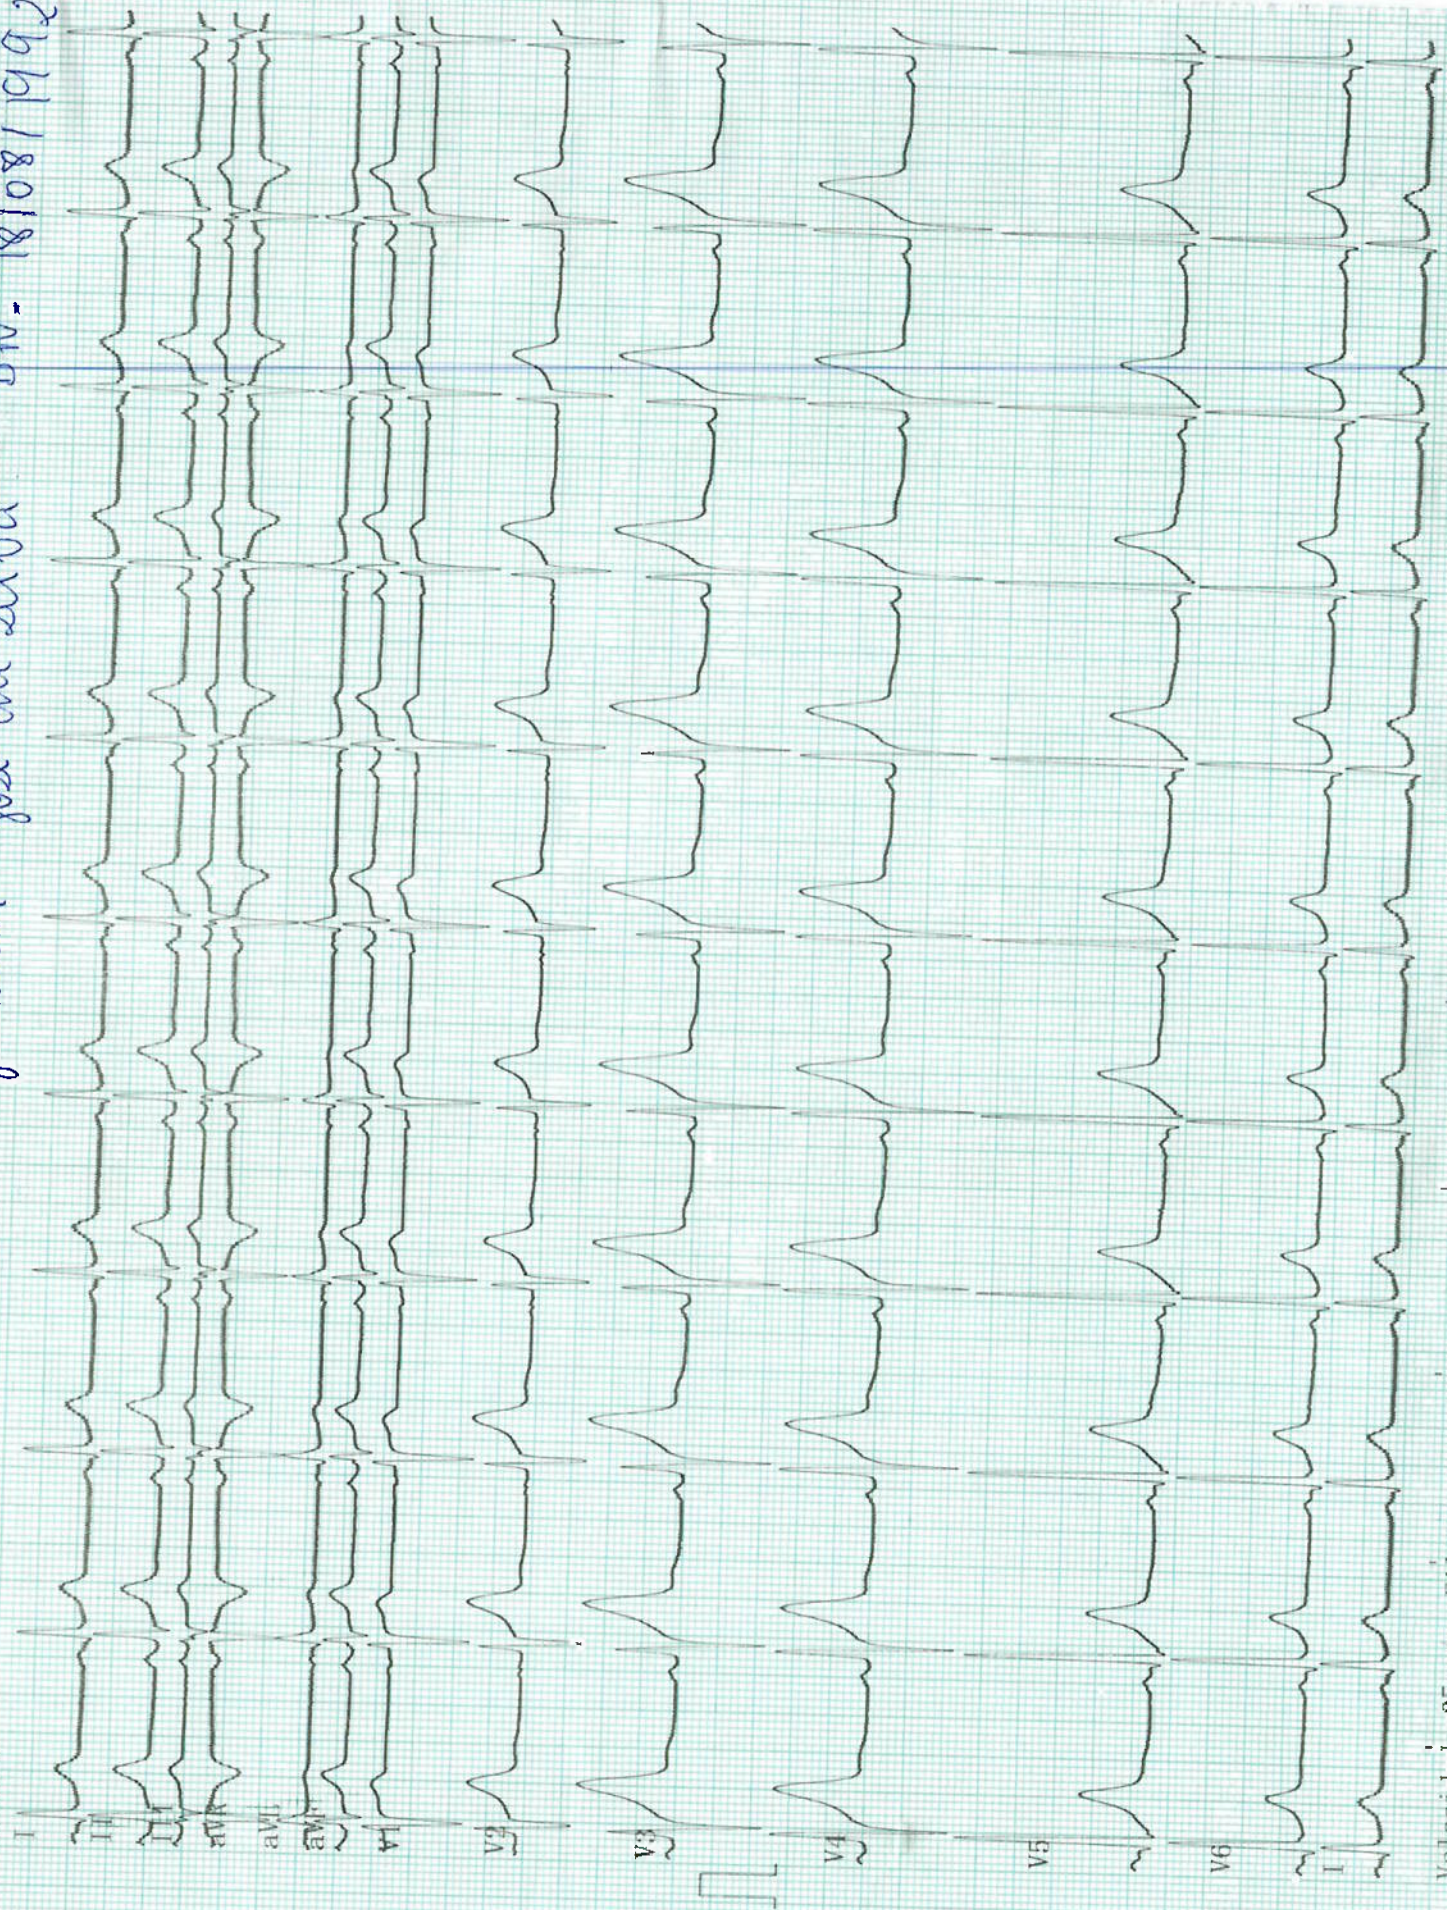

Velocidade: 25mm/s Filtro: 150 d 35Hz AC: 50 Hz BIOGARE ECG-1200 V4.06.000