

# SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

**ID:** 6938596  
**Nome:** ROMILDO DE FRANÇA FERREIRA  
**Idade:** 38 anos 5 meses **DN:** 20/02/1987 **Data de exame:** 30/07/2025 05:51  
**Altura:** 166 cm **Peso:** 76 kg **IMC:** 27,6  
**Sexo:** Masculino **Etnia:** Caucasiana **Factor:** 100  
**Fumante:** Não **Dispneia:** 0

## Resumo de todos os testes forçados

	VEF1	CVF	PFE	VEF1/CVF	Qualidade	VAR	Tempo	Data
Base	2,46	3,06	4,43	80%	Bom sopro	-5%	05:51	30/07/2025
<b>Base*</b>	<b>2,61</b>	<b>3,21</b>	<b>6,71</b>	<b>81%</b>	<b>Bom sopro</b>		<b>05:52</b>	<b>30/07/2025</b>
Base	2,60	3,06	6,82	85%	Bom sopro	-3%	05:53	30/07/2025
Base	2,60	3,04	7,29	86%	Bom sopro	-3%	05:53	30/07/2025

Chave: \* - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

## Índices seleccionados dos melhores sopros

Índice	Base	% Prev.	Valo rZ	Pós1	% Prev.	%alt	Valo rZ	[Mín. Prev. Máx.]	DP
VEF1	(2,61 l)	68%						3,10 l 3,86 l 4,62 l	
VEF6	(3,21 l)	70%						3,73 l 4,60 l 5,47 l	
CVF	(3,21 l)	70%						3,72 l 4,62 l 5,52 l	
VEF1/CVF	81%	97%						76% 84% 91%	
PFE	(6,71 l/s)	61%						8,35 l/s 10,98 l/s 13,62 l/s	
FEF50	3,39 l/s	67%						3,06 l/s 5,09 l/s 7,13 l/s	
FEF25-75	2,51 l/s	60%						2,48 l/s 4,20 l/s 5,92 l/s	
FEF25-75/CVF	78 /s	86%						58 /s 91 /s 124 /s	
TEF	4,19 s								


Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais

relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


**Fonte prevista:** Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos, Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

### Gráfico de volume de fluxo melhor

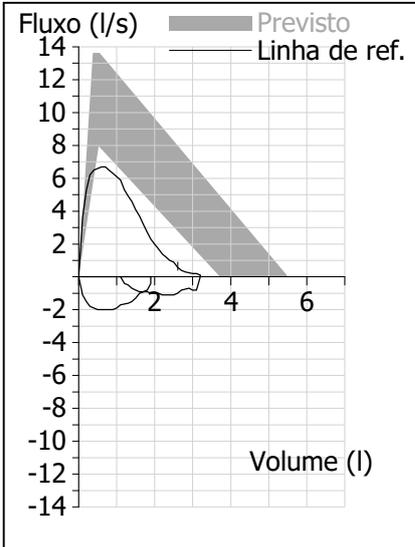

### Melhor gráfico de volume/tempo

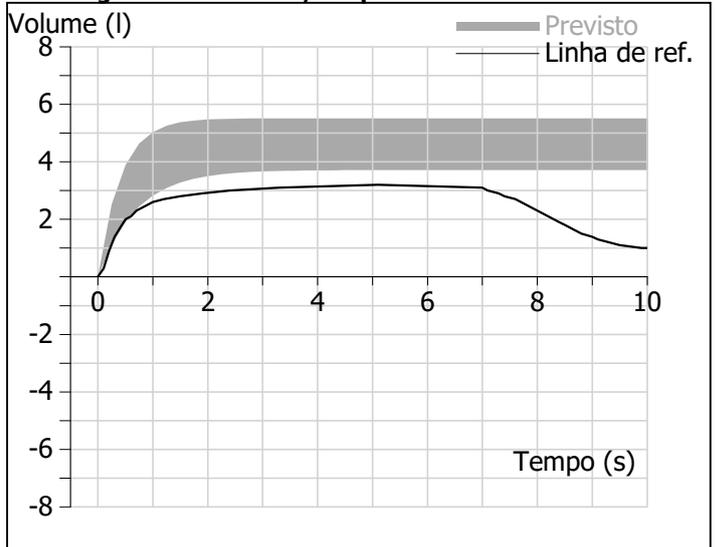

### Notas de exame

QUALIDADE DO EXAME: A