


2025 07 21 08:26

Real-Tempo Modo

Israel dos Santos Oliveira 20 anos

10mm/mV

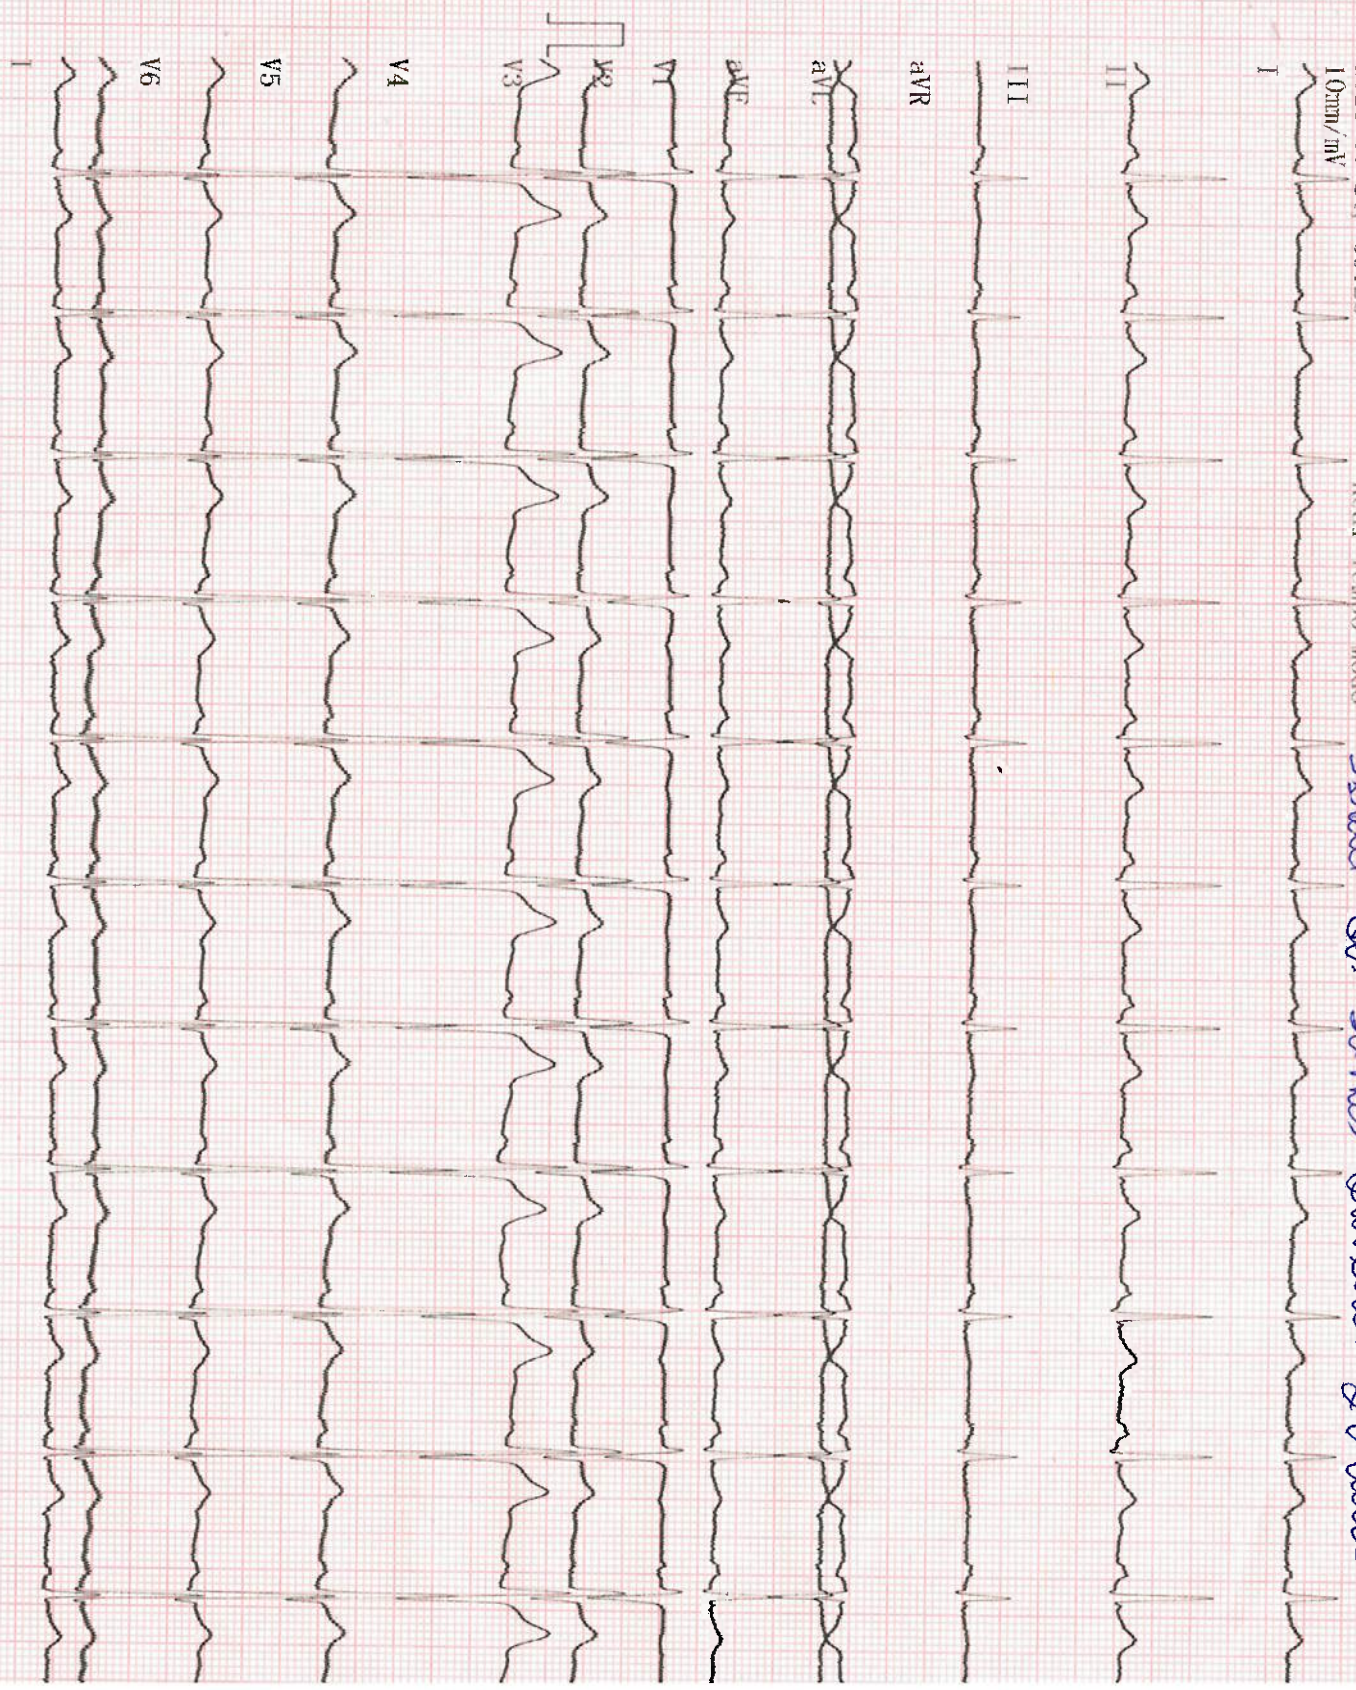

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARE ECG-1200 V4.06.000