


10:54:39

Monitorización Ritmo 12Canales

Heart Rate: 64bpm

Hospital:
Confirmado por:

: 025-
ID
Nombre

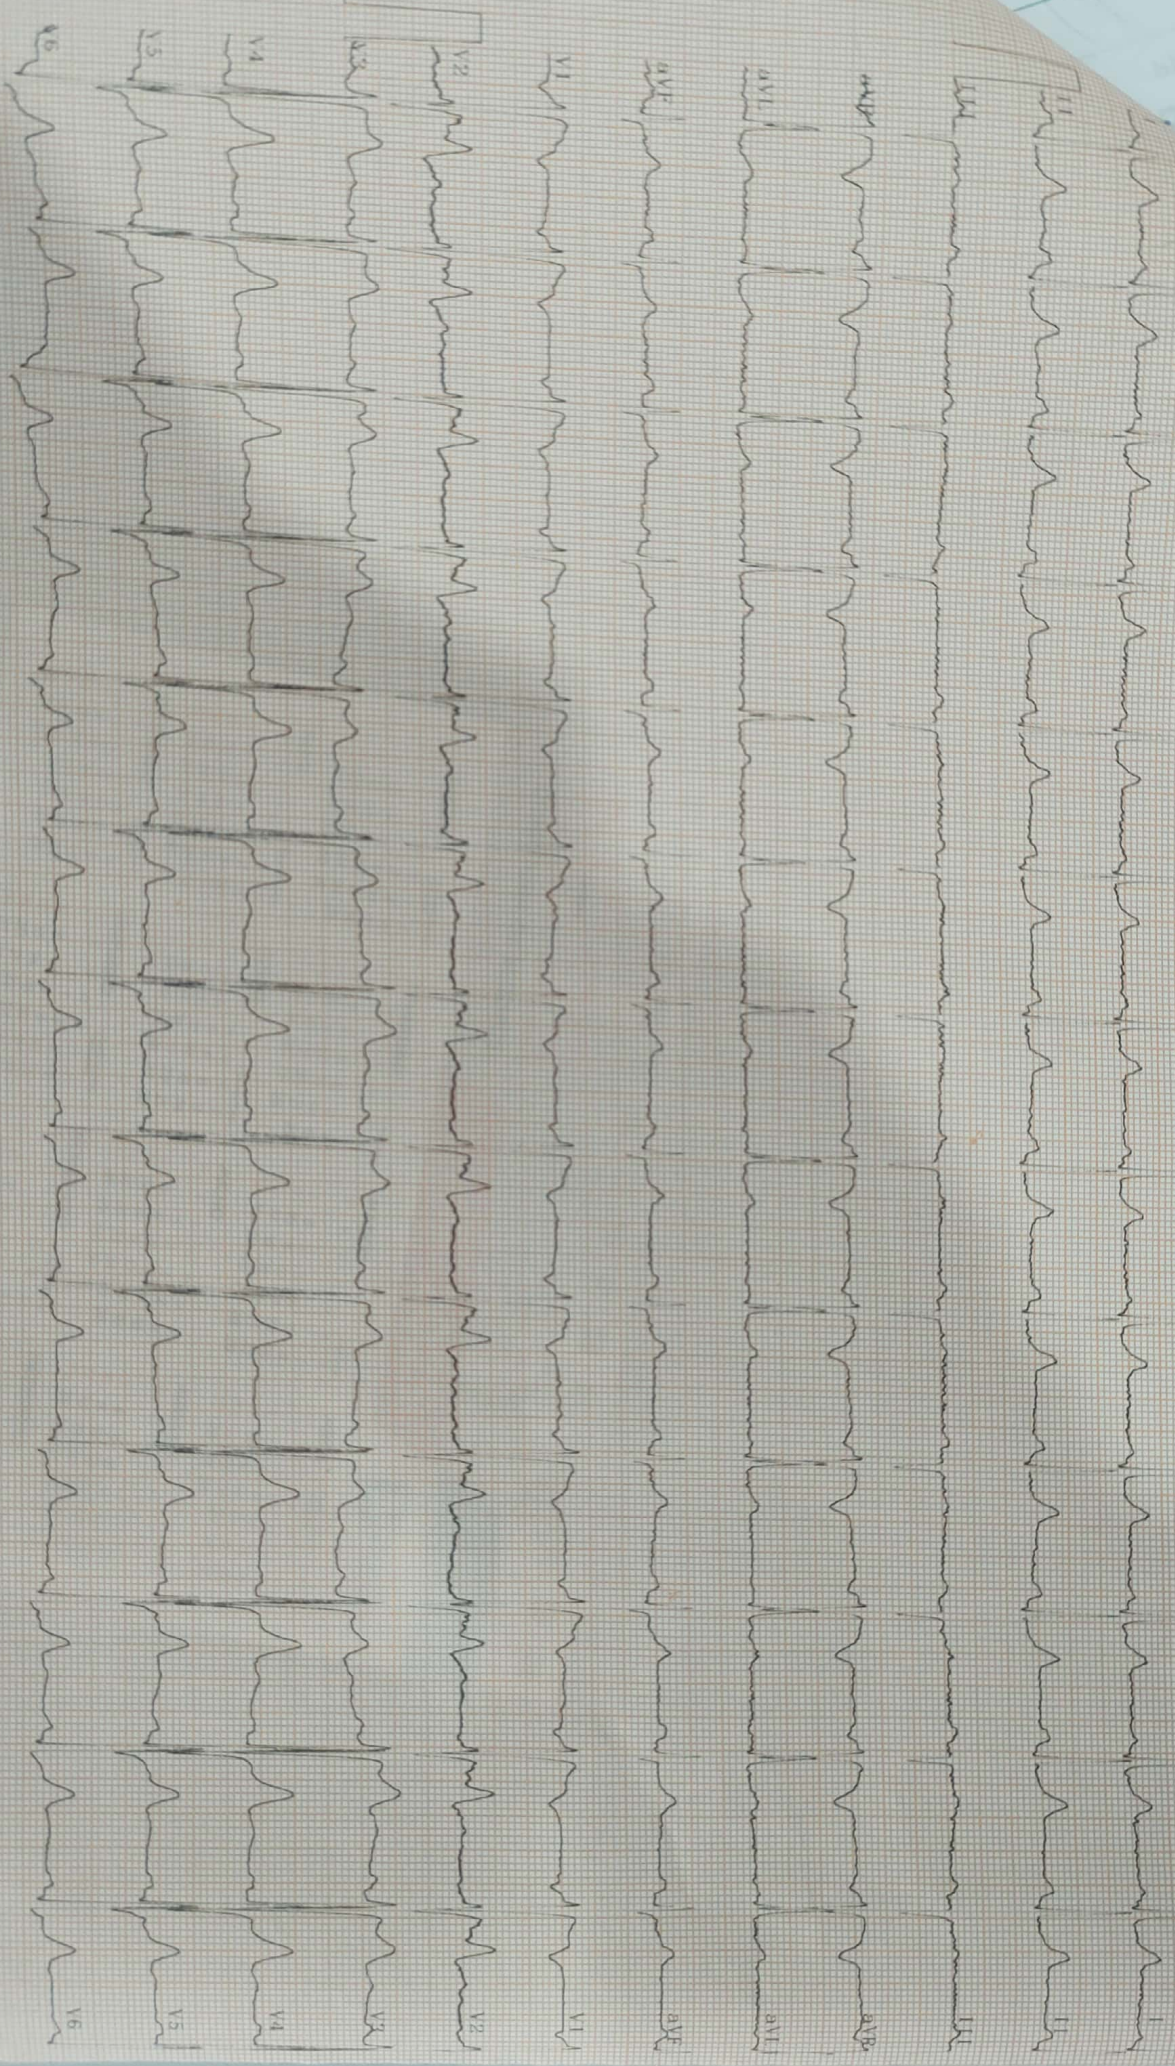

Calibración: 20.0mm/V, 25.0cm/seg.

ENG2000 Ver3.06M.30 Bionet Co., Ltd.

0.1Hz