

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

ID: 6761402
Nome: SILMAR FRAZAO DA SILVA
Idade: 37 anos 10 meses DN: 15/09/1987 Data de exame: 05/08/2025 08:09
Altura: 170 cm Peso: 73 kg IMC: 25,3
Sexo: Masculino Etnia: Não caucasiana Factor: 100
Fumante: Não Dispneia: 0
Exame solicitad... INDORAMA Profissão: ENGENHEIRO MECANICO

Resumo de todos os testes forçados

	VEF1	CVF	PFE	VEF1/CVF	Qualidade	VAR	Tempo	Data
Base	3,35	3,75	9,25	89%	Bom sopro	-2%	08:10	05/08/2025
Base	3,33	3,75	6,64	89%	Bom sopro	-2%	08:10	05/08/2025
Base	3,02	3,10	3,79	97%	Término abrupto	-16%	08:11	05/08/2025
Base	3,06	3,63	3,58	84%	Início lento	-8%	08:12	05/08/2025
Base*	3,34	3,91	9,68	85%	Bom sopro		08:14	05/08/2025

Chave: * - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

Índices seleccionados dos melhores sopros


Índice	Base	% Prev.	Valo rZ	Pós1	% Prev.	%alt	Valo rZ	[Mín.	Prev.	Máx.]	DP
VEF1	3,34 l	83%						3,26 l	4,02 l	4,78 l	
VEF6	(3,91 l)	81%						3,96 l	4,83 l	5,70 l	
CVF	(3,91 l)	81%						3,94 l	4,84 l	5,74 l	
VEF1/CVF	85%	103%						76%	83%	91%	
PFE	9,68 l/s	86%						8,54 l/s	11,24 l/s	13,93 l/s	
FEF50	4,75 l/s	92%						3,10 l/s	5,16 l/s	7,23 l/s	
FEF25-75	3,83 l/s	90%						2,52 l/s	4,27 l/s	6,02 l/s	
FEF25-75/CVF	98 /s	111%						57 /s	89 /s	121 /s	
TEF	4,20 s										

Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais
relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


Fonte prevista: Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos, Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

Gráfico de volume de fluxo melhor

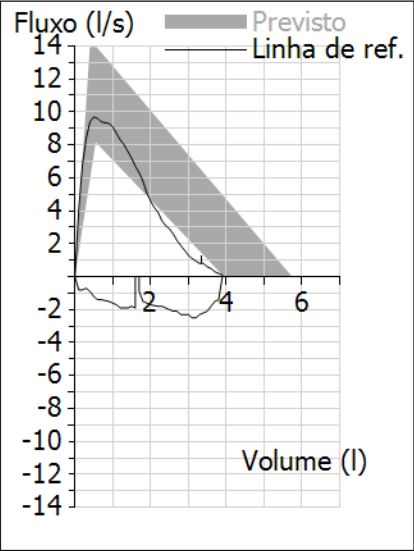

Melhor gráfico de volume/tempo

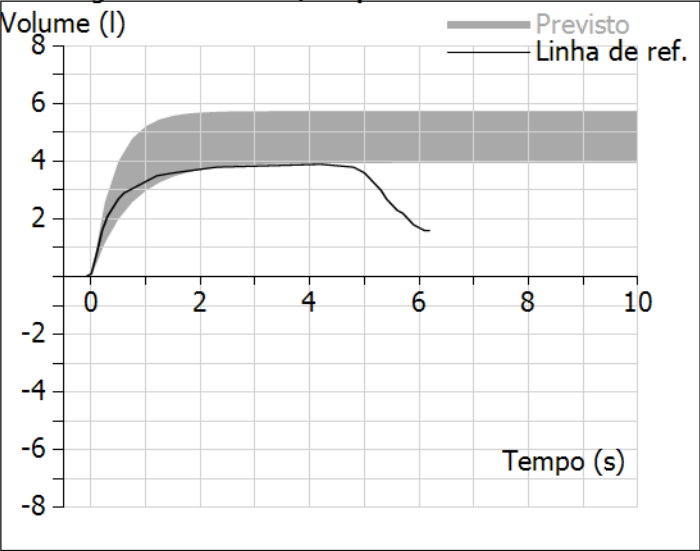

Notas de exame
QUALIDADE DE EXAME B