


Tratado fixe das Sondas, 28 anos.

2025-08-05 08:19:30
ID:
Nome:

Impressão de 12Canais
Freq. Cardíaca: 53 bpm

Hospital: SESI
Confirmado por:

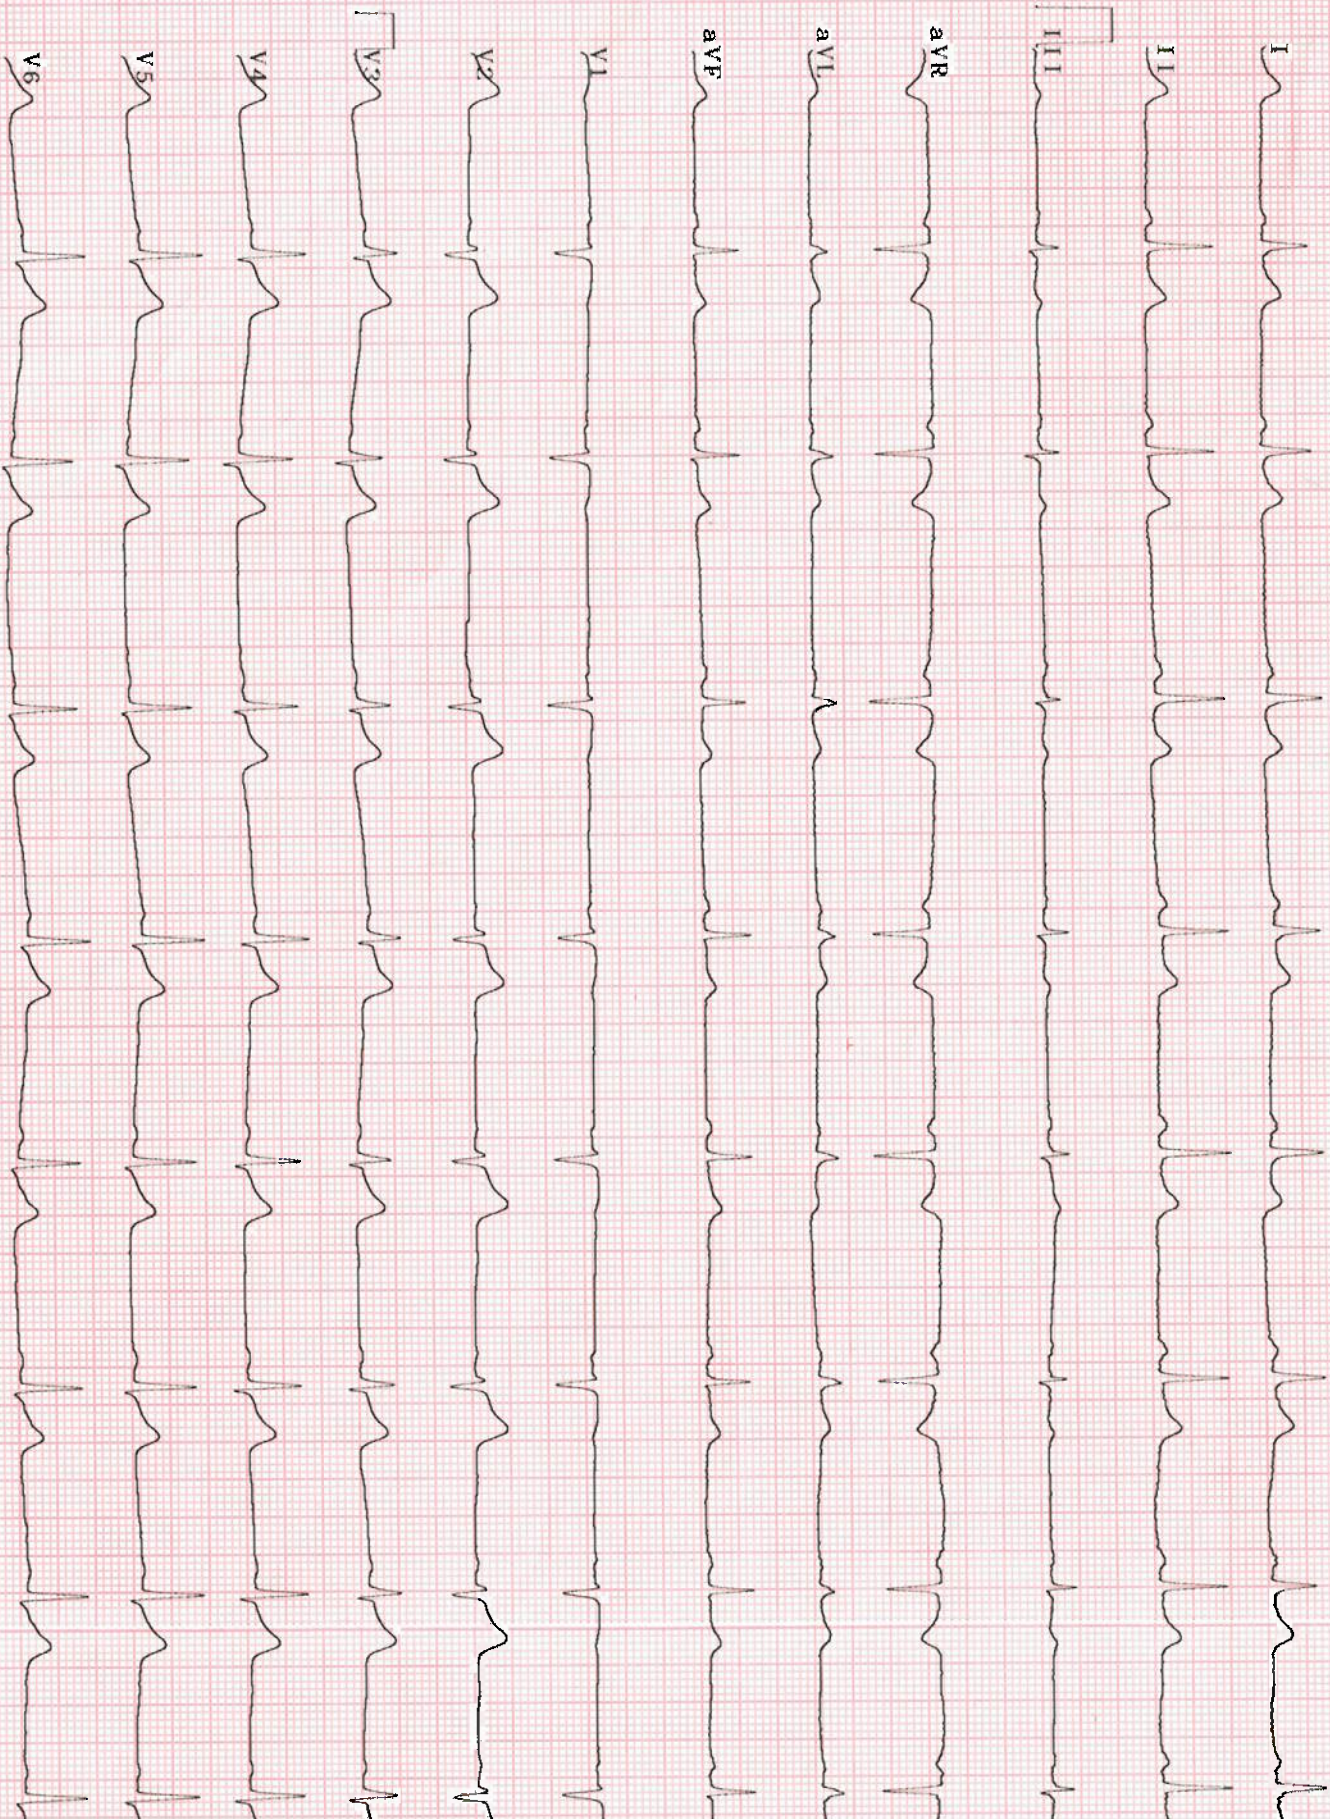

0.1Hz - 40Hz.

I-aVF: 10.0mm/mV, V1-V6: 5.0mm/mV. 25.0mm/seg.

Cardiotouch6.11.30 Bionet Co