


Novo traço de saída

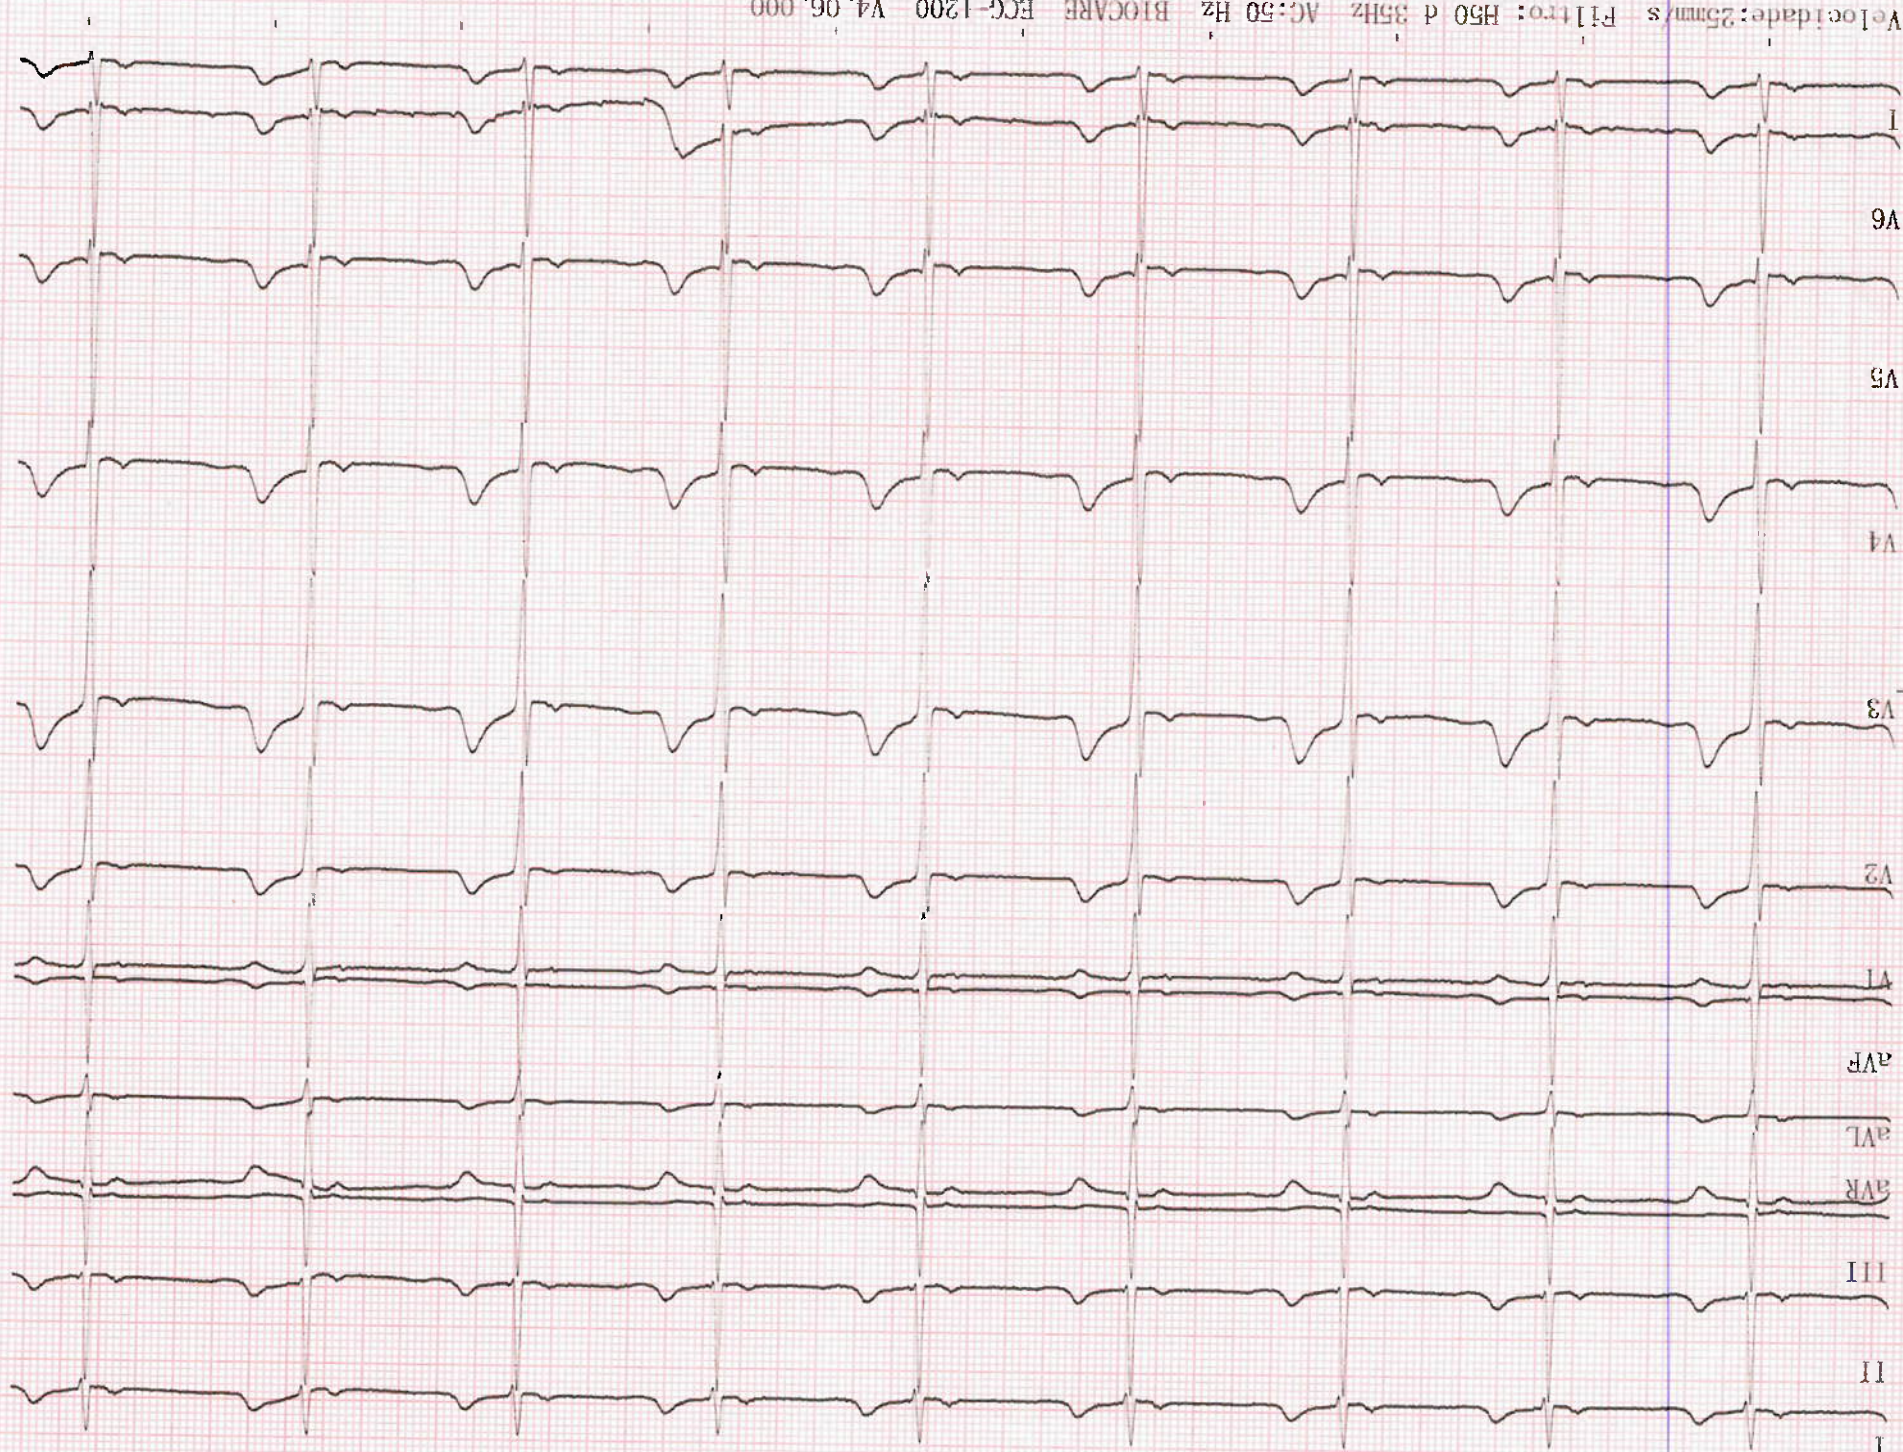

Real Tempo Modo

2025 07 24, 09:20

10mm/mV

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARE ECG-1200 V4.06.000