

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

1 - Dados do Exame

Nº do Exame: CPN-02784	Data de Instalação: 22/07/2025 08:41 Término: 23/07/2025 08:45 Protocolo de Medições: Padrão	Código: CPN-02784
----------------------------------	--	------------------------------------

2 - Paciente

Nome: BENEDITO DIAS DOS SANTOS Sexo: M Fumante: Não	Altura: 161 Tel:	Peso: 74 Nascimento: 30/08/1950 Fax:
Diagnóstico:		
Motivo do Exame:		

3 - Médico Solicitante

Nome: EMANOEL VALDAMERI Clínica: 5896	Tel: Fax:
--	----------------------------

4 - Laudo Médico

5 - Data e Assinatura

23/07/2025	EMANOEL VALDEMERI C.R.M.:
-------------------	-------------------------------------

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Tabela das Medições

Nº do Exame: CPN-02784	Paciente: BENEDITO DIAS DOS SANTOS Data de Instalação: 22/07/2025 08:41:25	Código: CPN-02784
---	---	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	08:43	145	92	116	53	91	Medição manual	48	21:03	114	80	96	34	93	
2	08:45	114	51	80	63	92		49	21:15	133	69	98	64	87	
3	09:00	119	81	98	38	101		50	21:30	131	81	104	50	89	
4	09:15	120	73	95	47	84		51	21:45	155	90	120	65	80	
5	09:30	104	71	86	33	80		52	22:00	143	81	109	62	79	
6	09:45	126	68	94	58	85		53	22:15	140	84	110	56	76	
7	10:00	134	84	107	50	92		54	22:30	138	86	110	52	74	
8	10:15	114	69	90	45	79		55	22:45	167	95	128	72	76	
9	10:33	122	72	95	50	74		56	23:30	145	79	109	66	77	
10	10:45	131	72	99	59	72		57	00:00	150	93	119	57	75	
11	11:00	126	73	97	53	75		58	00:30	164	95	127	69	74	
12	11:33	113	64	86	49	76		59	01:00	147	83	112	64	80	
13	11:45	123	73	96	50	71		60	01:33	112	78	94	34	87	
14	12:00	124	80	100	44	71		61	02:00	119	84	100	35	83	
15	12:15	114	76	93	38	72		62	02:30	131	83	105	48	73	
16	12:30	115	75	93	40	71		63	03:00	139	76	105	63	69	
17	12:48	126	74	98	52	98		64	03:30	138	85	109	53	70	
18	13:15	115	63	87	52	76		65	04:00	121	82	100	39	73	
19	13:30	120	73	94	47	79		66	04:30	132	84	106	48	74	
20	13:45	119	74	94	45	81		67	05:00	151	89	117	62	67	
21	14:00	108	65	85	43	82		68	05:33	167	77	118	90	72	
22	14:15	115	71	91	44	78		69	06:00	124	71	95	53	66	
23	14:30	114	72	91	42	71		70	06:30	148	85	114	63	70	
24	14:45	111	72	90	39	76		71	07:00	145	86	113	59	69	
25	15:00	146	82	112	64	73		72	07:15	141	85	110	56	60	
26	15:15	127	80	102	47	82		73	07:48	135	53	91	82	92	
27	15:33	131	79	103	52	95		74	08:30	122	71	95	51	80	
28	15:45	146	57	98	89	97		75	08:45						Aparelho desligado manualmente
29	16:00	116	66	89	50	81		76	08:45						Aparelho foi religado
30	16:15	123	71	95	52	74		77	08:45						Aparelho desligado manualmente
31	16:30	134	82	106	52	88									
32	16:45	120	65	90	55	74									
33	17:00	123	64	91	59	76									
34	17:15	126	70	96	56	82									
35	17:33	117	66	89	51	74									
36	17:45	121	68	92	53	76									
37	18:00	128	68	95	60	76									
38	18:15	121	63	89	58	80									
39	18:48	110	80	94	30	108									
40	19:03	113	67	88	46	82									
41	19:15	123	72	95	51	78									
42	19:30	148	72	107	76	75									
43	19:45	149	66	104	83	82									
44	20:00	141	85	111	56	75									
45	20:15	144	87	113	57	73									
46	20:30	162	92	124	70	89									
47	20:45	151	78	111	73	96									

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Análise Estatística

Nº do Exame: CPN-02784	Paciente: BENEDITO DIAS DOS SANTOS Data de Instalação: 22/07/2025 08:41:25	Código: CPN-02784
----------------------------------	---	-----------------------------


1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	81	
Medições Válidas:	74 = 91%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	130 / 76 mmHg	menor que 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	128 / 74 mmHg	menor que 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	139 / 83 mmHg	menor que 120 / 70 mmHg
Descenso Noturno:	-9% / -12%	entre 10% e 20% / 10% e 20%
Carga Pressórica** na Vigília:	29% / 15%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	87% / 100%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	46% / 41%	até 50% / 50%
** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.		
3 - Valores Máximos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	167 mmHg às 22:45 h	
PAD:	95 mmHg às 22:45 h	
PAM:	128 mmHg às 22:45 h	
PP:	89 mmHg às 15:45 h	
Período do Sono:		
PAS:	167 mmHg às 05:33 h	
PAD:	95 mmHg às 00:30 h	
PAM:	127 mmHg às 00:30 h	
PP:	90 mmHg às 05:33 h	
4 - Valores Mínimos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	104 mmHg às 09:30 h	
PAD:	51 mmHg às 08:45 h	
PAM:	80 mmHg às 08:45 h	
PP:	30 mmHg às 18:48 h	
Período do Sono:		
PAS:	112 mmHg às 01:33 h	
PAD:	71 mmHg às 06:00 h	
PAM:	94 mmHg às 01:33 h	
PP:	34 mmHg às 01:33 h	
5 - Desvio Padrão das medições de P.A.		Valores Aceitáveis
Período Total:	15,2 / 9,4mmHg	
Período da Vigília:	14,2 / 9,3mmHg	menor que 12,0 / 9,0
Período do Sono:	16,1 / 6,3mmHg	menor que 10,0 / 8,0

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico das Pressões

Nº do Exame: CPN-02784	Paciente: BENEDITO DIAS DOS SANTOS Data de Instalação: 22/07/2025 08:41:25	Código: CPN-02784
----------------------------------	---	-----------------------------

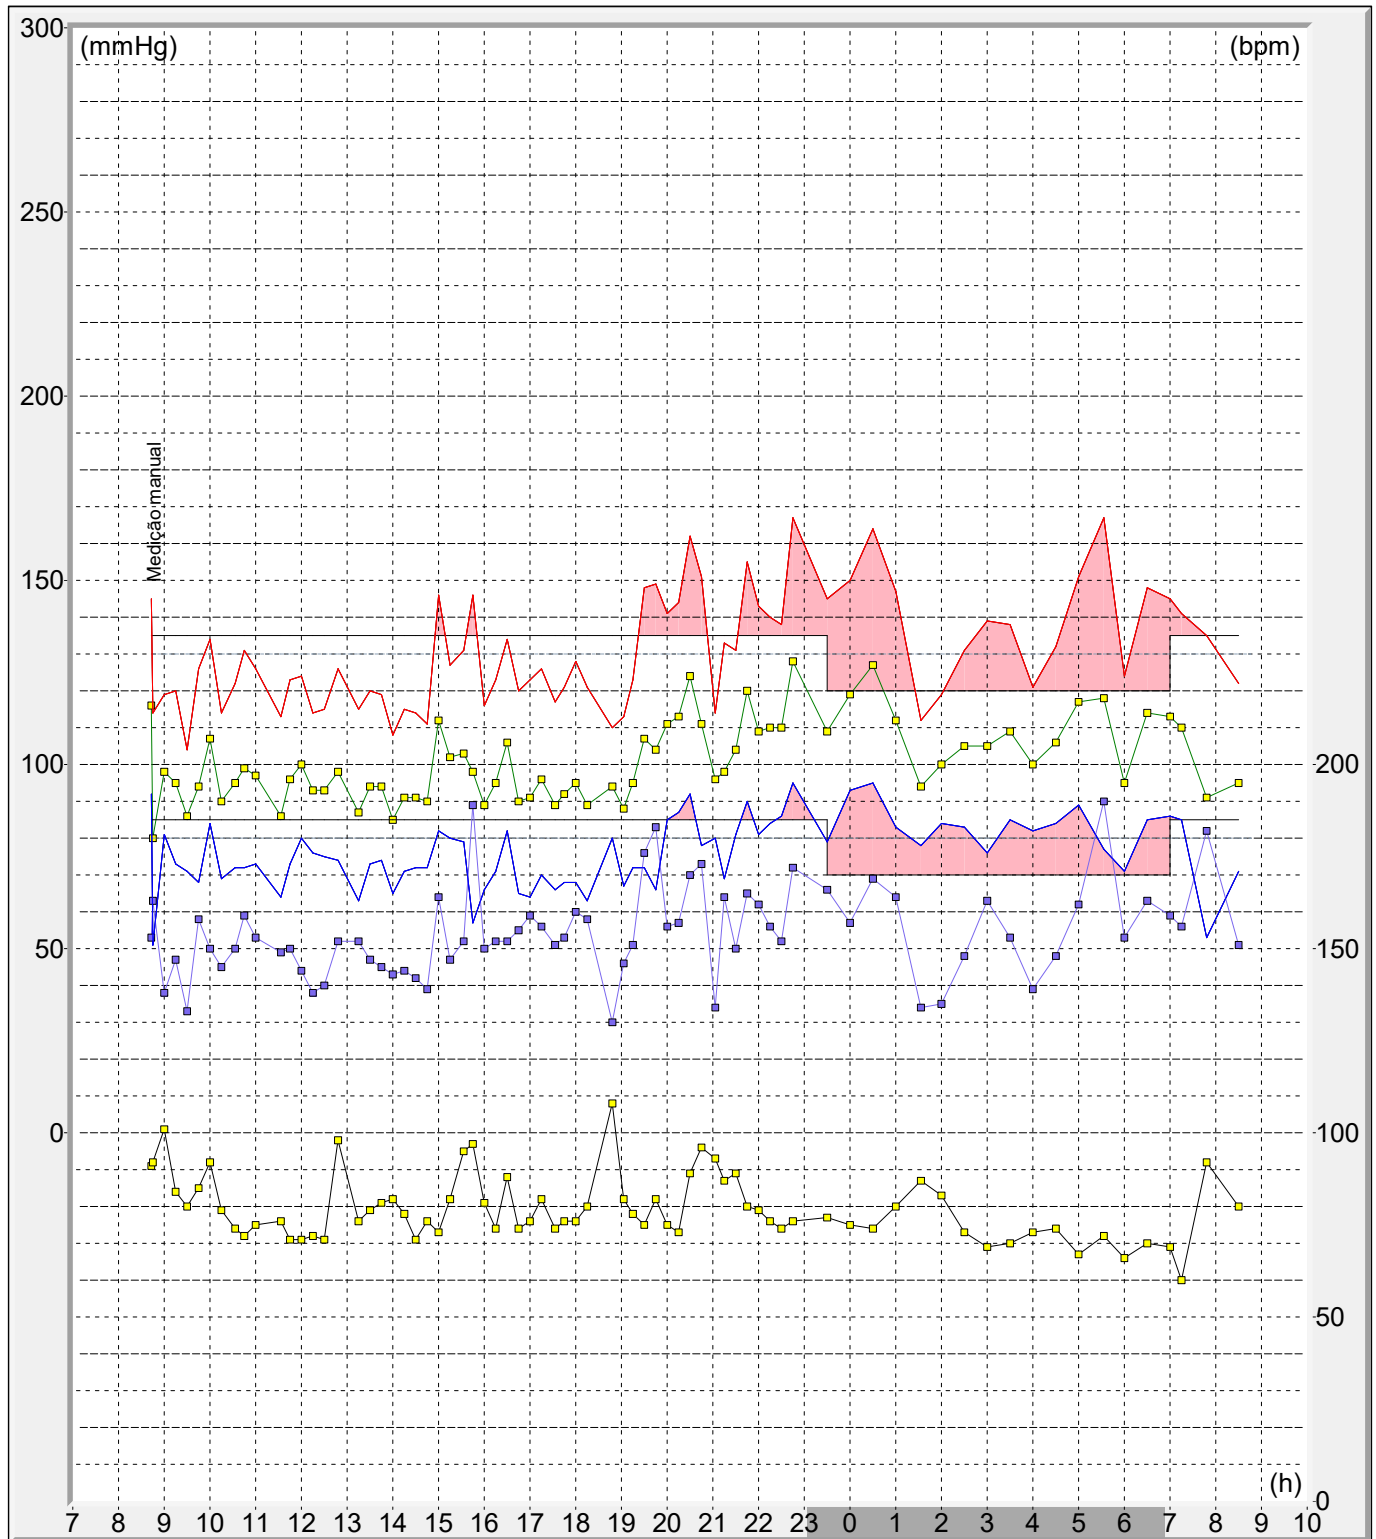


CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico de Tendências

Nº do Exame: CPN-02784	Paciente: BENEDITO DIAS DOS SANTOS Data de Instalação: 22/07/2025 08:41:25	Código: CPN-02784
----------------------------------	---	-----------------------------

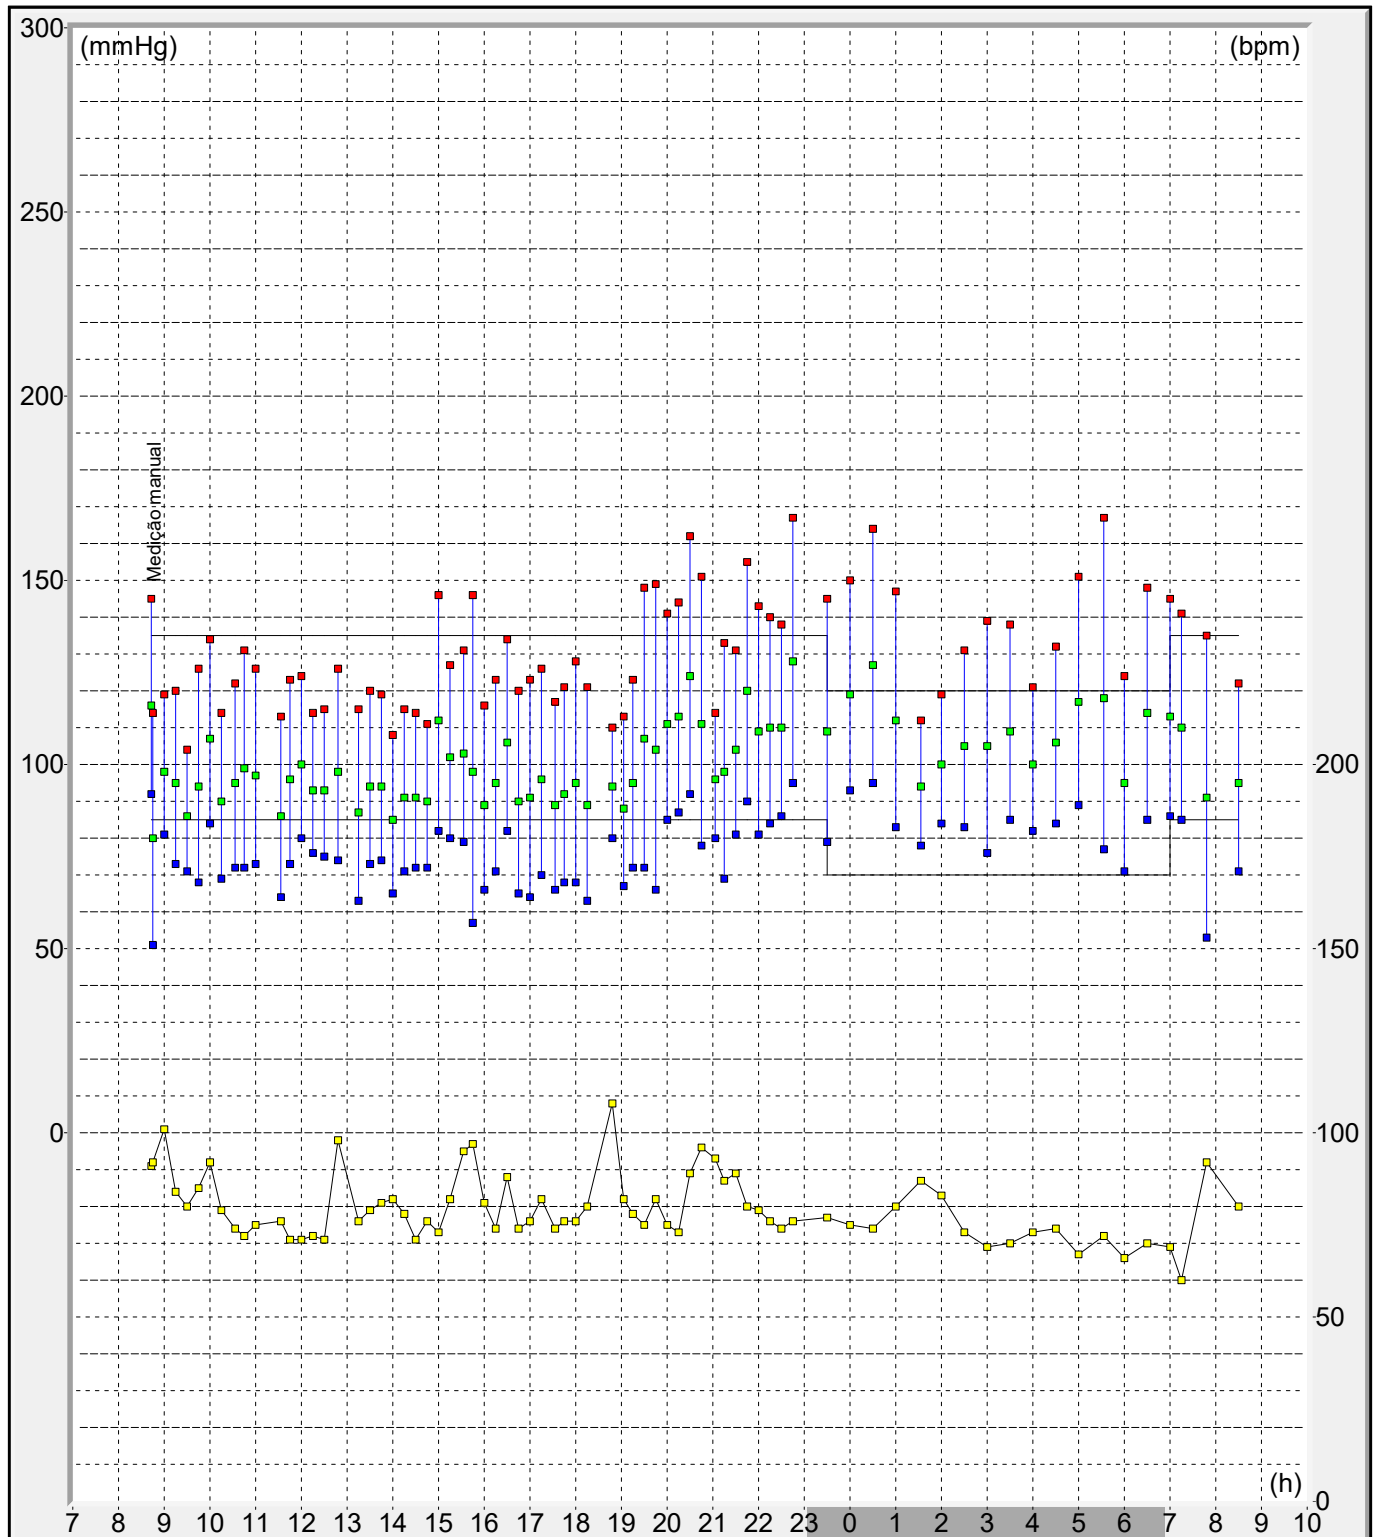


CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico de Correlação

Nº do Exame: CPN-02784	Paciente: BENEDITO DIAS DOS SANTOS Data de Instalação: 22/07/2025 08:41:25	Código: CPN-02784
----------------------------------	---	-----------------------------

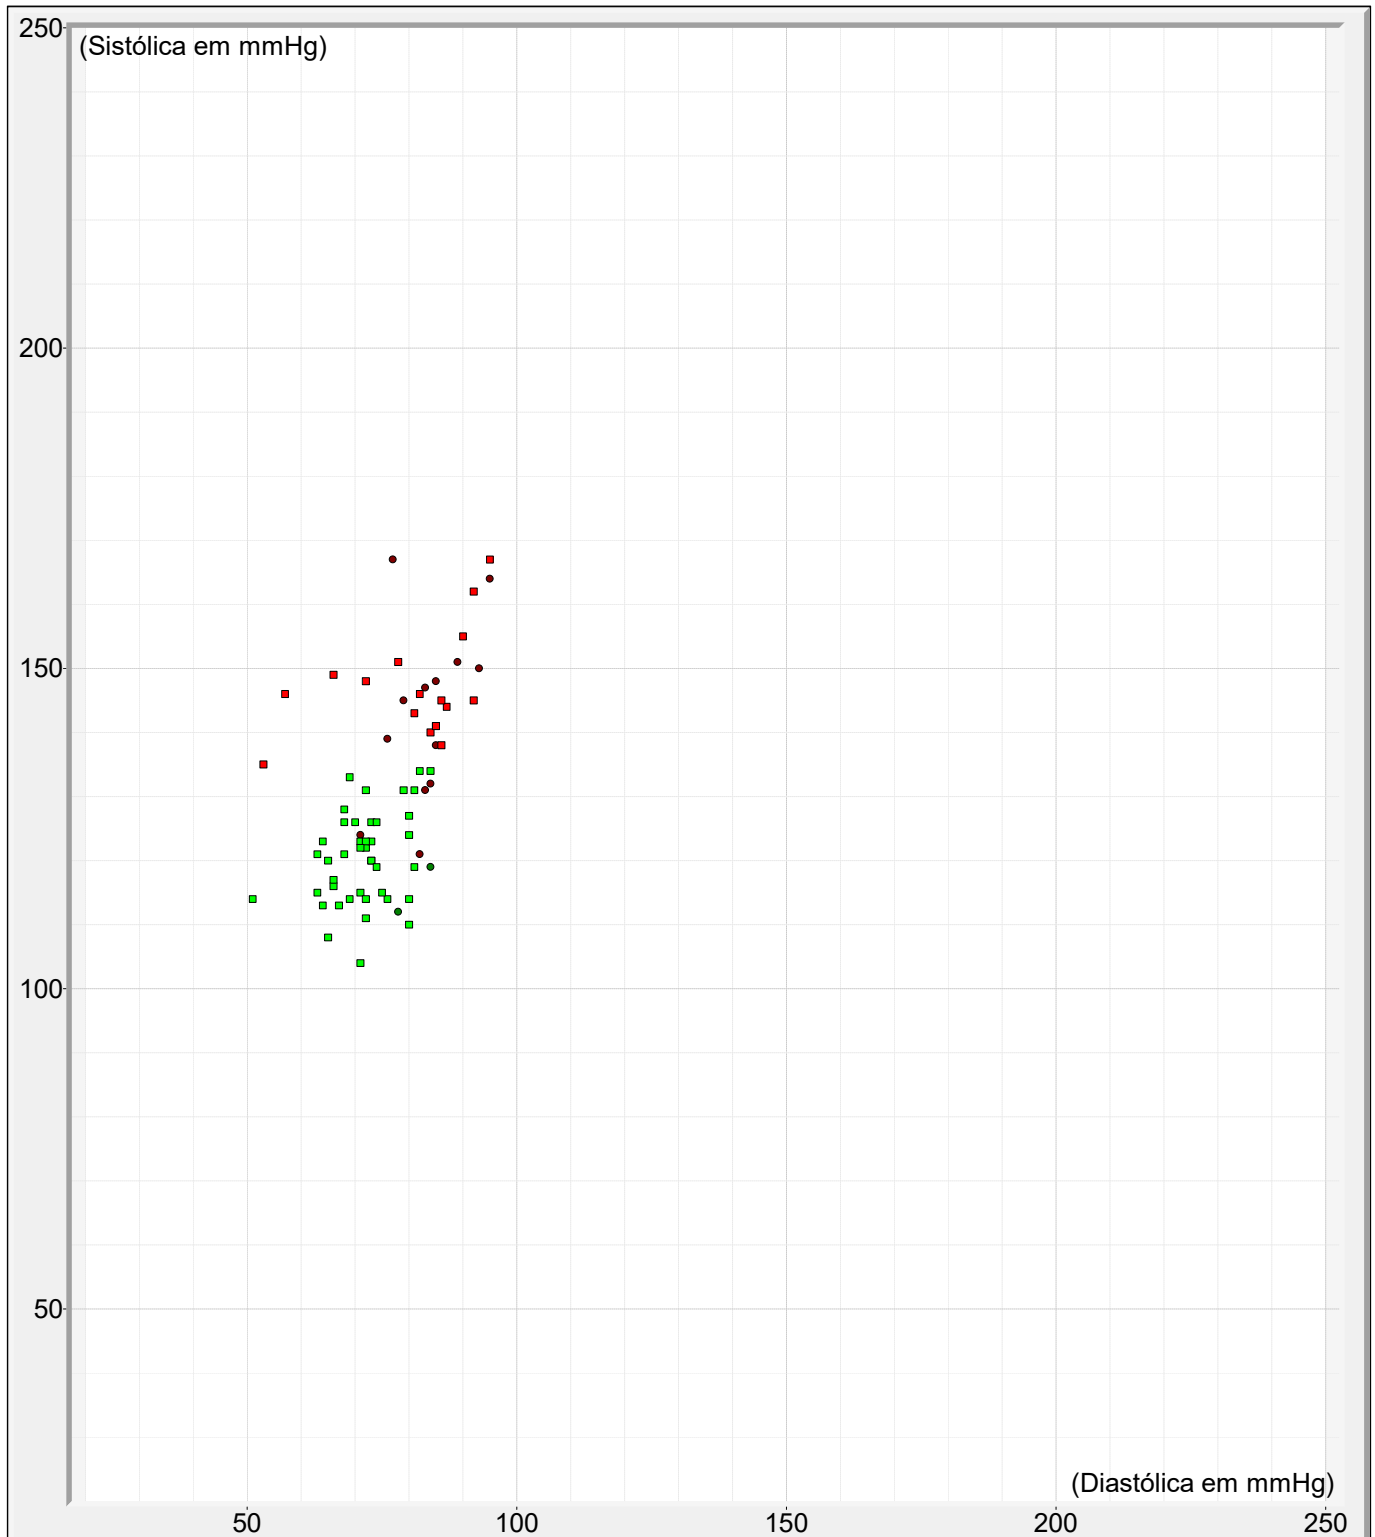

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Histogramas

Nº do Exame: CPN-02784	Paciente: BENEDITO DIAS DOS SANTOS Data de Instalação: 22/07/2025 08:41:25	Código: CPN-02784
---	---	------------------------------------

