


2025-08-04, 11:23
1.0mm/mV

Real Tempo Modo

Indagados Moraes de Silva 35 anos

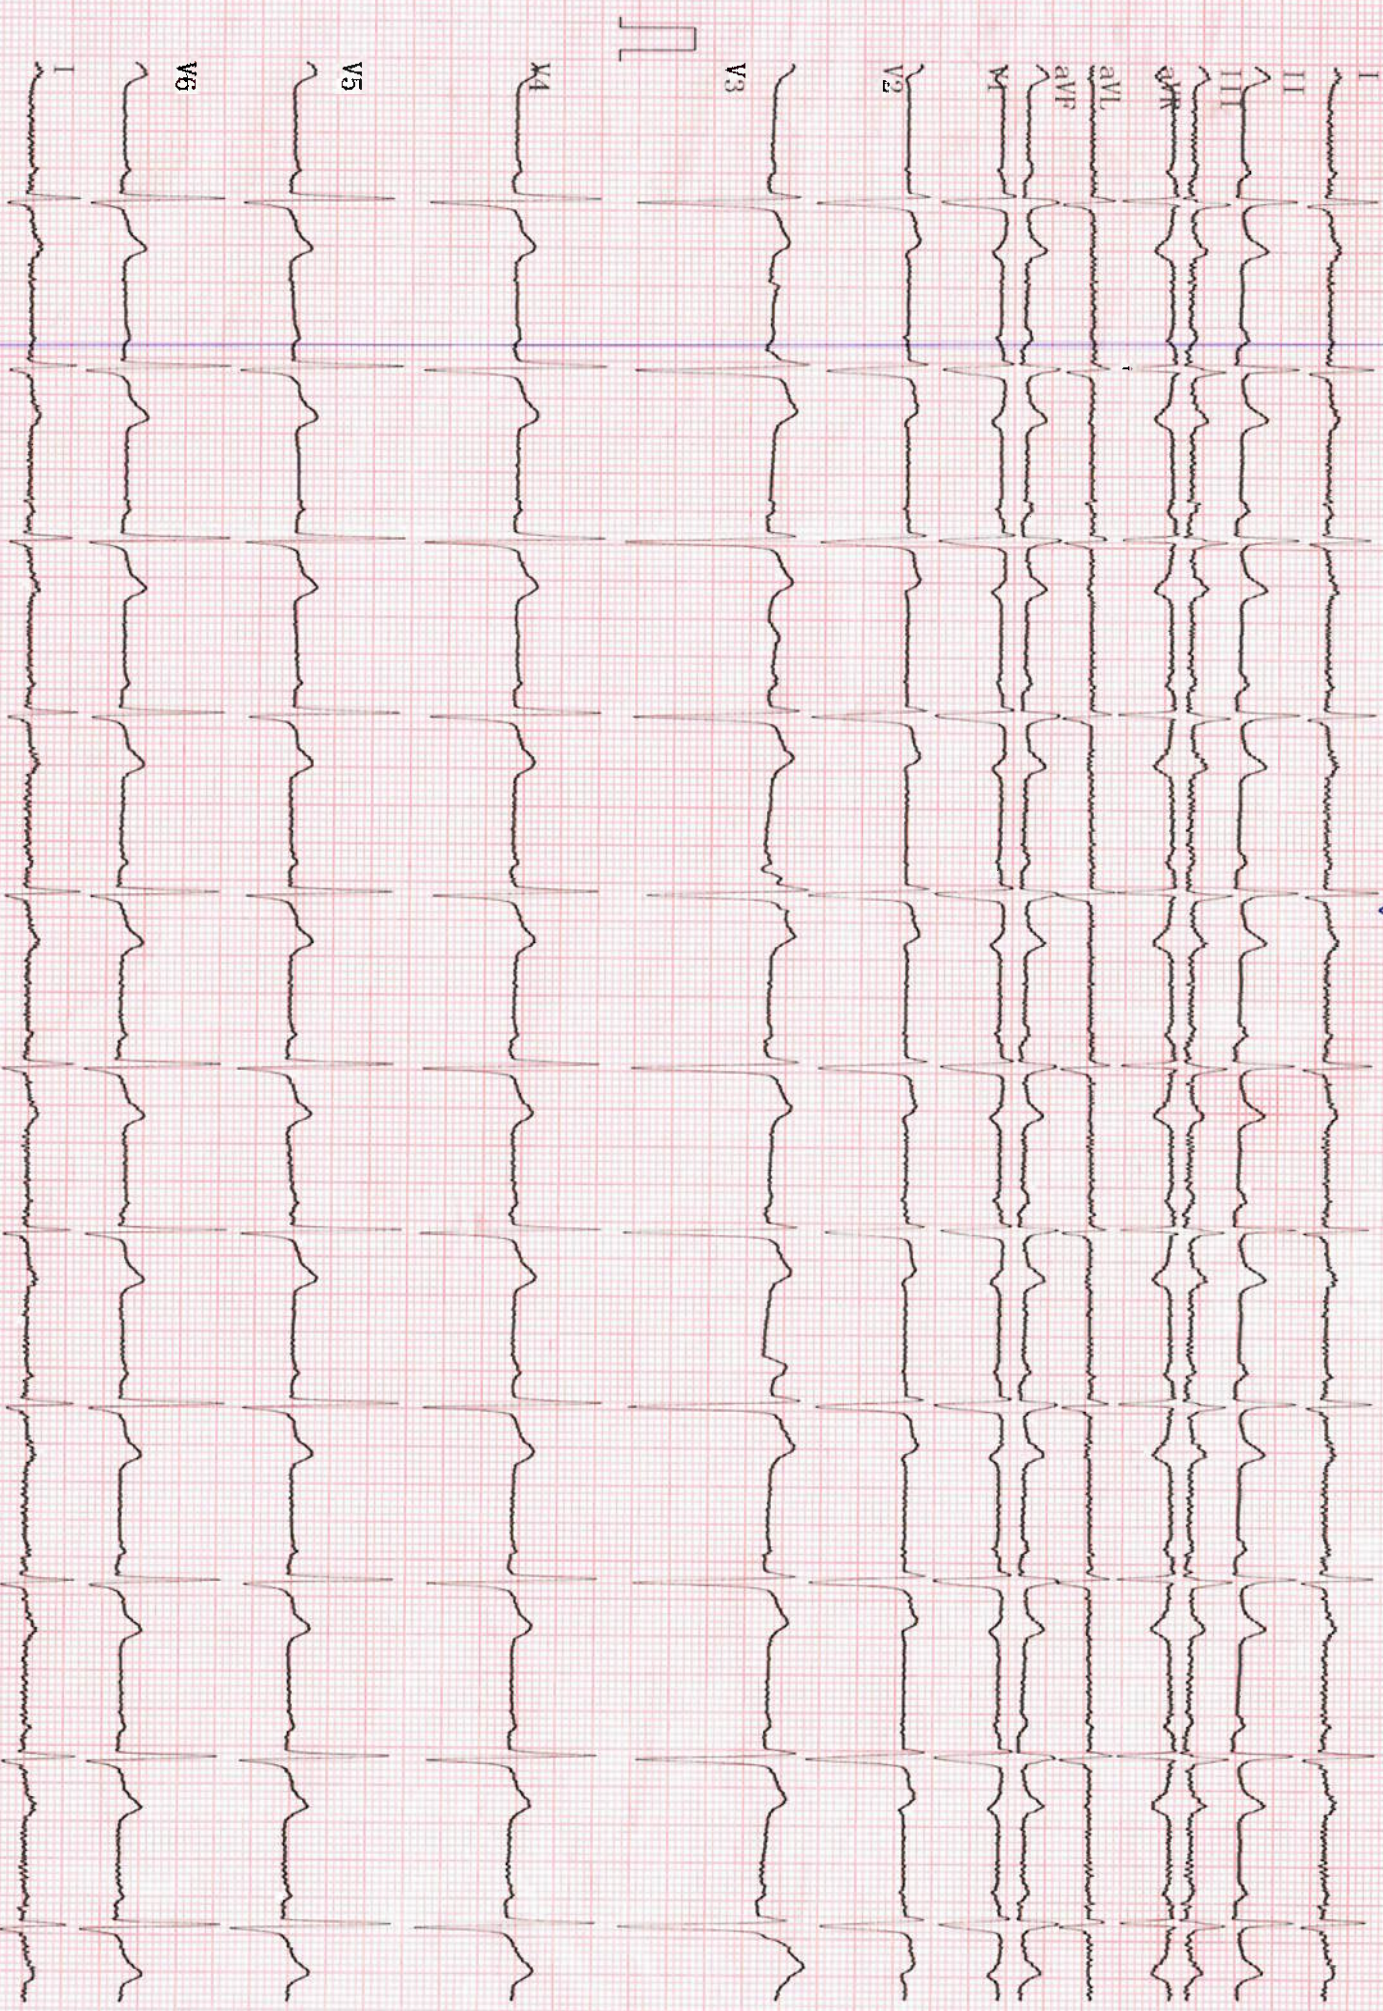

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARD ECG-1200 V4.06.000