


Paulo Henrique Correia de Araujo DN. 05/08/1989

Real Tempo Modo

2025-08-07, 08:48

10mm/mV

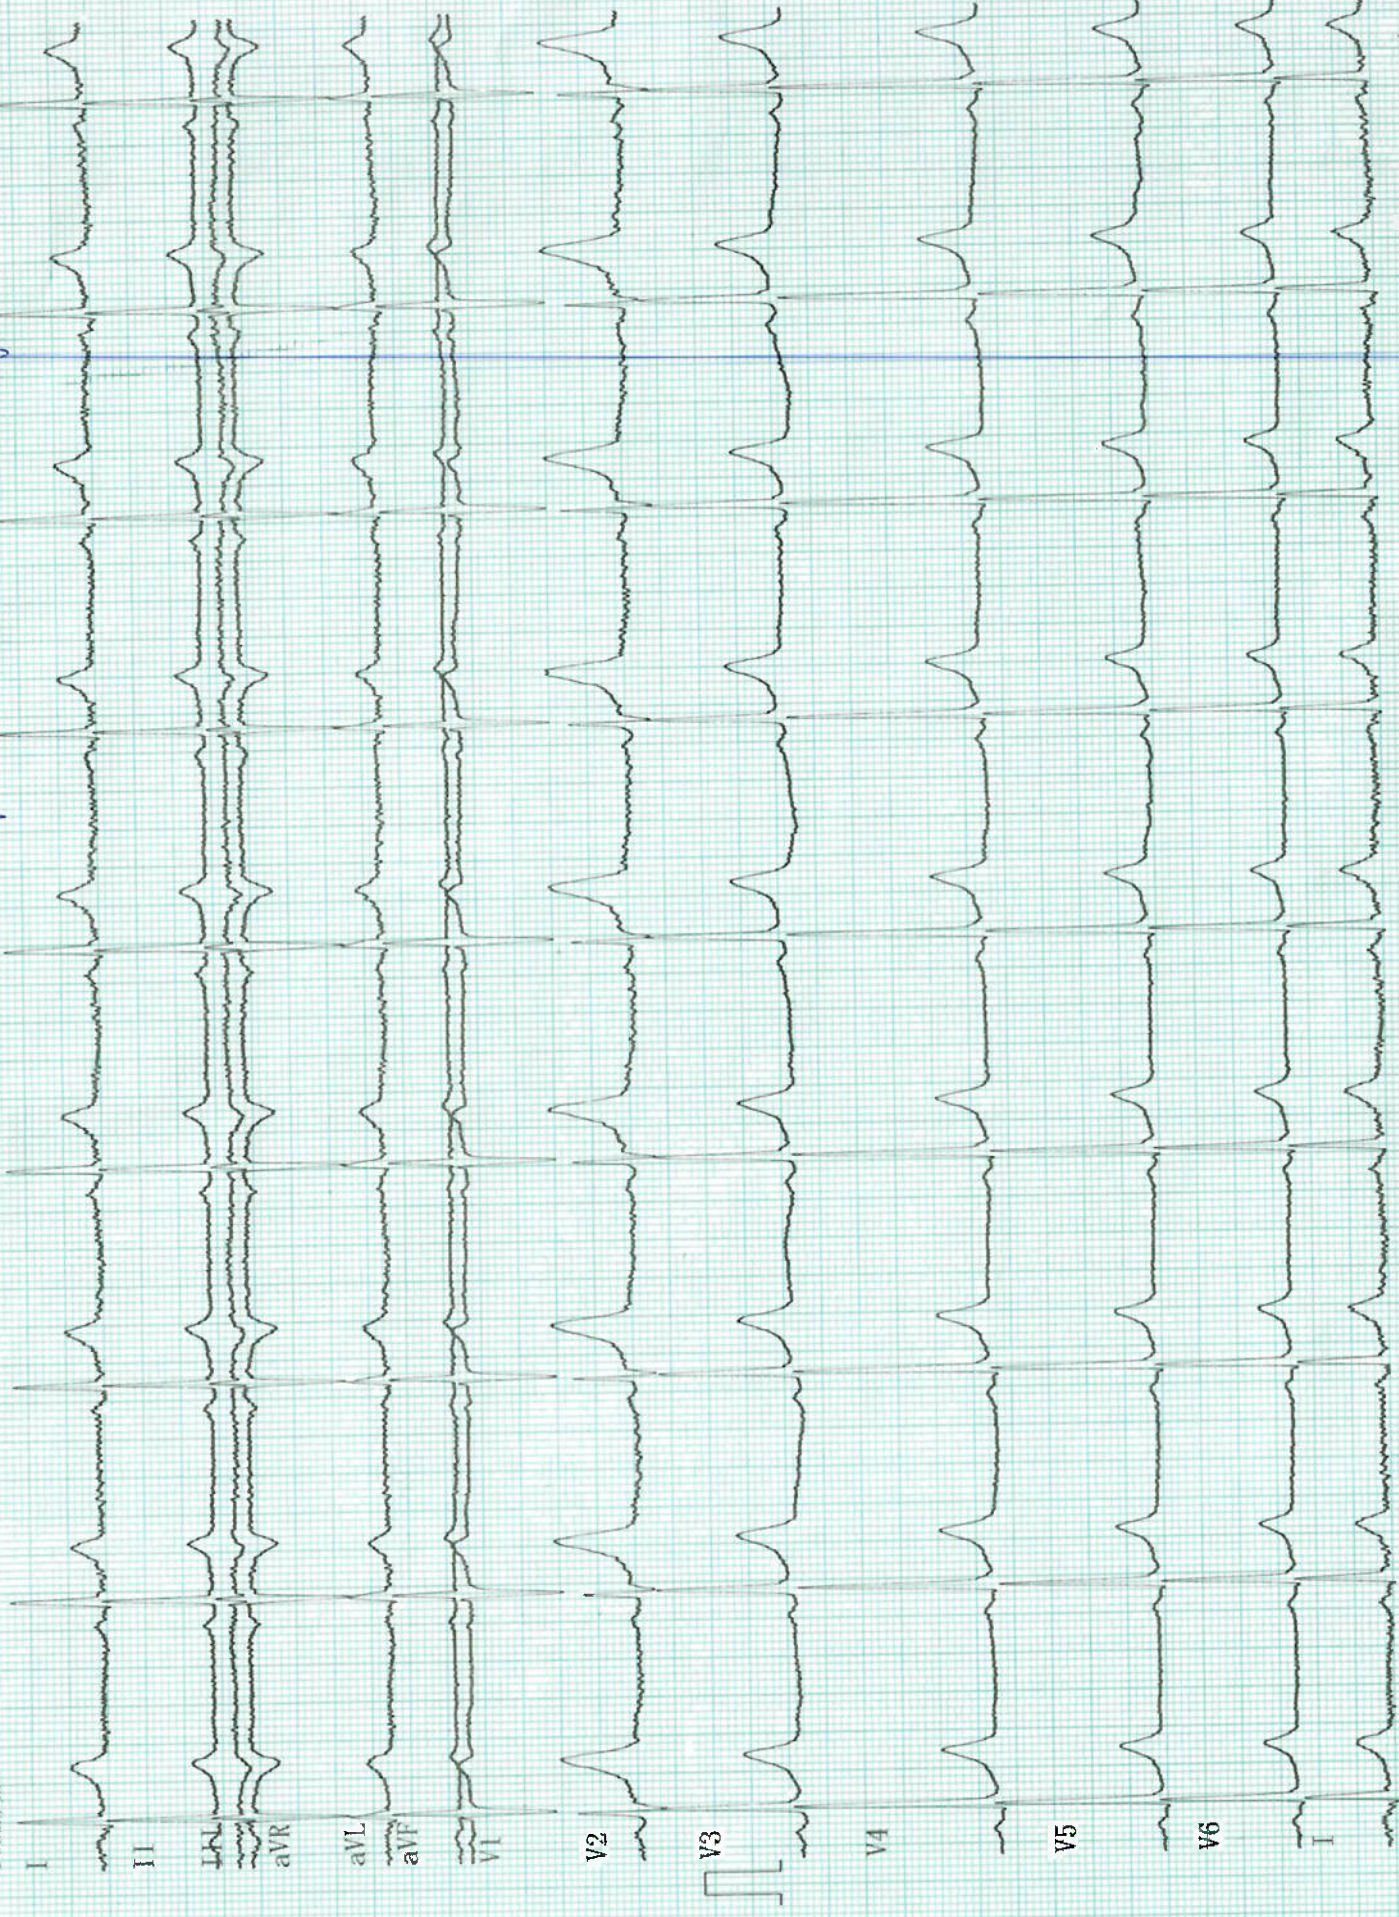

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIO CARE ECG-1200 V1.06.000