


Clayton Thiago Carvalho de A. Junior DN. 04/08/2005

Real Tempo Modo

10mm/mV

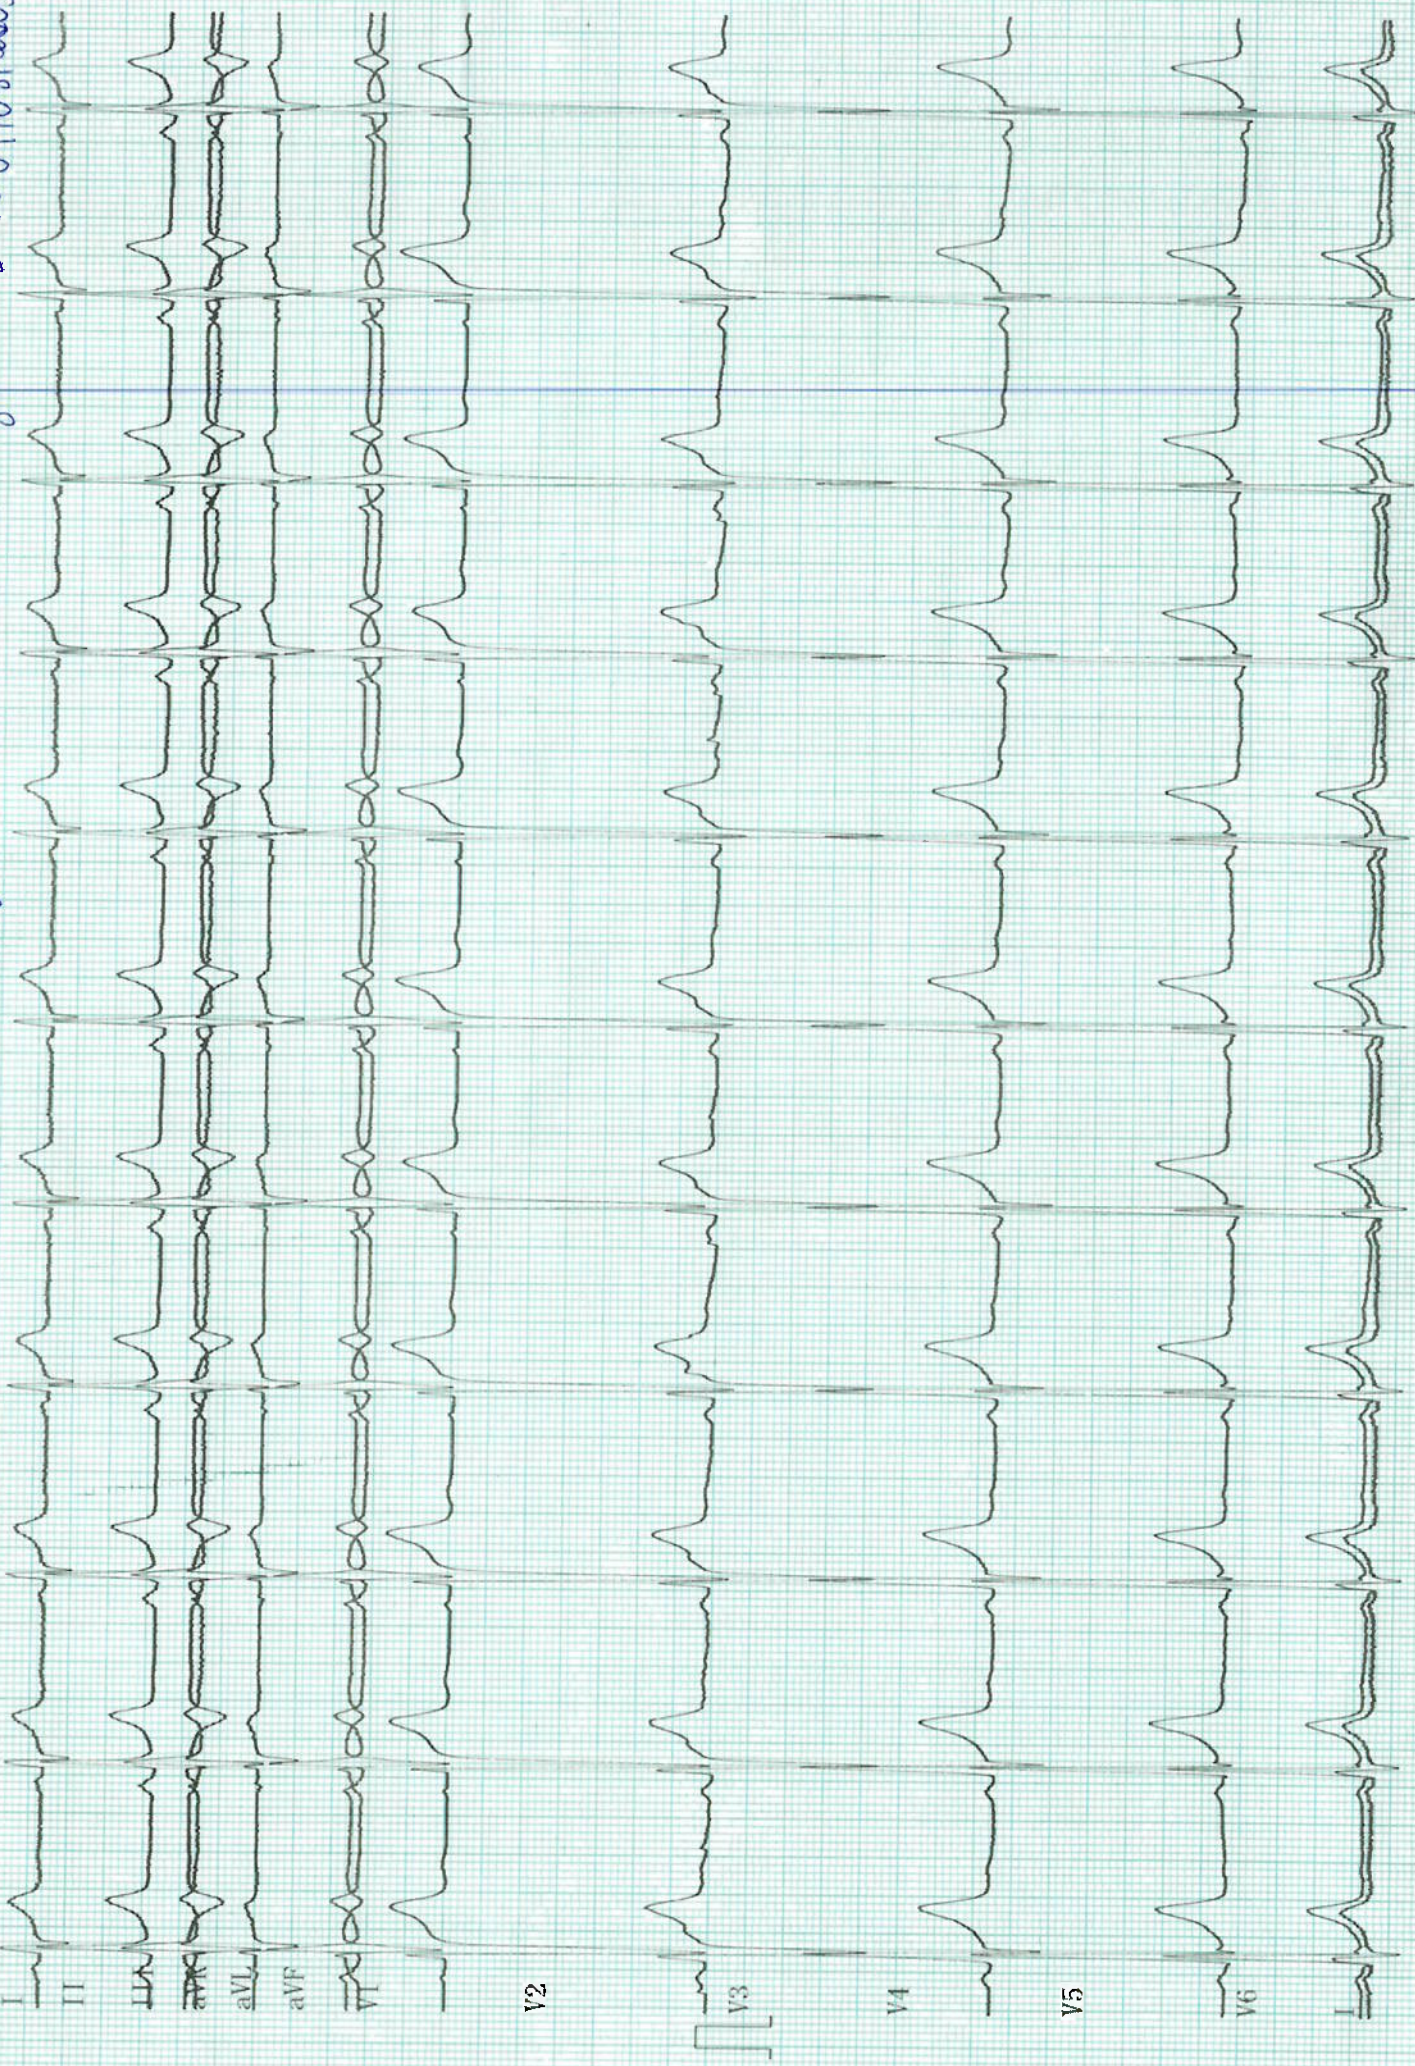

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIO CARE ECG 1200 V4.06.000