


DN: 18/02/1989

Paulo Sérgio de Almeida

Real Tempo Modo

10mm/mV

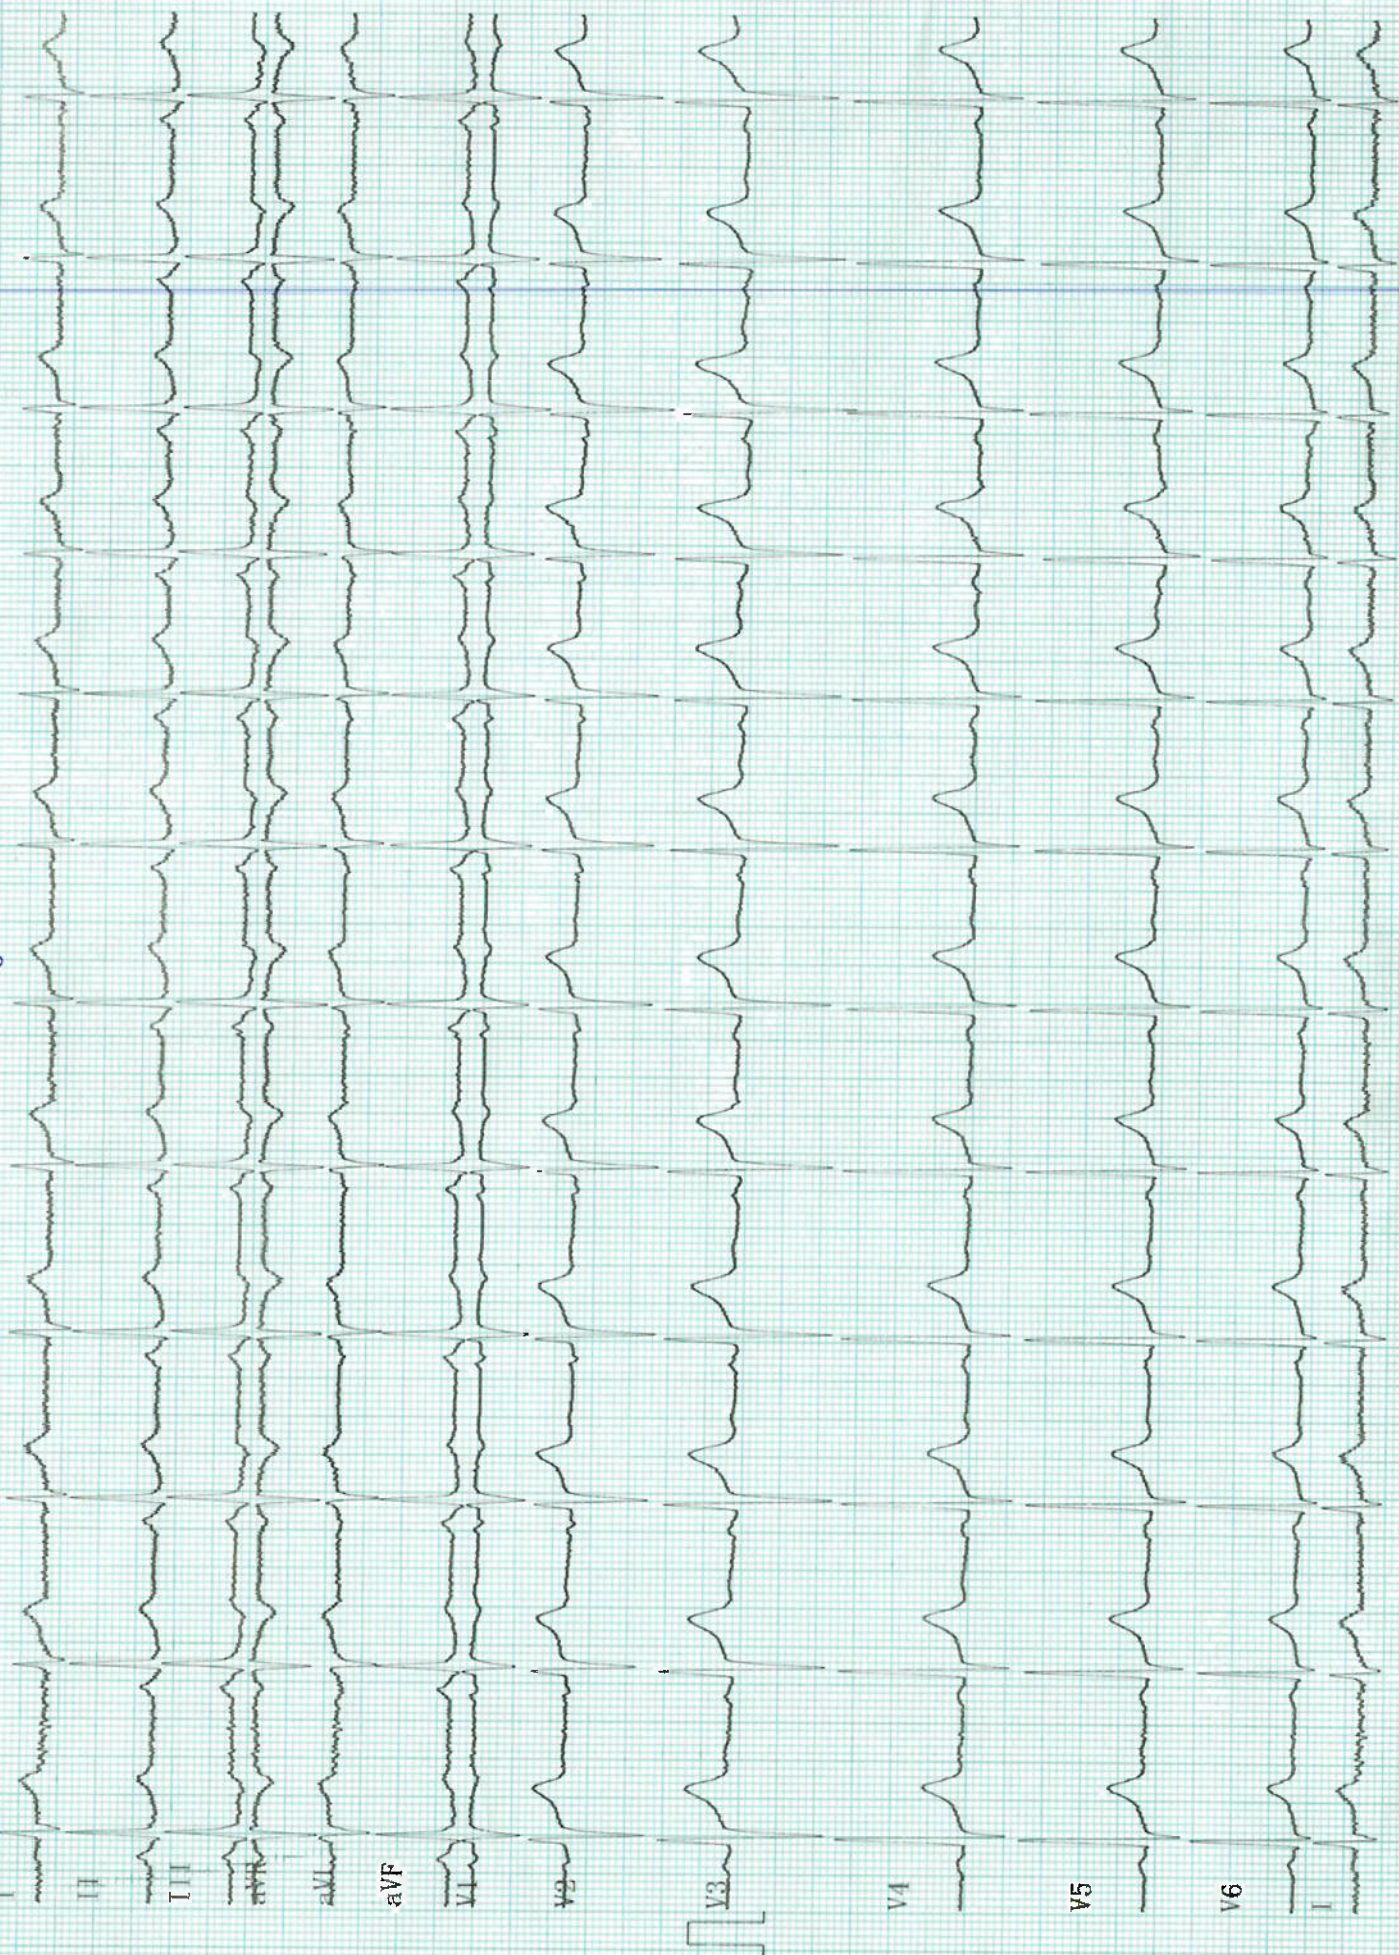

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARE ECG 1200 V4.06.000