



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACADOR

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso, Caçador - SC, 89503-079
Fone: (49) 3561-0904 / (49) 3561-0900

Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

1 - Dados do Exame

Nº do Exame: BL6-00085	Data de Instalação: 24/07/2025 13:32 Protocolo de Medições: Padrão	Término: 25/07/2025 13:45	Código: BL6-00085
----------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------------

2 - Paciente

Nome: MATHEUS GONZATTO MADALOSSO				Idade: 31
Sexo: M		Altura: 185	Peso: 100	Nascimento: 07/07/1994
Fumante: Não		Tel:	Fax:	
Diagnóstico:				
Motivo do Exame:				

3 - Médico Solicitante

Nome: DANIEL CALHEIROS BATISTA Clínica: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR	Tel: Fax:
--	---------------------------------------

4 - Laudo Médico



5 - Data e Assinatura

25/07/2025

DANIEL CALHEIROS BATISTA
C.R.M.: 26357



Tabela das Medições

Nº do Exame: BL6-00085	Paciente: MATHEUS GONZATTO MADALOSSO Data de Instalação: 24/07/2025 13:32:05	Código: BL6-00085
---	---	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	13:32	117	84	99	33	99	Medição manual	48	03:33	102	50	74	52	66	
2	13:48	132	72	99	60	84		49	04:00	119	59	86	60	55	
3	14:00	123	78	98	45	77		50	04:30	109	56	80	53	53	
4	14:15	135	84	107	51	81		51	05:00	124	37	77	87	62	
5	14:30	117	69	91	48	77		52	06:00	105	61	81	44	65	
6	14:45	123	65	91	58	76		53	07:00	114	80	95	34	74	
7	15:00	112	67	88	45	78		54	07:15	114	74	92	40	70	
8	15:15	125	71	96	54	76		55	07:30	133	82	105	51	71	
9	15:30	113	69	89	44	73		56	07:48	116	74	93	42	70	
10	15:45	111	70	89	41	75		57	08:00	112	73	91	39	70	
11	16:03	93	73	82	20	70		58	08:15	116	62	87	54	69	
12	16:15	115	82	97	33	76		59	08:30	117	77	95	40	69	
13	16:30	114	80	96	34	71		60	08:45	130	85	106	45	70	
14	16:45	127	85	104	42	62		61	09:03	109	70	88	39	67	
15	17:00	127	81	102	46	73		62	09:15	95	74	84	21	70	
16	17:18	117	80	97	37	75		63	09:30	113	87	99	26	80	
17	17:30	116	78	96	38	73		64	10:00	140	86	110	54	68	
18	17:45	131	46	85	85	71		65	10:18	146	89	115	57	97	
19	18:03	128	74	99	54	70		66	10:30	147	81	112	66	86	
20	18:18	129	72	98	57	70		67	10:45	138	91	112	47	88	
21	18:30	144	81	110	63	74		68	11:00	137	78	105	59	77	
22	18:45	147	90	116	57	79		69	11:30	120	72	94	48	76	
23	19:00	124	69	94	55	76		70	11:45	119	85	101	34	74	
24	19:15	128	81	103	47	74		71	12:00	129	89	107	40	78	
25	19:30	116	91	102	25	84		72	12:15	129	84	105	45	76	
26	19:48	108	67	86	41	86		73	12:30	121	68	92	53	84	
27	20:00	118	70	92	48	90		74	12:45	124	77	98	47	82	
28	20:15	123	77	98	46	83		75	13:00	137	77	104	60	94	
29	20:30	126	80	101	46	82		76	13:18	129	81	103	48	94	
30	20:48	136	79	105	57	85		77	13:30	136	72	102	64	92	
31	21:00	133	77	102	56	80		78	13:40						Aparelho desligado manualmente
32	21:15	123	73	96	50	81		79	13:44						Aparelho foi religado
33	21:30	117	70	92	47	75		80	13:45						Aparelho desligado manualmente
34	21:45	109	66	85	43	78									
35	22:00	108	67	86	41	70									
36	22:15	106	59	81	47	69									
37	22:30	110	63	84	47	66									
38	22:45	108	67	86	41	66									
39	23:00	107	51	76	56	66									
40	23:30	108	66	85	42	72									
41	00:00	103	63	81	40	65									
42	00:30	106	58	80	48	62									
43	01:00	104	62	81	42	61									
44	01:30	110	64	85	46	77									
45	02:00	115	54	82	61	66									
46	02:30	111	62	84	49	64									
47	03:00	114	50	79	64	61									



Análise Estatística

Nº do Exame: BL6-00085	Paciente: MATHEUS GONZATTO MADALOSSO Data de Instalação: 24/07/2025 13:32:05	Código: BL6-00085
---	---	------------------------------------

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	81	
Medições Válidas:	77 = 95%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	120 / 72 mmHg	menor que 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	122 / 76 mmHg	menor que 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	110 / 57 mmHg	menor que 120 / 70 mmHg
Descenso Noturno:	10% / 25%	entre 10% e 20% / 10% e 20%
Carga Pressórica** na Vigília:	17% / 16%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	7% / 0%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	21% / 31%	até 50% / 50%
** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.		
3 - Valores Máximos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	147 mmHg às 18:45 h	
PAD:	91 mmHg às 19:30 h	
PAM:	116 mmHg às 18:45 h	
PP:	85 mmHg às 17:45 h	
Período do Sono:		
PAS:	124 mmHg às 05:00 h	
PAD:	66 mmHg às 23:30 h	
PAM:	86 mmHg às 04:00 h	
PP:	87 mmHg às 05:00 h	
4 - Valores Mínimos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	93 mmHg às 16:03 h	
PAD:	46 mmHg às 17:45 h	
PAM:	81 mmHg às 22:15 h	
PP:	20 mmHg às 16:03 h	
Período do Sono:		
PAS:	102 mmHg às 03:33 h	
PAD:	37 mmHg às 05:00 h	
PAM:	74 mmHg às 03:33 h	
PP:	40 mmHg às 00:00 h	
5 - Desvio Padrão das medições de P.A.		Valores Aceitáveis
Período Total:	12,0 / 11,2mmHg	
Período da Vigília:	11,8 / 8,5mmHg	menor que 12,0 / 9,0
Período do Sono:	6,3 / 7,7mmHg	menor que 10,0 / 8,0

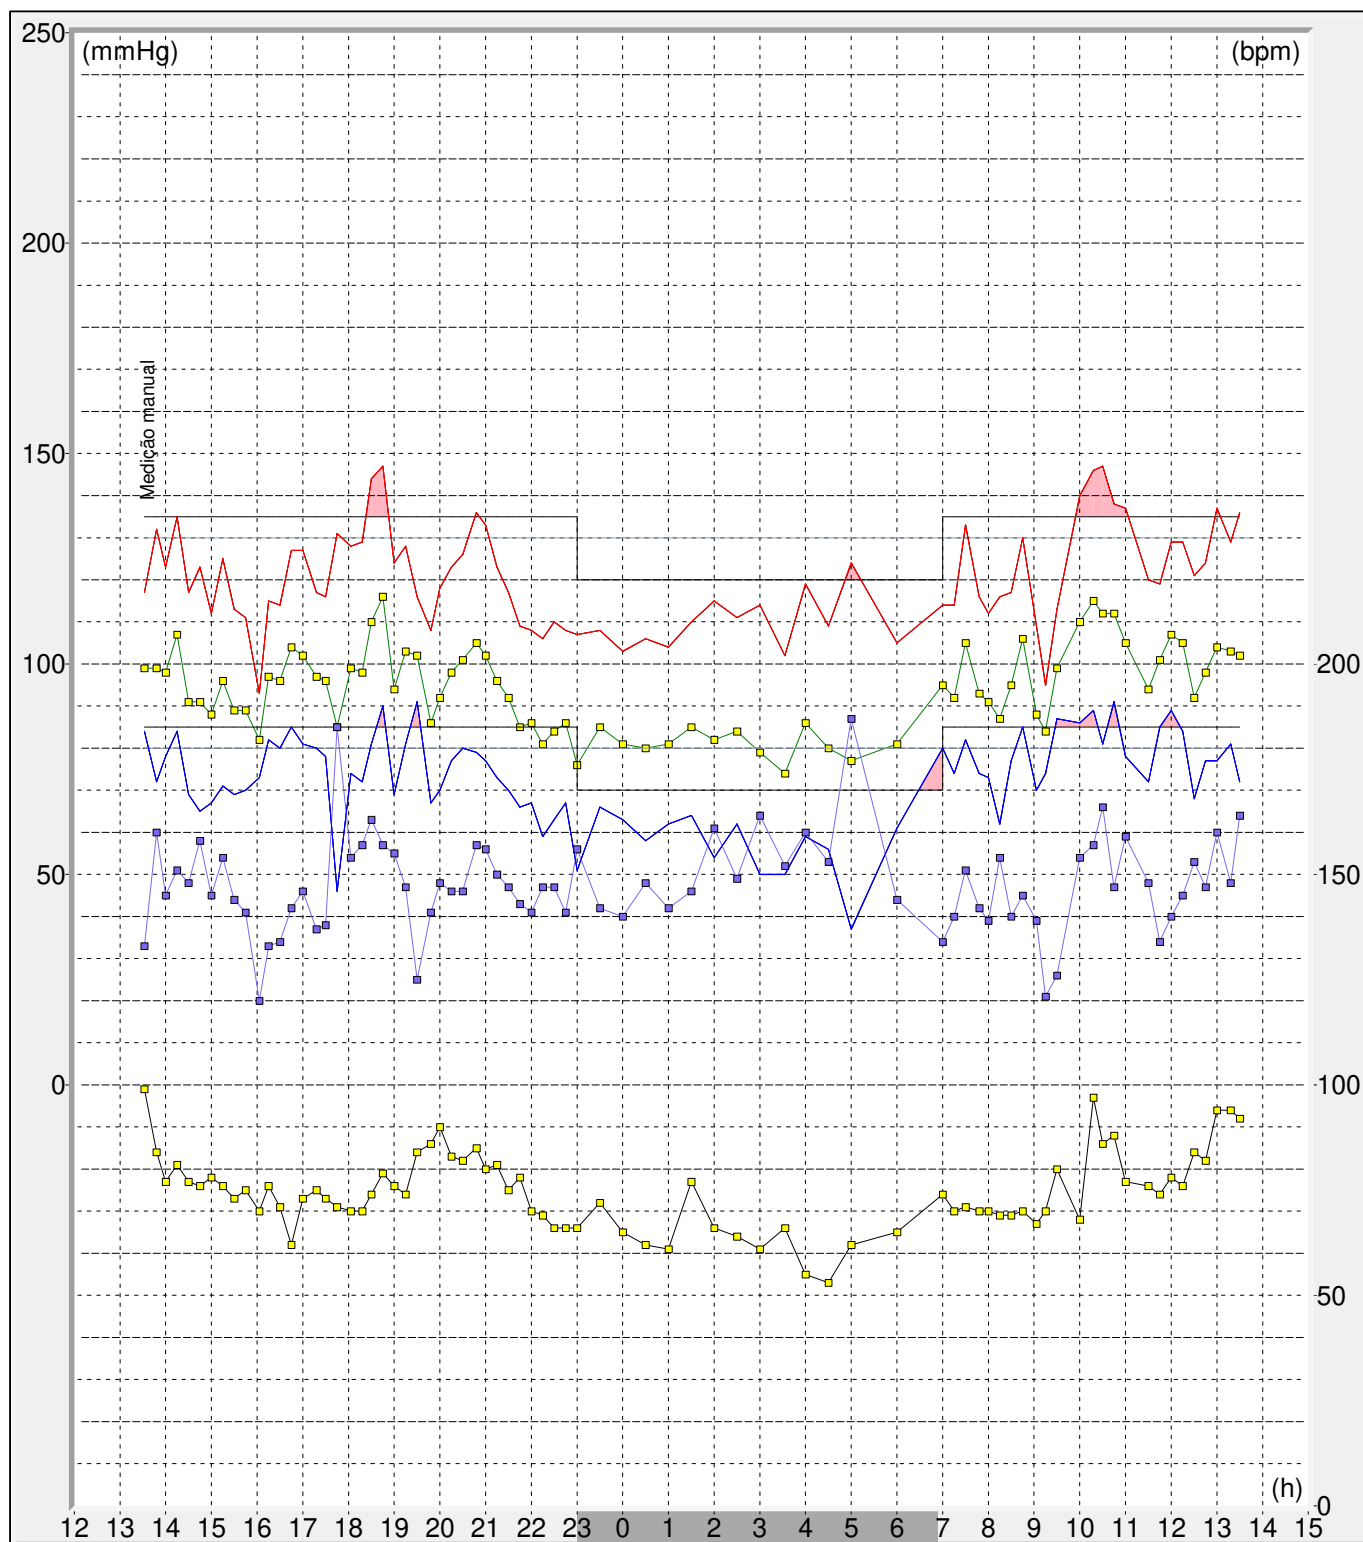


Gráfico das Pressões

Nº do Exame:
BL6-00085

Paciente: MATHEUS GONZATTO MADALOSSO
Data de Instalação: 24/07/2025 13:32:05

Código:
BL6-00085





**PREFEITURA DE
CAÇADOR**
Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso, Caçador - SC, 89503-079


Fone: (49) 3561-0904 / (49) 3561-0900

Gráfico de Tendências

Nº do Exame:
BL6-00085

Paciente: MATHEUS GONZATTO MADALOSSO
Data de Instalação: 24/07/2025 13:32:05

Código:
BL6-00085

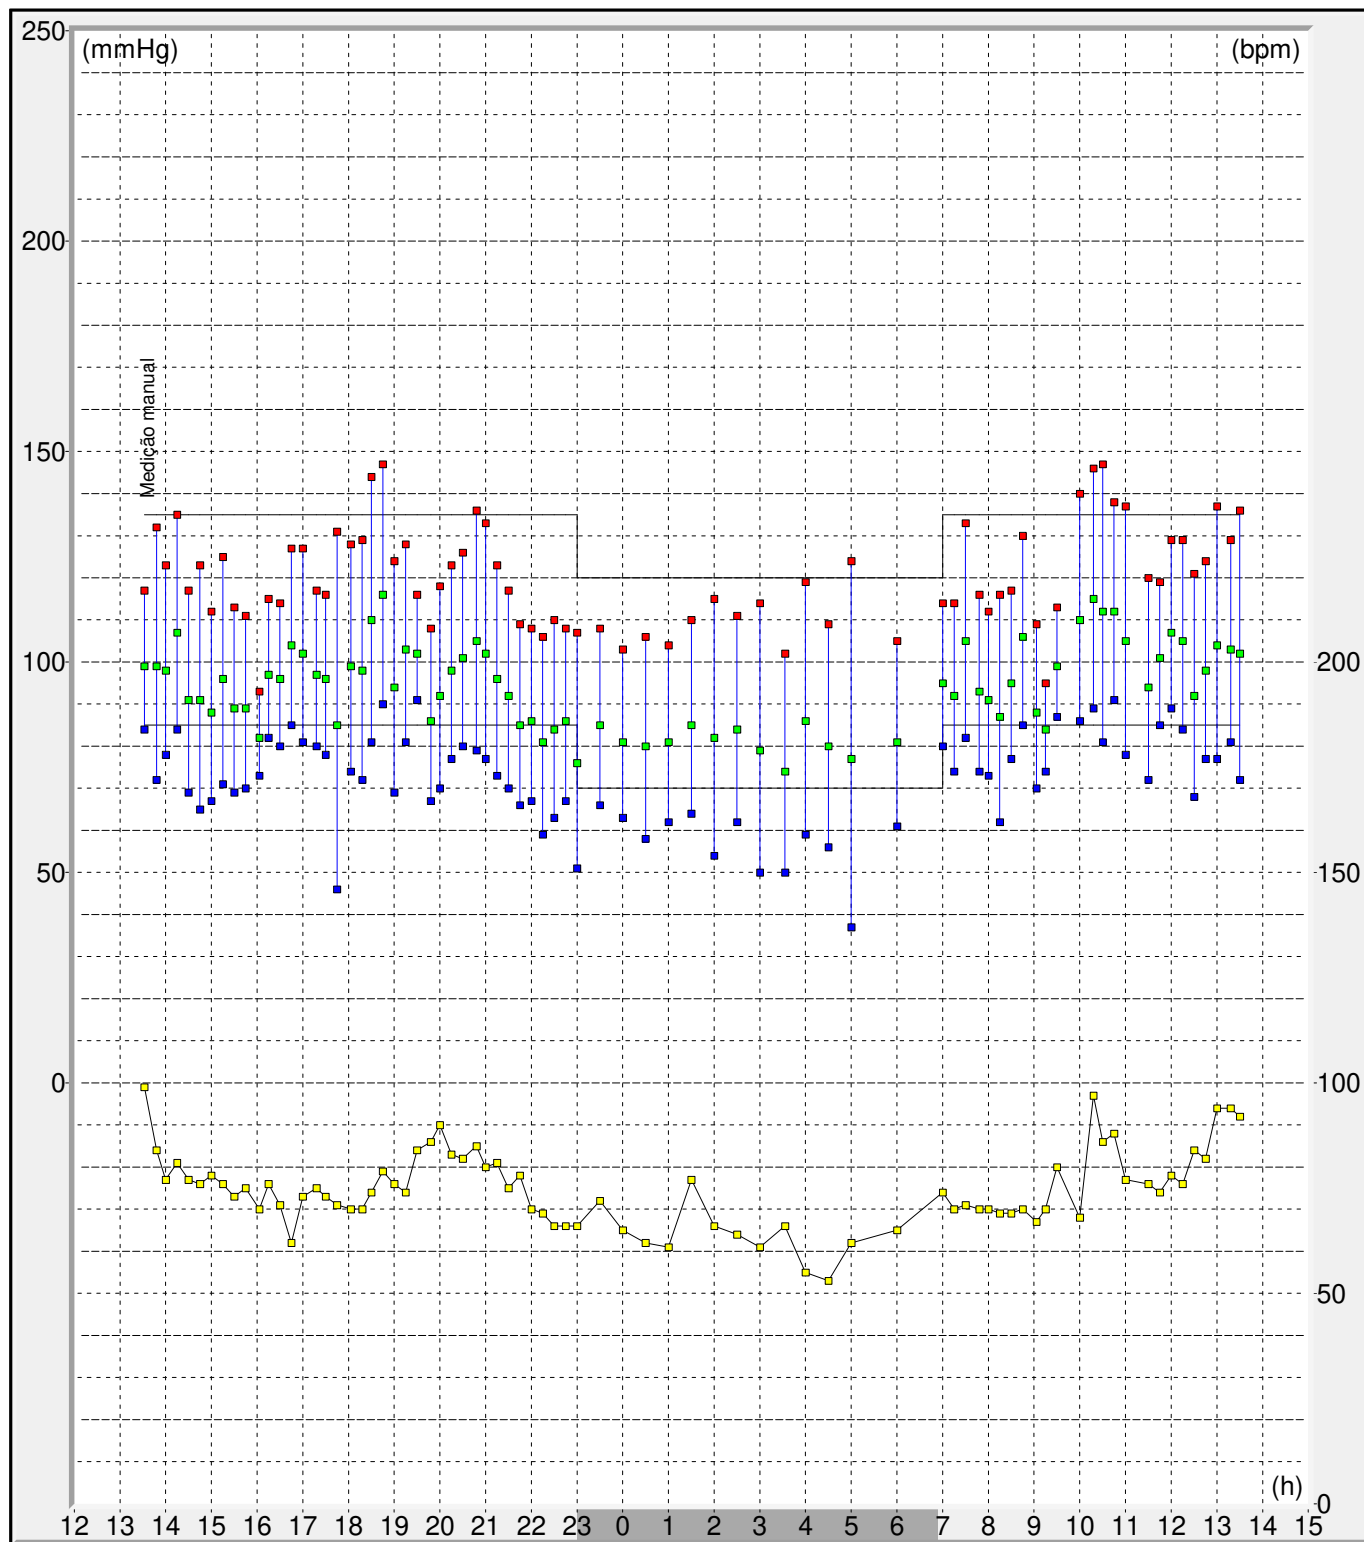



**PREFEITURA DE
CAÇADOR**
Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso, Caçador - SC, 89503-079

Fone: (49) 3561-0904 / (49) 3561-0900

Gráfico de Correlação

Nº do Exame: BL6-00085	Paciente: MATHEUS GONZATTO MADALOSSO Data de Instalação: 24/07/2025 13:32:05	Código: BL6-00085
---	---	------------------------------------

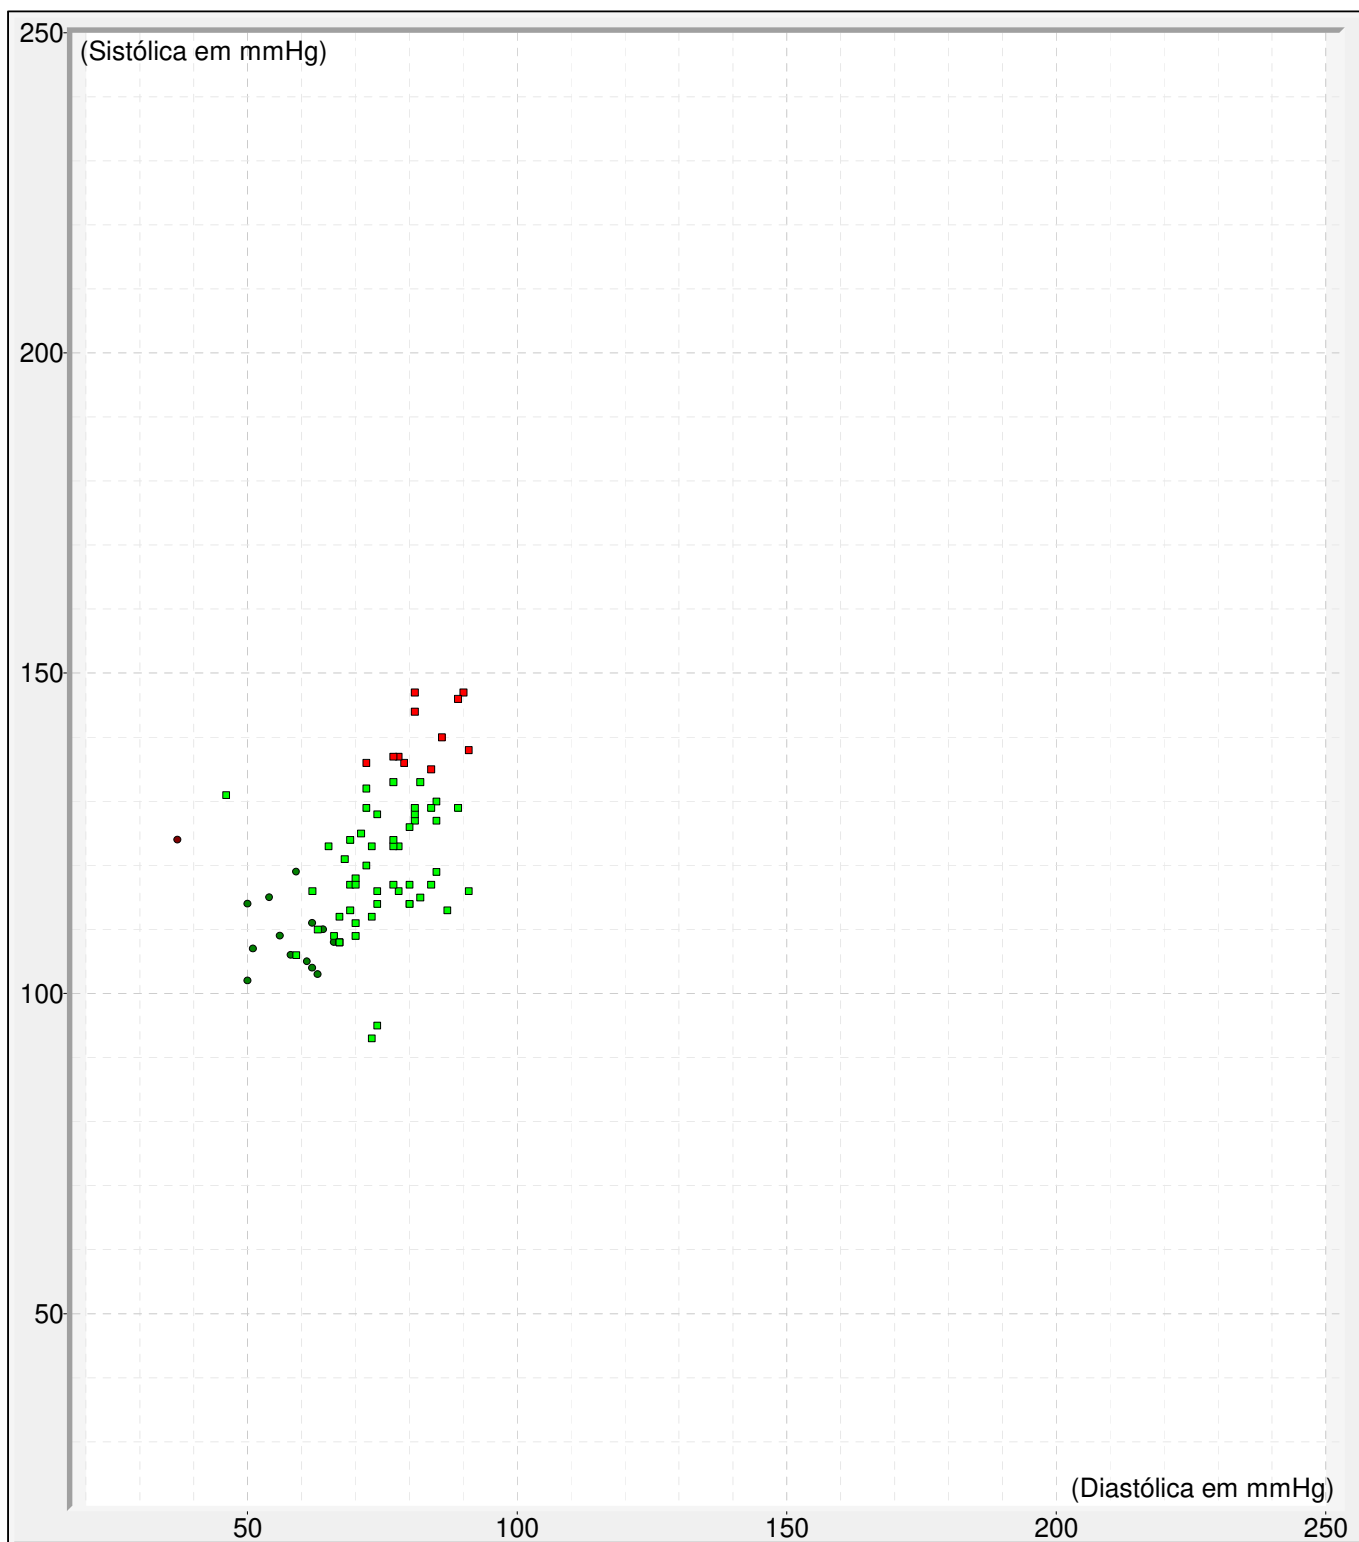

Histogramas

Nº do Exame: BL6-00085	Paciente: MATHEUS GONZATTO MADALOSSO Data de Instalação: 24/07/2025 13:32:05	Código: BL6-00085
---	---	------------------------------------

