

**RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE
LAGOA FORMOSA - MG**

1 - Dados do Exame

2 - Paciente

3 - Médico Solicitante

4 - Laudo Médico

5 - Data e Assinatura

© 2015 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 5.382 compilação 110.78

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Tabela das Medições

Nº do Exame B21-00294	Paciente: EVERALDO VIEIRA DE MAHALHAES Data de Instalação: 14/07/2025 08:59:32	Código: B21-00294
---------------------------------	---	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	09:03	118	80	98	38	75	Medição manual	49	21:45	103	55	77	48	53	
2	09:15	115	86	100	29	76		50	22:00	103	52	75	51	53	
3	09:30	112	82	96	30	73		51	22:15	117	77	96	40	56	
4	09:45	127	82	103	45	62		52	22:30	95	52	72	43	56	
5	10:15	99	84	91	15	78		53	22:45	102	51	74	51	57	
6	10:45	117	77	95	40	72		54	23:00	93	50	70	43	56	
7	11:00	117	87	101	30	66		55	23:30	99	63	79	36	57	
8	11:18	84	70	76	14	66		56	00:00	124	65	92	59	55	
9	11:33	119	82	99	37	76		57	00:30	111	73	90	38	62	
10	11:45	117	78	96	39	76		58	01:00	108	61	82	47	58	
11	12:00	144	78	108	66	88		59	01:30	107	60	82	47	60	
12	12:18	125	71	96	54	83		60	02:00	118	80	97	38	58	
13	12:30	129	83	104	46	81		61	02:30	114	66	88	48	60	
14	12:45	126	95	109	31	67		62	03:00	110	62	84	48	60	
15	13:00	120	84	101	36	69		63	03:30	118	86	100	32	57	
16	13:15	117	80	97	37	62		64	04:00	119	76	96	43	63	
17	13:30	124	91	106	33	86		65	04:30	120	79	98	41	54	
18	14:00	91	64	76	27	89		66	05:00	125	78	100	47	56	
19	14:15	131	83	105	48	62		67	05:30	121	79	98	42	58	
20	14:30	126	82	102	44	60		68	06:00	119	82	99	37	55	
21	14:45	119	85	101	34	60		69	06:30	157	104	128	53	56	
22	15:00	111	80	94	31	60		70	07:00	150	99	123	51	53	
23	15:15	119	79	97	40	60		71	07:15	137	89	111	48	54	
24	15:30	123	82	101	41	57		72	07:30	137	93	114	44	52	
25	15:45	128	82	103	46	58		73	07:45	132	87	107	45	55	
26	16:00	132	91	110	41	56		74	08:00	126	80	101	46	60	
27	16:15	132	88	108	44	60		75	08:15	125	79	100	46	54	
28	16:30	131	88	108	43	57		76	08:30	124	81	101	43	55	
29	16:45	143	83	111	60	55		77	08:45	129	87	107	42	54	
30	17:00	143	94	117	49	53		78	08:48						Aparelho desligado manualmente
31	17:15	140	89	113	51	54									
32	17:30	137	90	111	47	59									
33	17:45	129	86	105	43	60									
34	18:00	128	85	105	43	59									
35	18:15	136	82	107	54	62									
36	18:30	135	83	107	52	60									
37	18:45	133	86	107	47	61									
38	19:00	135	91	111	44	60									
39	19:15	135	86	108	49	58									
40	19:30	147	91	117	56	59									
41	19:45	123	77	98	46	57									
42	20:00	124	79	100	45	58									
43	20:18	124	80	100	44	57									
44	20:30	117	73	93	44	56									
45	20:45	127	79	101	48	56									
46	21:00	118	74	94	44	54									
47	21:15	119	80	98	39	58									
48	21:30	117	72	93	45	53									

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Análise Estatística

Nº do Exame B21-00294	Paciente: EVERALDO VIEIRA DE MAHALHAES Data de Instalação: 14/07/2025 08:59:32	Código: B21-00294
---------------------------------	---	------------------------------------

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	80	
Medições Válidas:	77 = 96%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	122 / 79 mmHg	até 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	124 / 81 mmHg	até 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	116 / 73 mmHg	até 120 / 70 mmHg
Pressão Matinal:	133 / 87 mmHg	
Ascenso Matinal*:	37 mmHg	
Descenso de P.A. no Sono:	6% / 10%	acima de 10% / 10%
Carga Pressórica** na Vigília:	16% / 33%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	25% / 56%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	18% / 38%	até 50% / 50%
* Ascenso Matinal: Diferença entre a média da pressão matinal e a média da menor pressão no sono.		
** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.		
3 - Valores Máximos em mmHg		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	150 mmHg às 07:00 hs	
PAD:	99 mmHg às 07:00 hs	
PAM:	123 mmHg às 07:00 hs	
PP:	66 mmHg às 12:00 hs	
Período do Sono:		
PAS:	157 mmHg às 06:30 hs	
PAD:	104 mmHg às 06:30 hs	
PAM:	128 mmHg às 06:30 hs	
PP:	59 mmHg às 00:00 hs	
4 - Valores Mínimos em mmHg		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	84 mmHg às 11:18 hs	
PAD:	51 mmHg às 22:45 hs	
PAM:	72 mmHg às 22:30 hs	
PP:	14 mmHg às 11:18 hs	
Período do Sono:		
PAS:	93 mmHg às 23:00 hs	
PAD:	50 mmHg às 23:00 hs	
PAM:	70 mmHg às 23:00 hs	
PP:	32 mmHg às 03:30 hs	
5 - Desvio Padrão das medições de P.A em mmHg		Valores Aceitáveis
Período Total:	13,6 / 11,0	
Período da Vigília:	13,3 / 9,9	até 12,0 / 9,0
Período do Sono:	13,9 / 13,0	até 10,0 / 8,0


CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico das Pressões

Nº do Exame B21-00294	Paciente: EVERALDO VIEIRA DE MAHALHAES Data de Instalação: 14/07/2025 08:59:32	Código: B21-00294
---------------------------------	---	------------------------------------

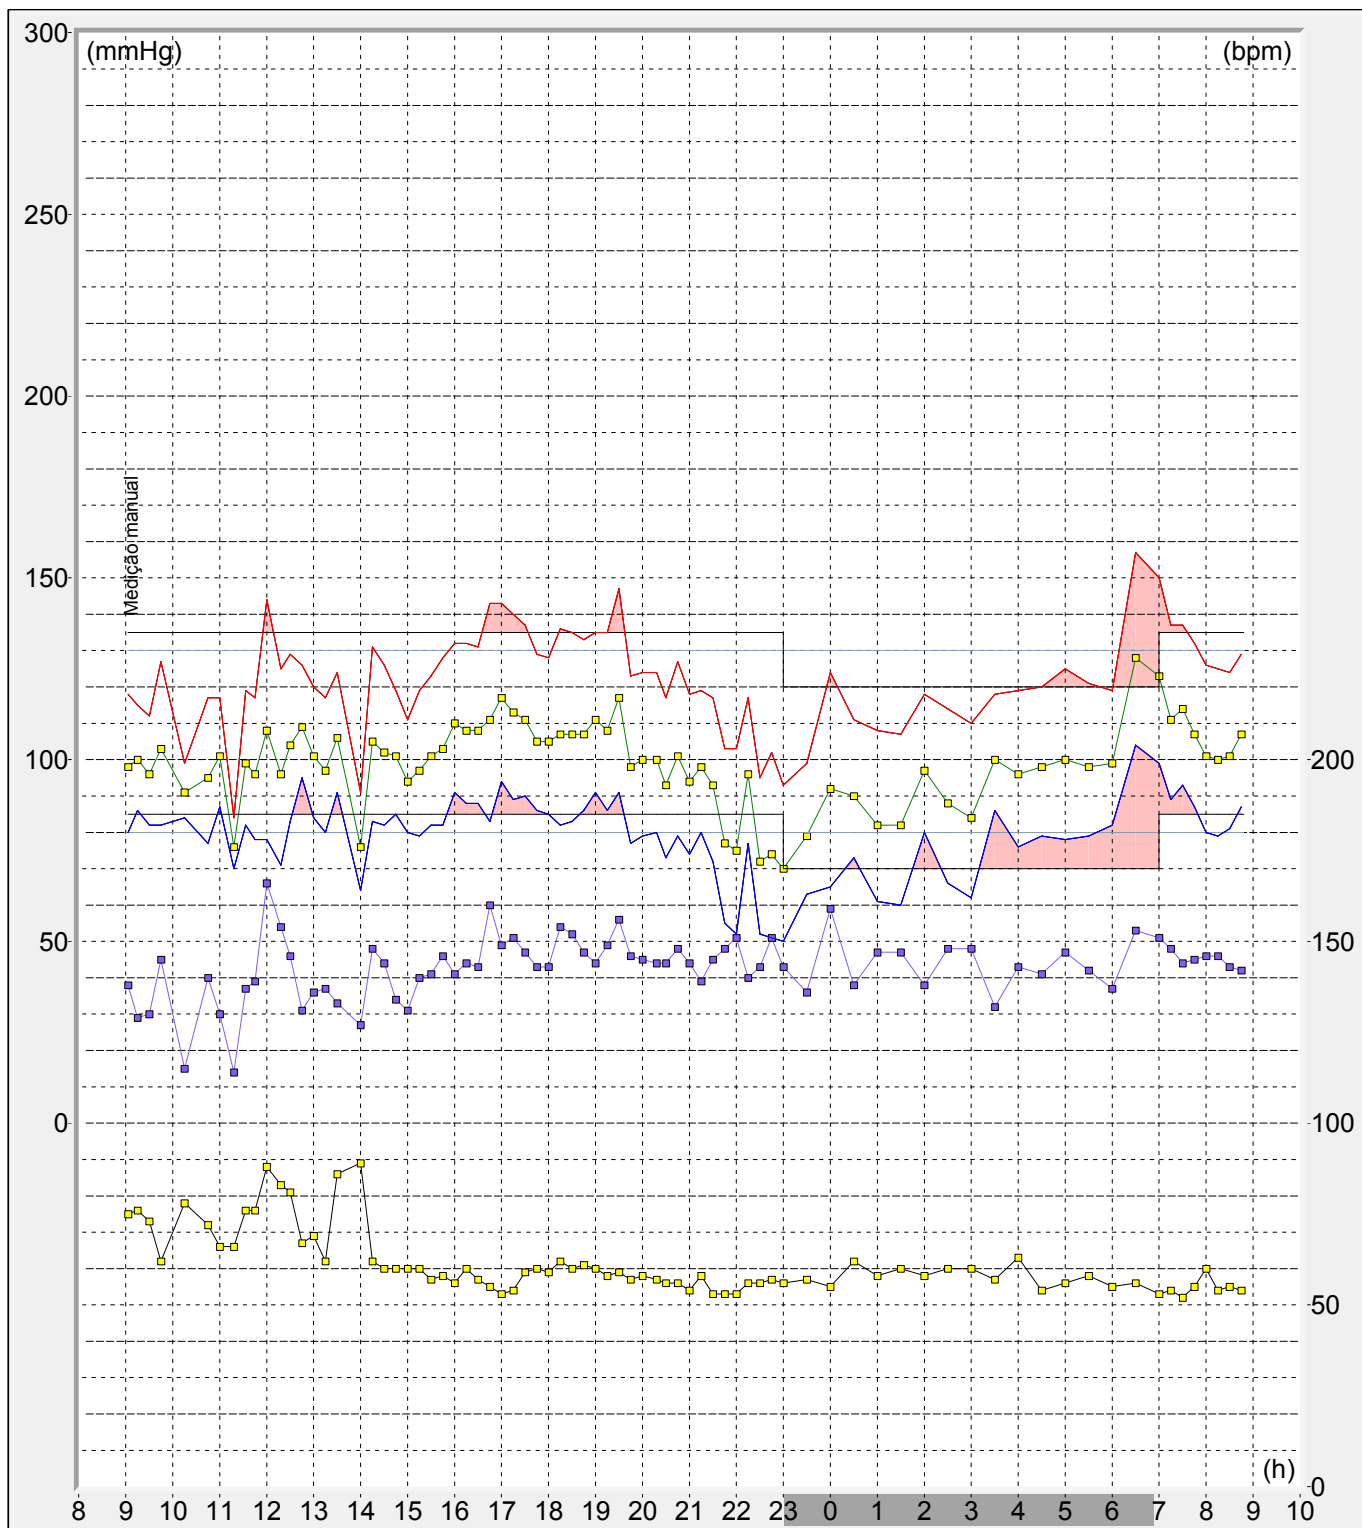


CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico de Tendências

Nº do Exame B21-00294	Paciente: EVERALDO VIEIRA DE MAHALHAES Data de Instalação: 14/07/2025 08:59:32	Código: B21-00294
---------------------------------	---	------------------------------------

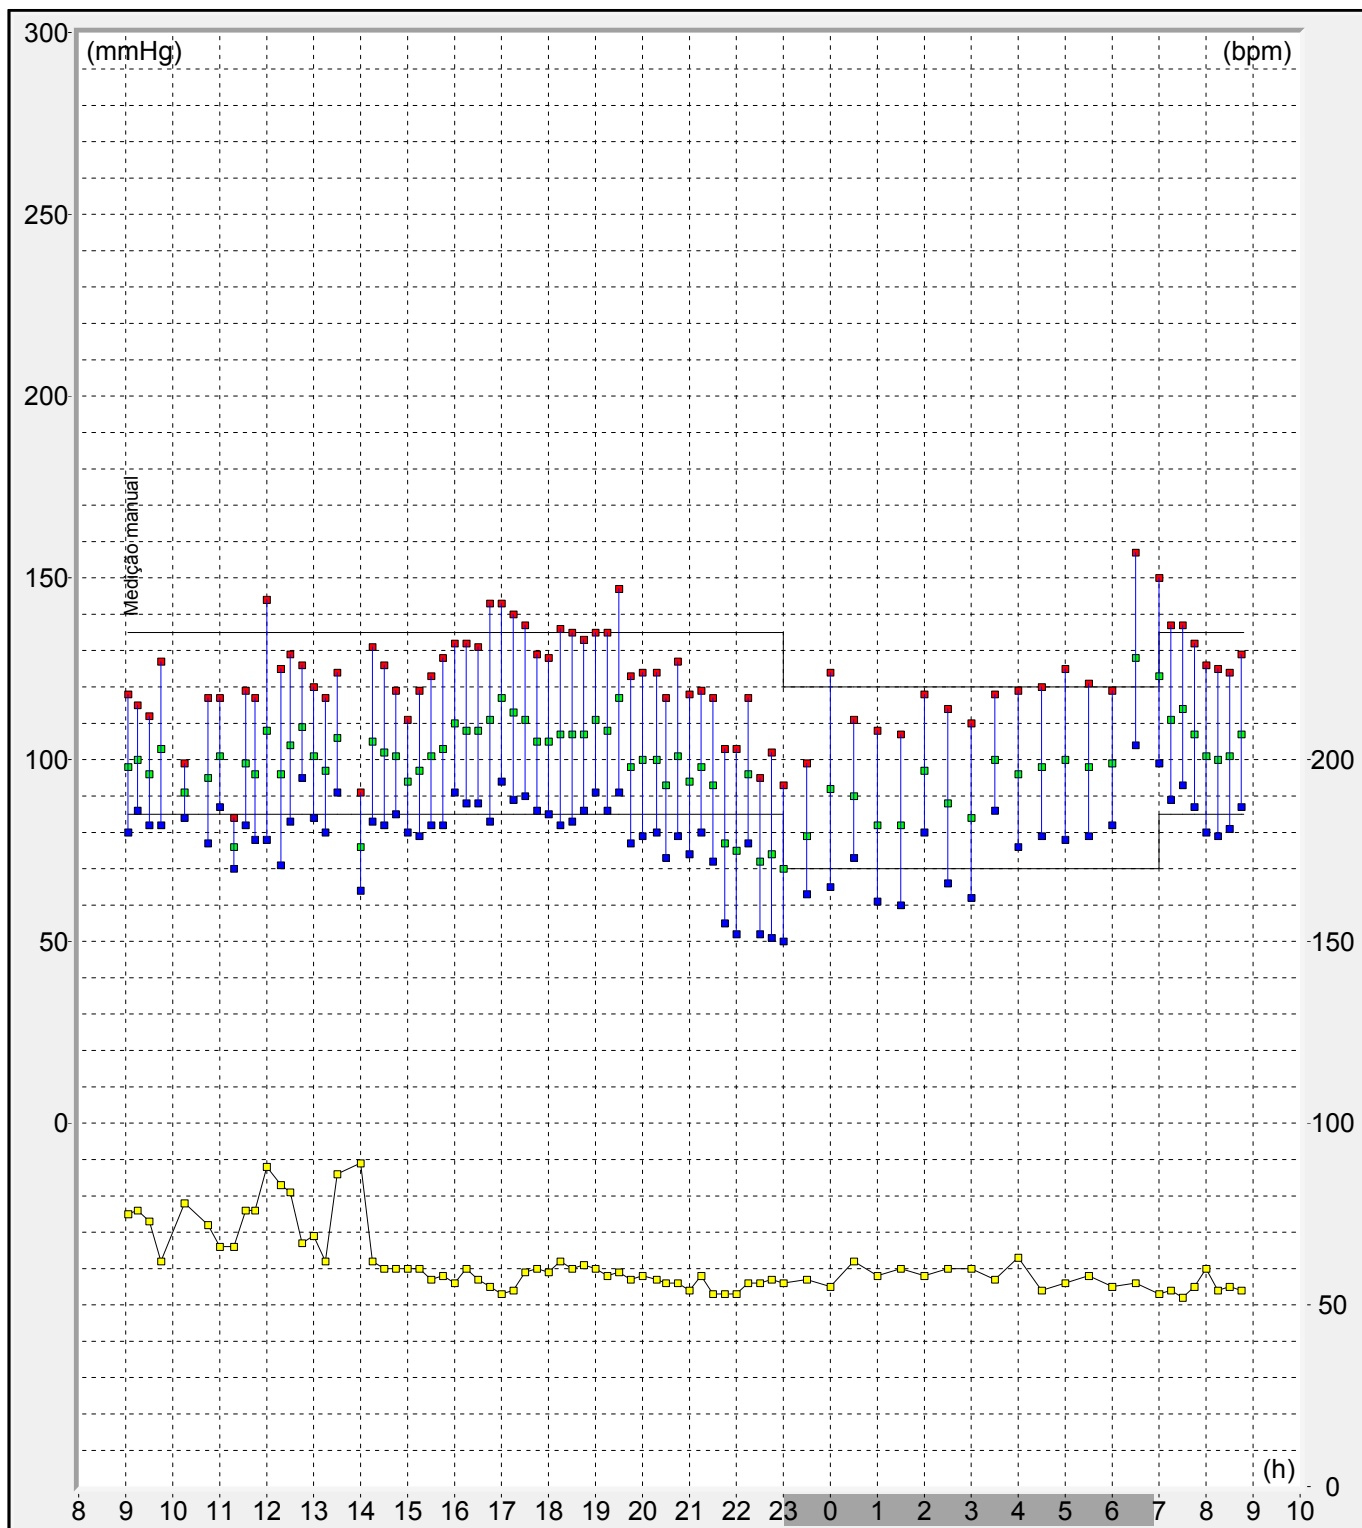


CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico de Correlação

Nº do Exame B21-00294	Paciente: EVERALDO VIEIRA DE MAHALHAES Data de Instalação: 14/07/2025 08:59:32	Código: B21-00294
---------------------------------	---	------------------------------------

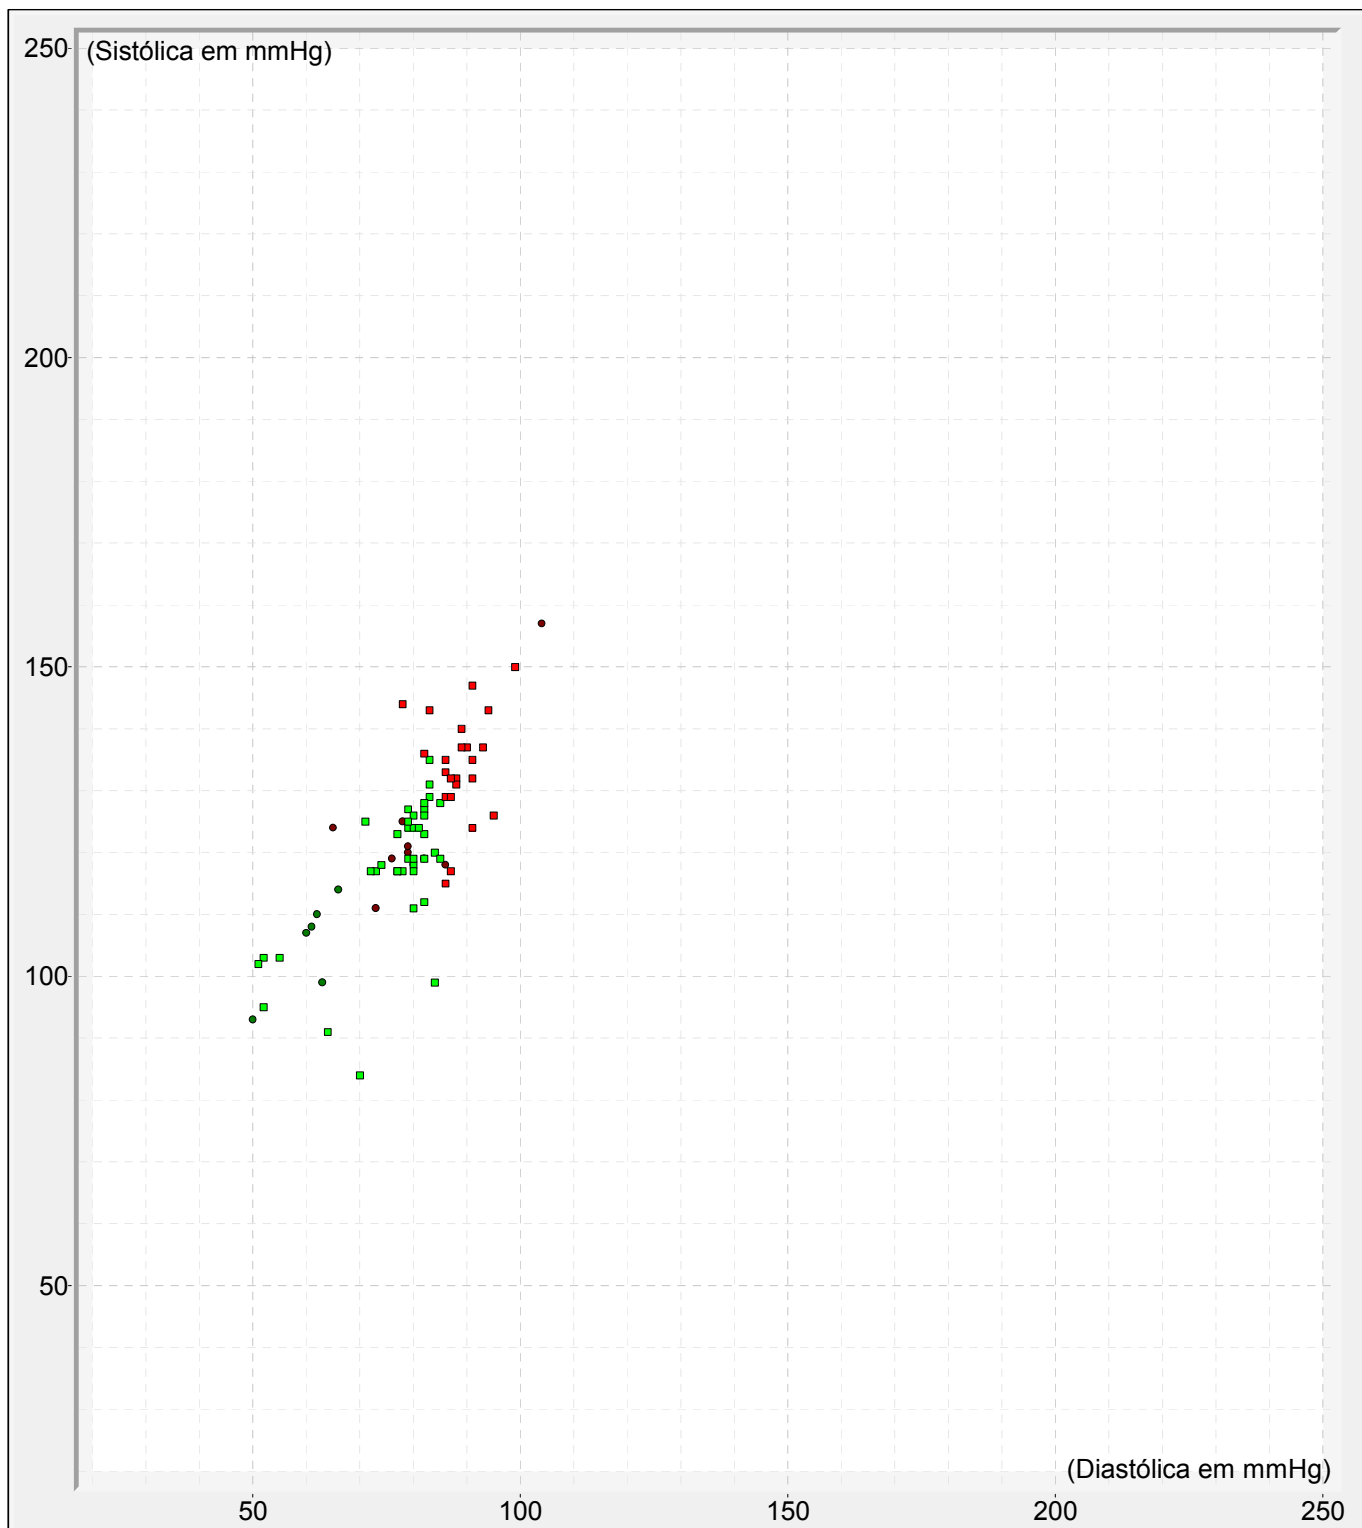

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Histogramas

Nº do Exame B21-00294	Paciente: EVERALDO VIEIRA DE MAHALHAES Data de Instalação: 14/07/2025 08:59:32	Código: B21-00294
---------------------------------	---	------------------------------------

