

# SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

**ID:** 6773628  
**Nome:** JADISON DOS SANTOS SILVA  
**Idade:** 38 anos 10 meses **DN:** 18/09/1986 **Data de exame:** 30/07/2025 07:56  
**Altura:** 170 cm **Peso:** 75 kg **IMC:** 26  
**Sexo:** Masculino **Etnia:** Caucasiana **Factor:** 100  
**Fumante:** Não **Dispneia:** 0

## Resumo de todos os testes forçados

	VEF1	CVF	PFE	VEF1/CVF	Qualidade	VAR	Tempo	Data
Base	3,60	4,09	9,50	88%	Bom sopro	-4%	07:57	30/07/2025
<b>Base*</b>	<b>3,80</b>	<b>4,21</b>	<b>10,11</b>	<b>90%</b>	<b>Bom sopro</b>		<b>07:57</b>	<b>30/07/2025</b>
Base	3,67	4,10	9,47	90%	Bom sopro	-3%	07:58	30/07/2025
Base	3,69	4,26	9,66	87%	Bom sopro	-1%	07:58	30/07/2025

Chave: \* - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

## Índices seleccionados dos melhores sopros

Índice	Base	% Prev.	Valo rZ	Pós1	% Prev.	%alt	Valo rZ	[Mín. Prev. Máx.]	DP
VEF1	3,80 l	95%						3,24 l 4,00 l 4,76 l	
VEF6	4,21 l	88%						3,94 l 4,81 l 5,68 l	
CVF	4,21 l	87%						3,92 l 4,82 l 5,72 l	
VEF1/CVF	90%	109%						75% 83% 91%	
PFE	10,11 l/s	90%						8,51 l/s 11,20 l/s 13,89 l/s	
FEF50	5,48 l/s	108%						3,06 l/s 5,09 l/s 7,13 l/s	
FEF25-75	4,72 l/s	113%						2,48 l/s 4,20 l/s 5,92 l/s	
FEF25-75/CVF	112 /s	128%						56 /s 88 /s 119 /s	
TEF	2,96 s								


Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais

relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


**Fonte prevista:** Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos, Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

### Gráfico de volume de fluxo melhor

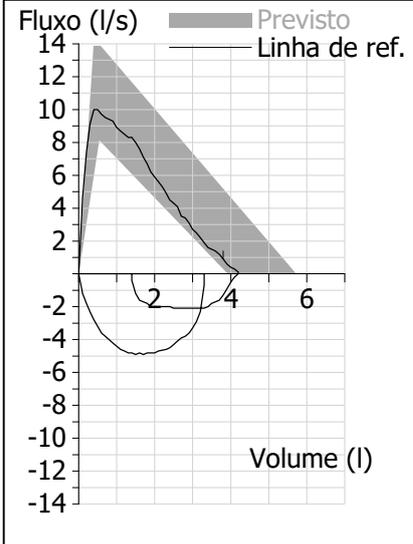

### Melhor gráfico de volume/tempo

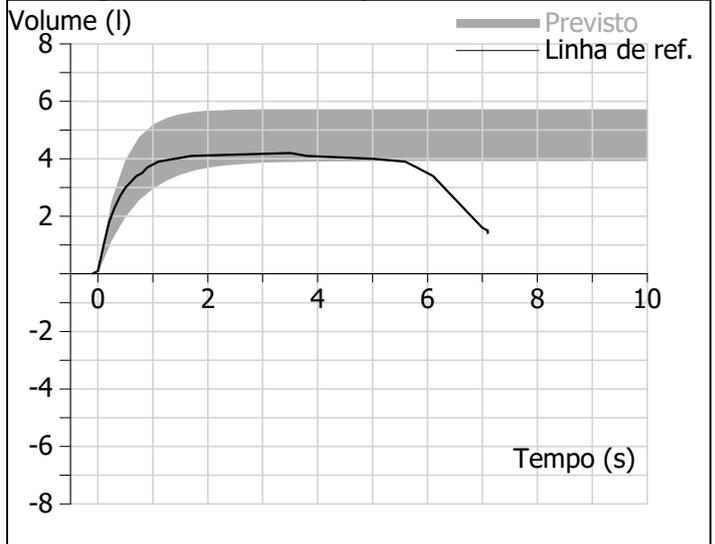

### Notas de exame

QUALIDADE DO EXAME; A