


Alex de Almeida Soares.

2025-07-04, 08:52
10mm/mV

Real-Time Modo

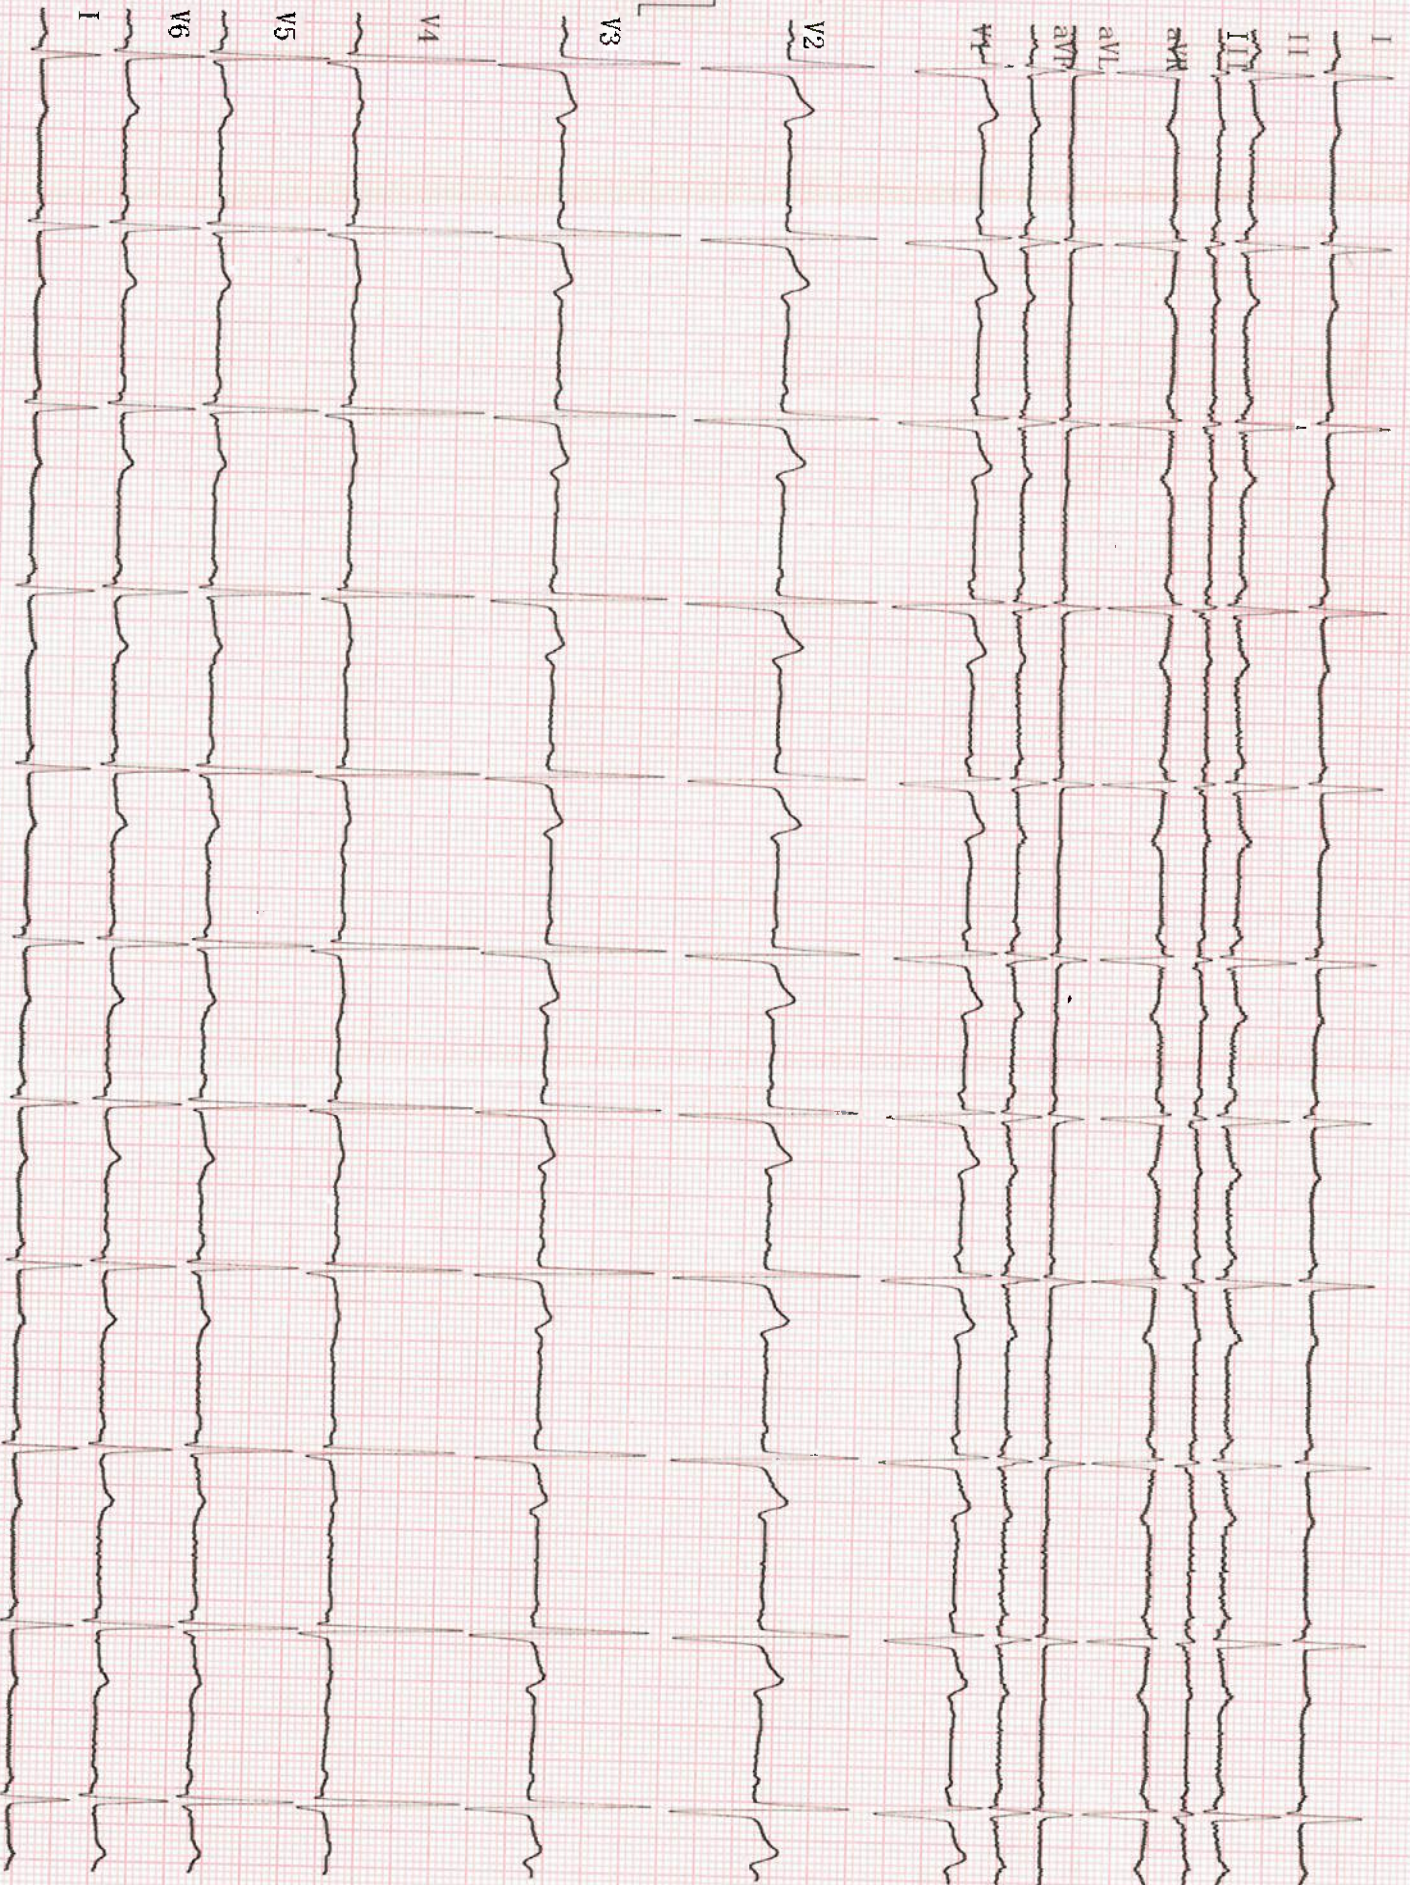

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARE ECG-200 V4.06.000