


Christian Ricardo da Silva DN. 10/08/1998

Real Tempo Modo

08:43

10mm/mV

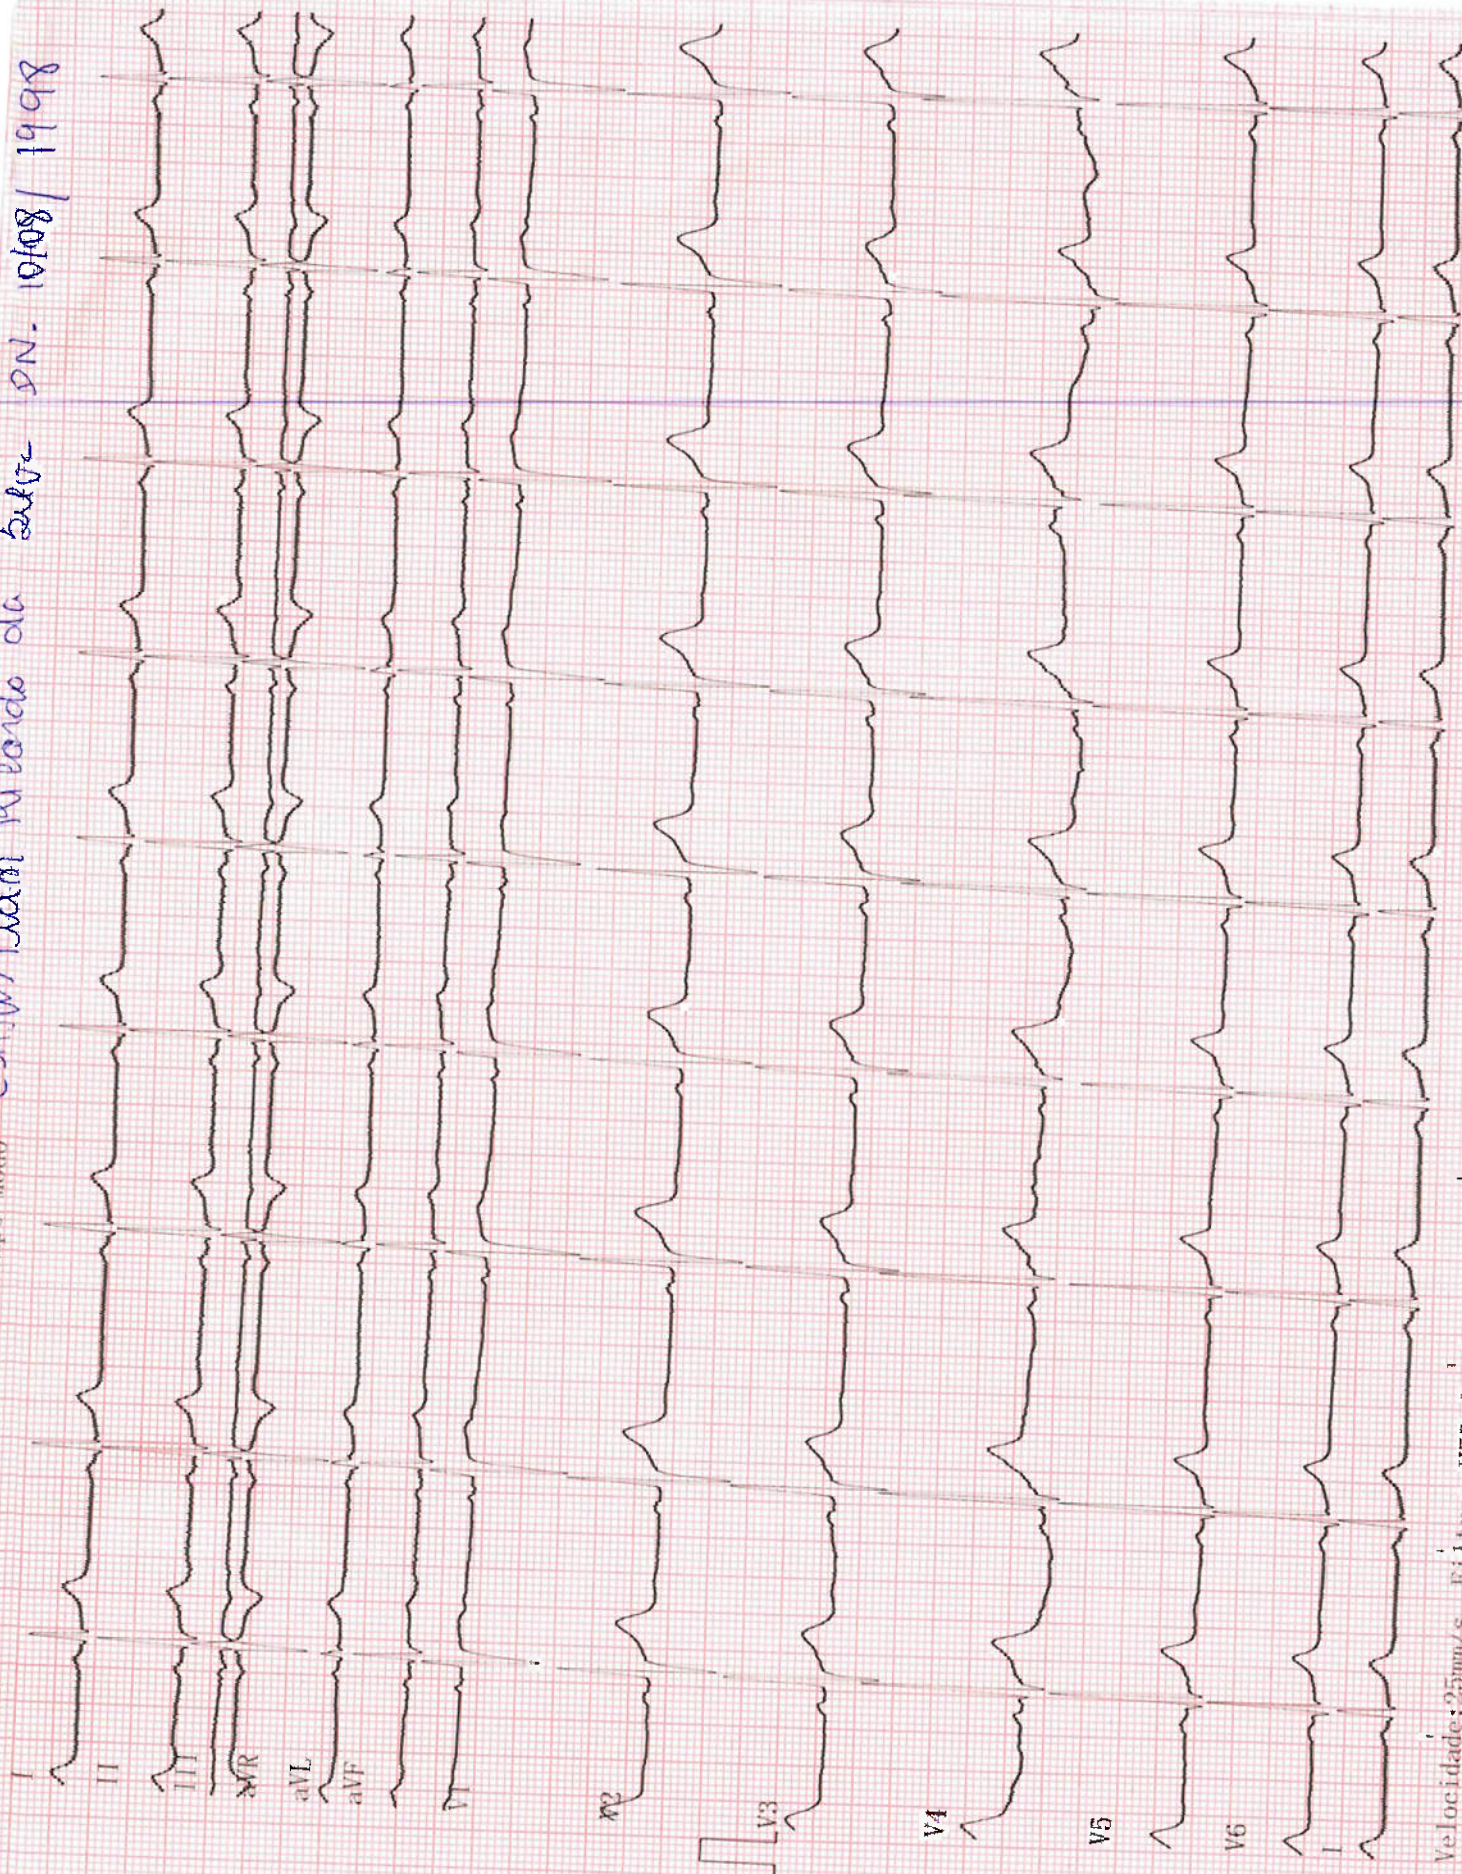

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARD ECG 1200 V1.06.000