


2025 07 21, 12:01

Real Tempo Modo

Douglas Cardoso Marques da Fonseca 35

10mm/mV

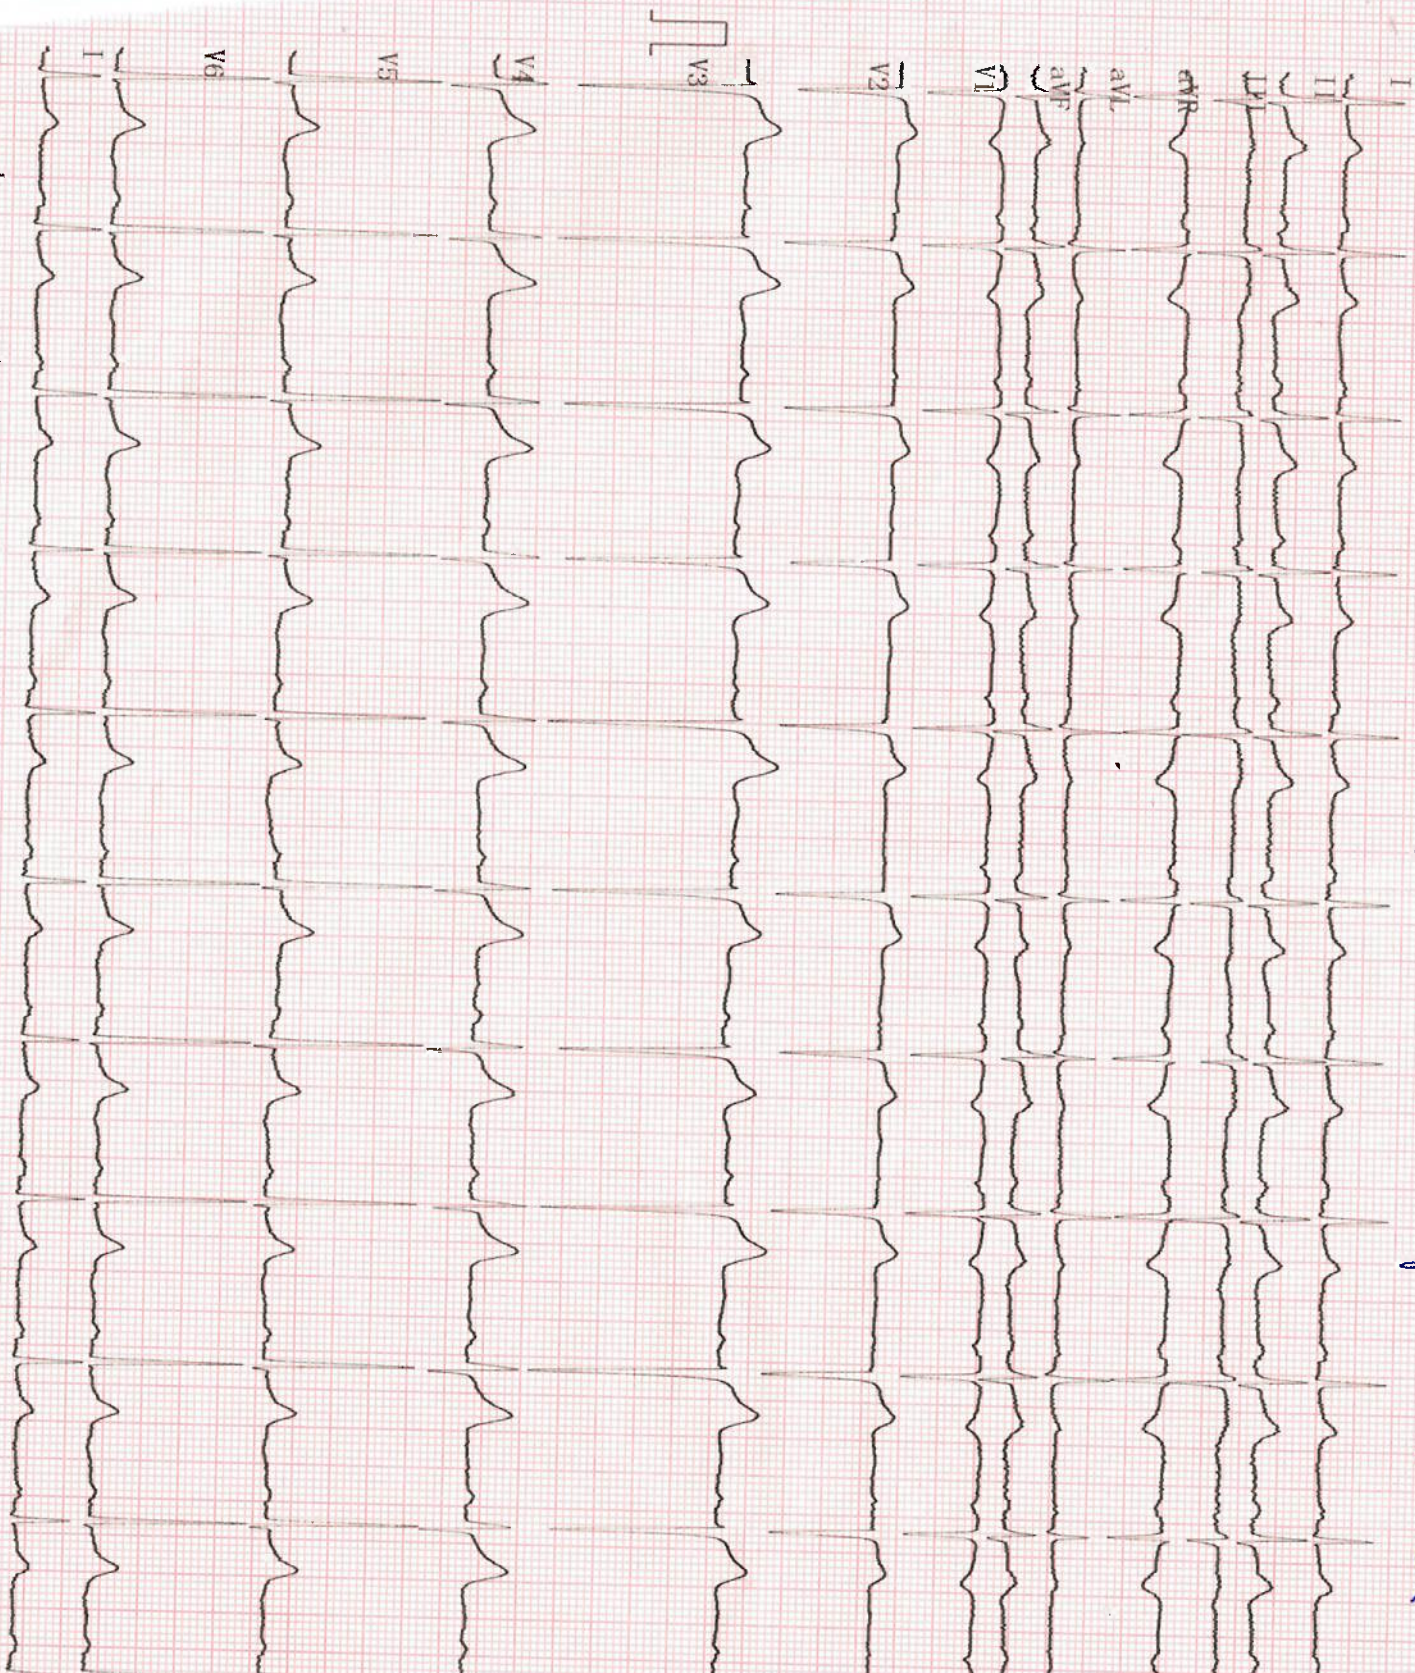

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARE ECG-1200 V4.06.000