


Andersen Alves dos Santos 28 anos

Real Tempo Modo

2025-08-11, 11:44

10mm/mV

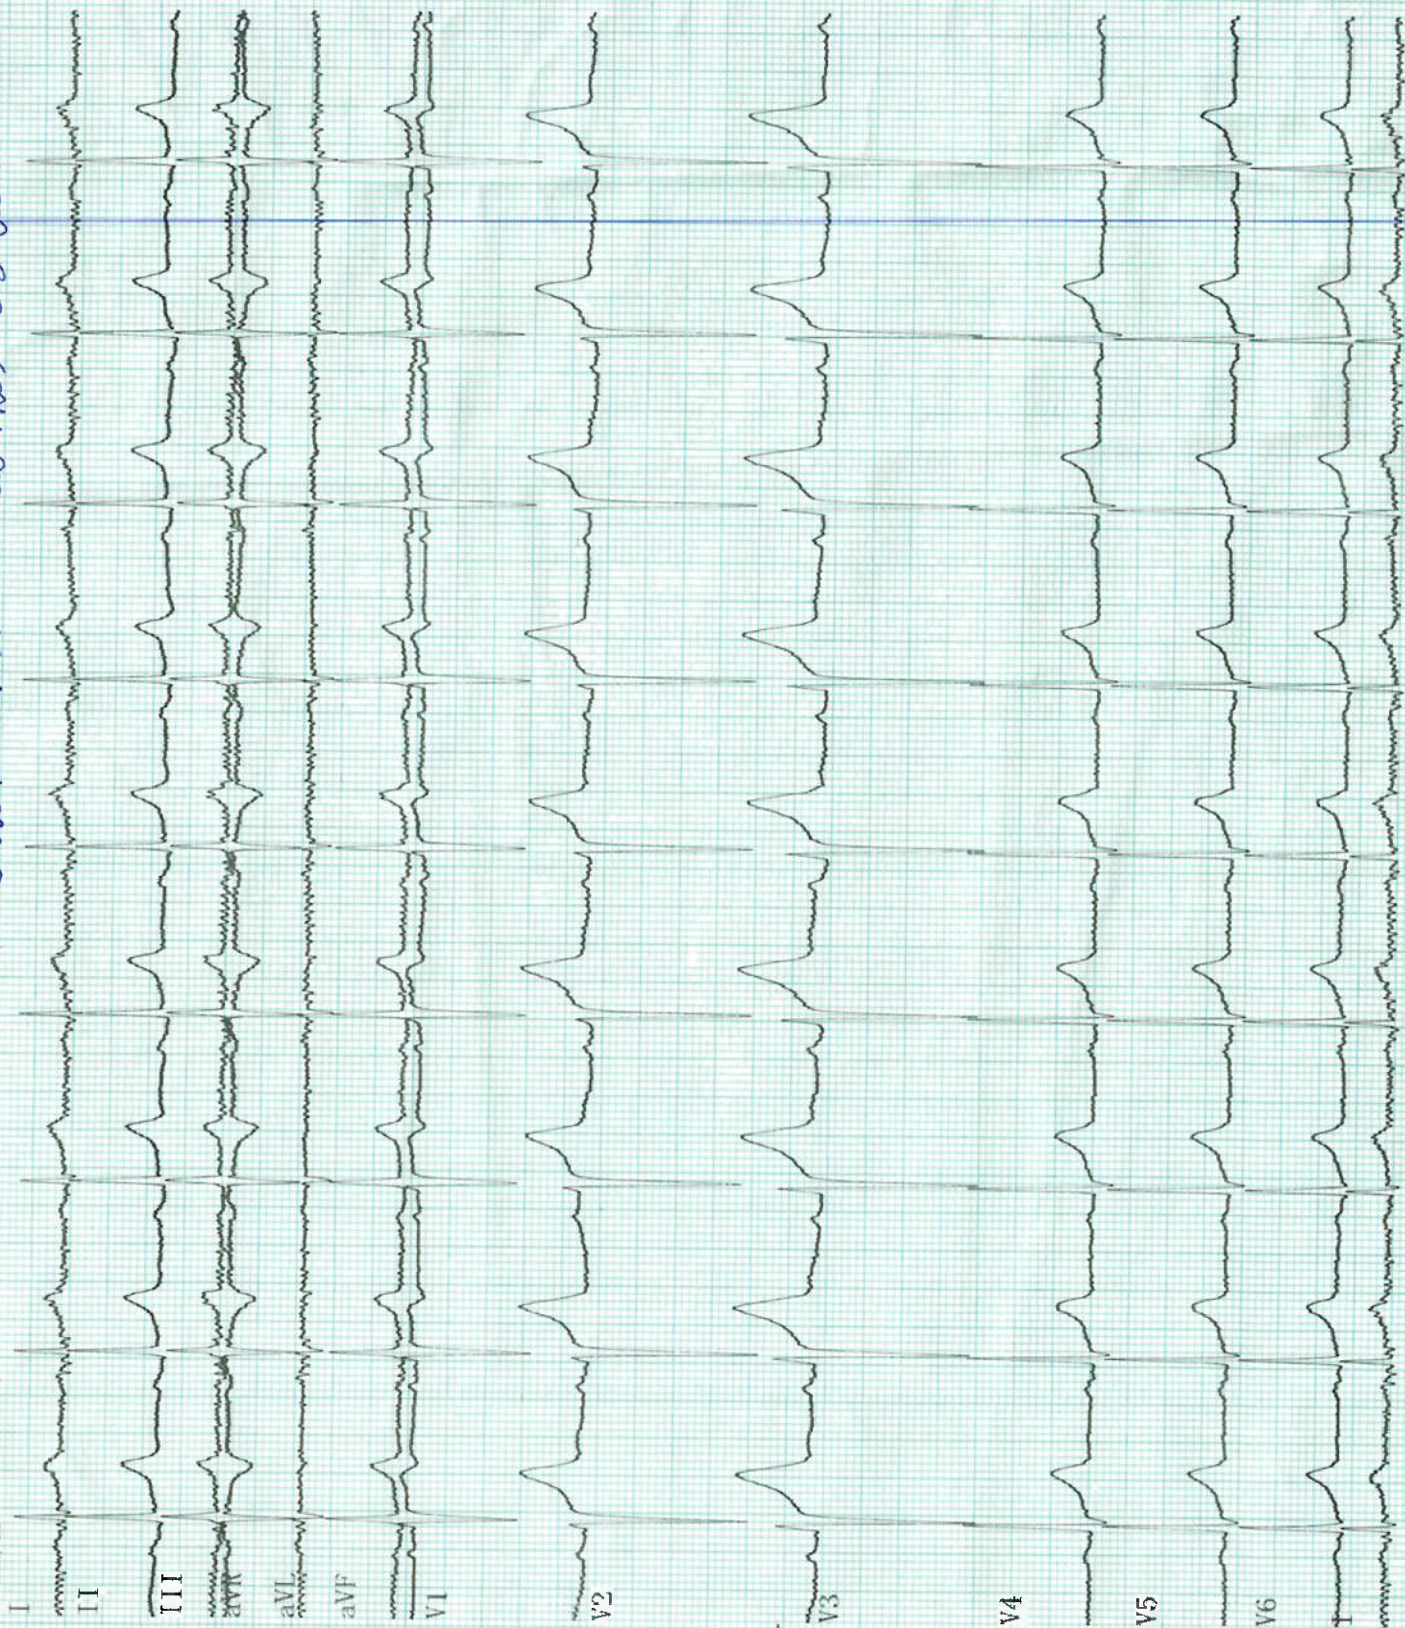

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIO CARE ECG-1200 V4.06.000