


Joachim Búcio da Silva

2025.07.24 08:26
10mm/mV

Real Tempo Modo

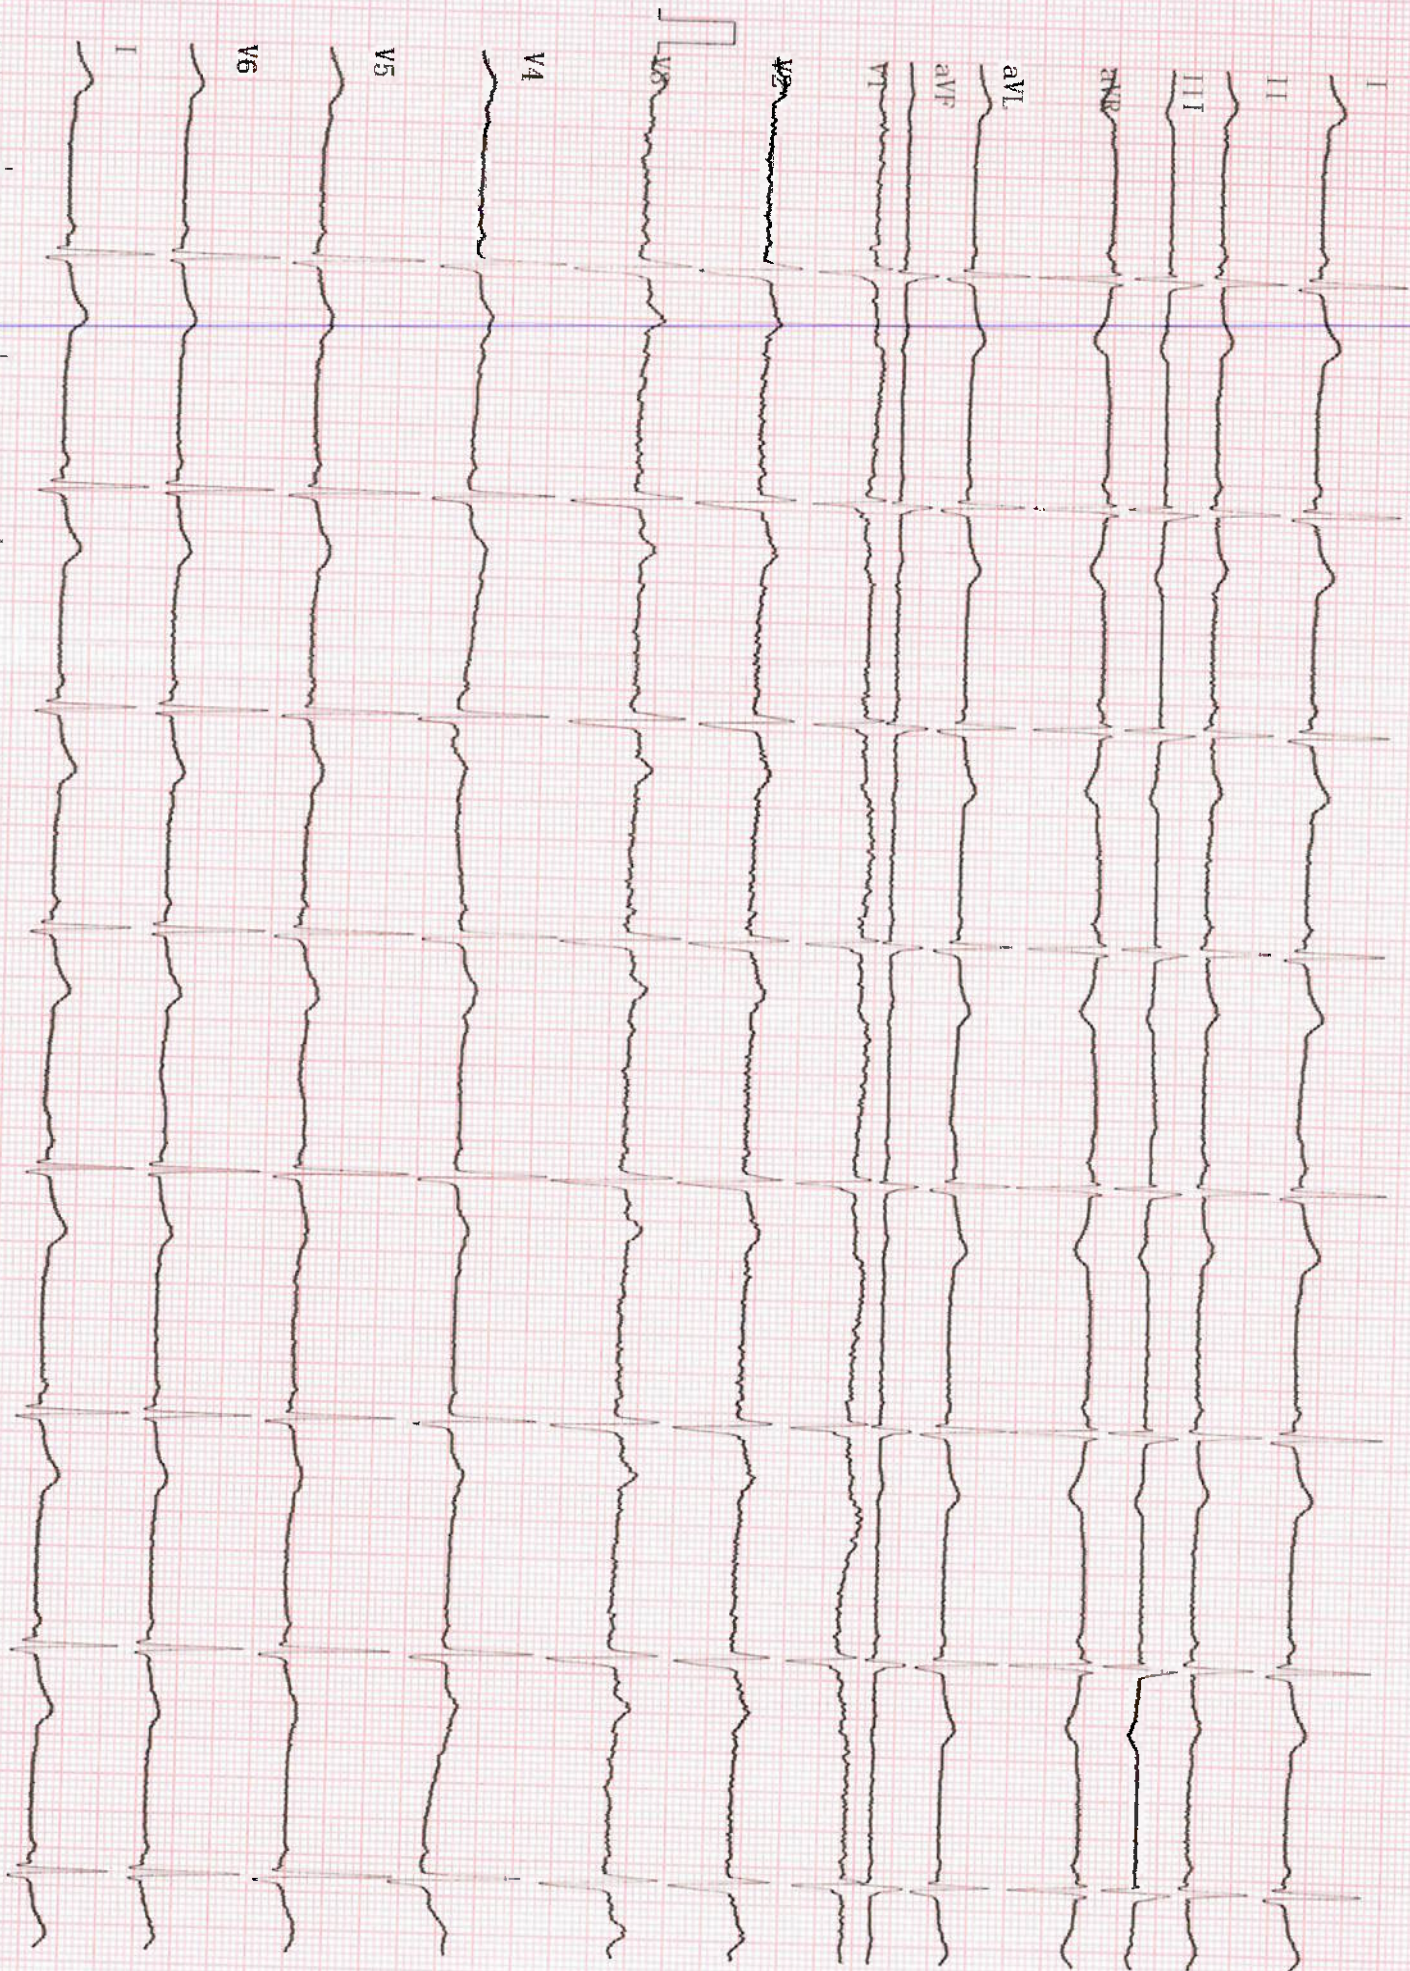

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARE ECG-1200 V1.06.000