


Adriano Jose da Silva

Velocidade: 25mm/s Filtro: 150 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARD ECG 1200 V4.06.000

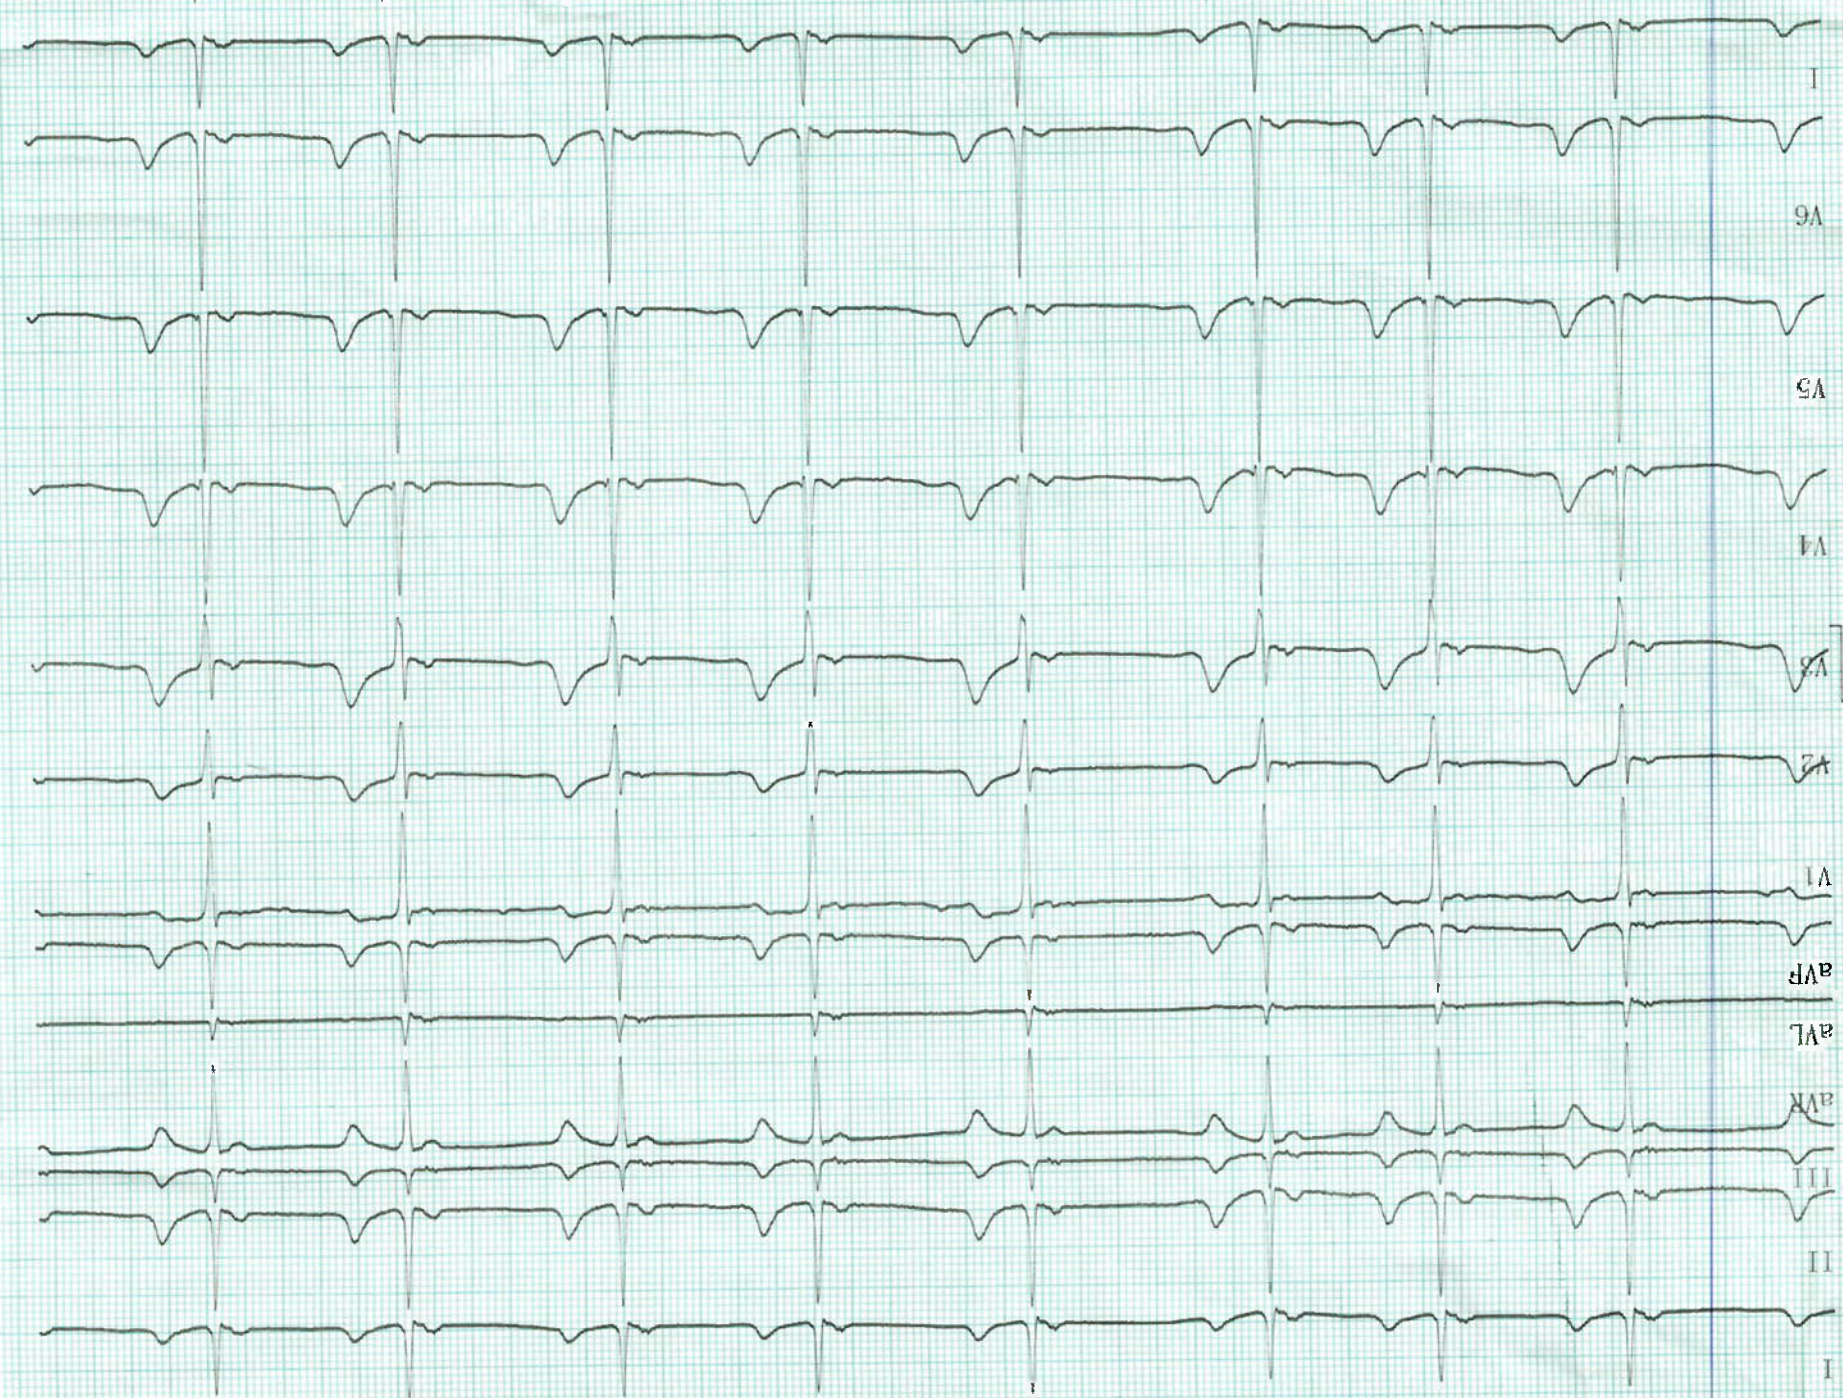

2025-08-12, 09:03 Real Tempo Modo 10mm/mV