


20/15 07 29, 11:27

Real Tempo Modo

Bondito por da Silva 47 anos

10mm/mV

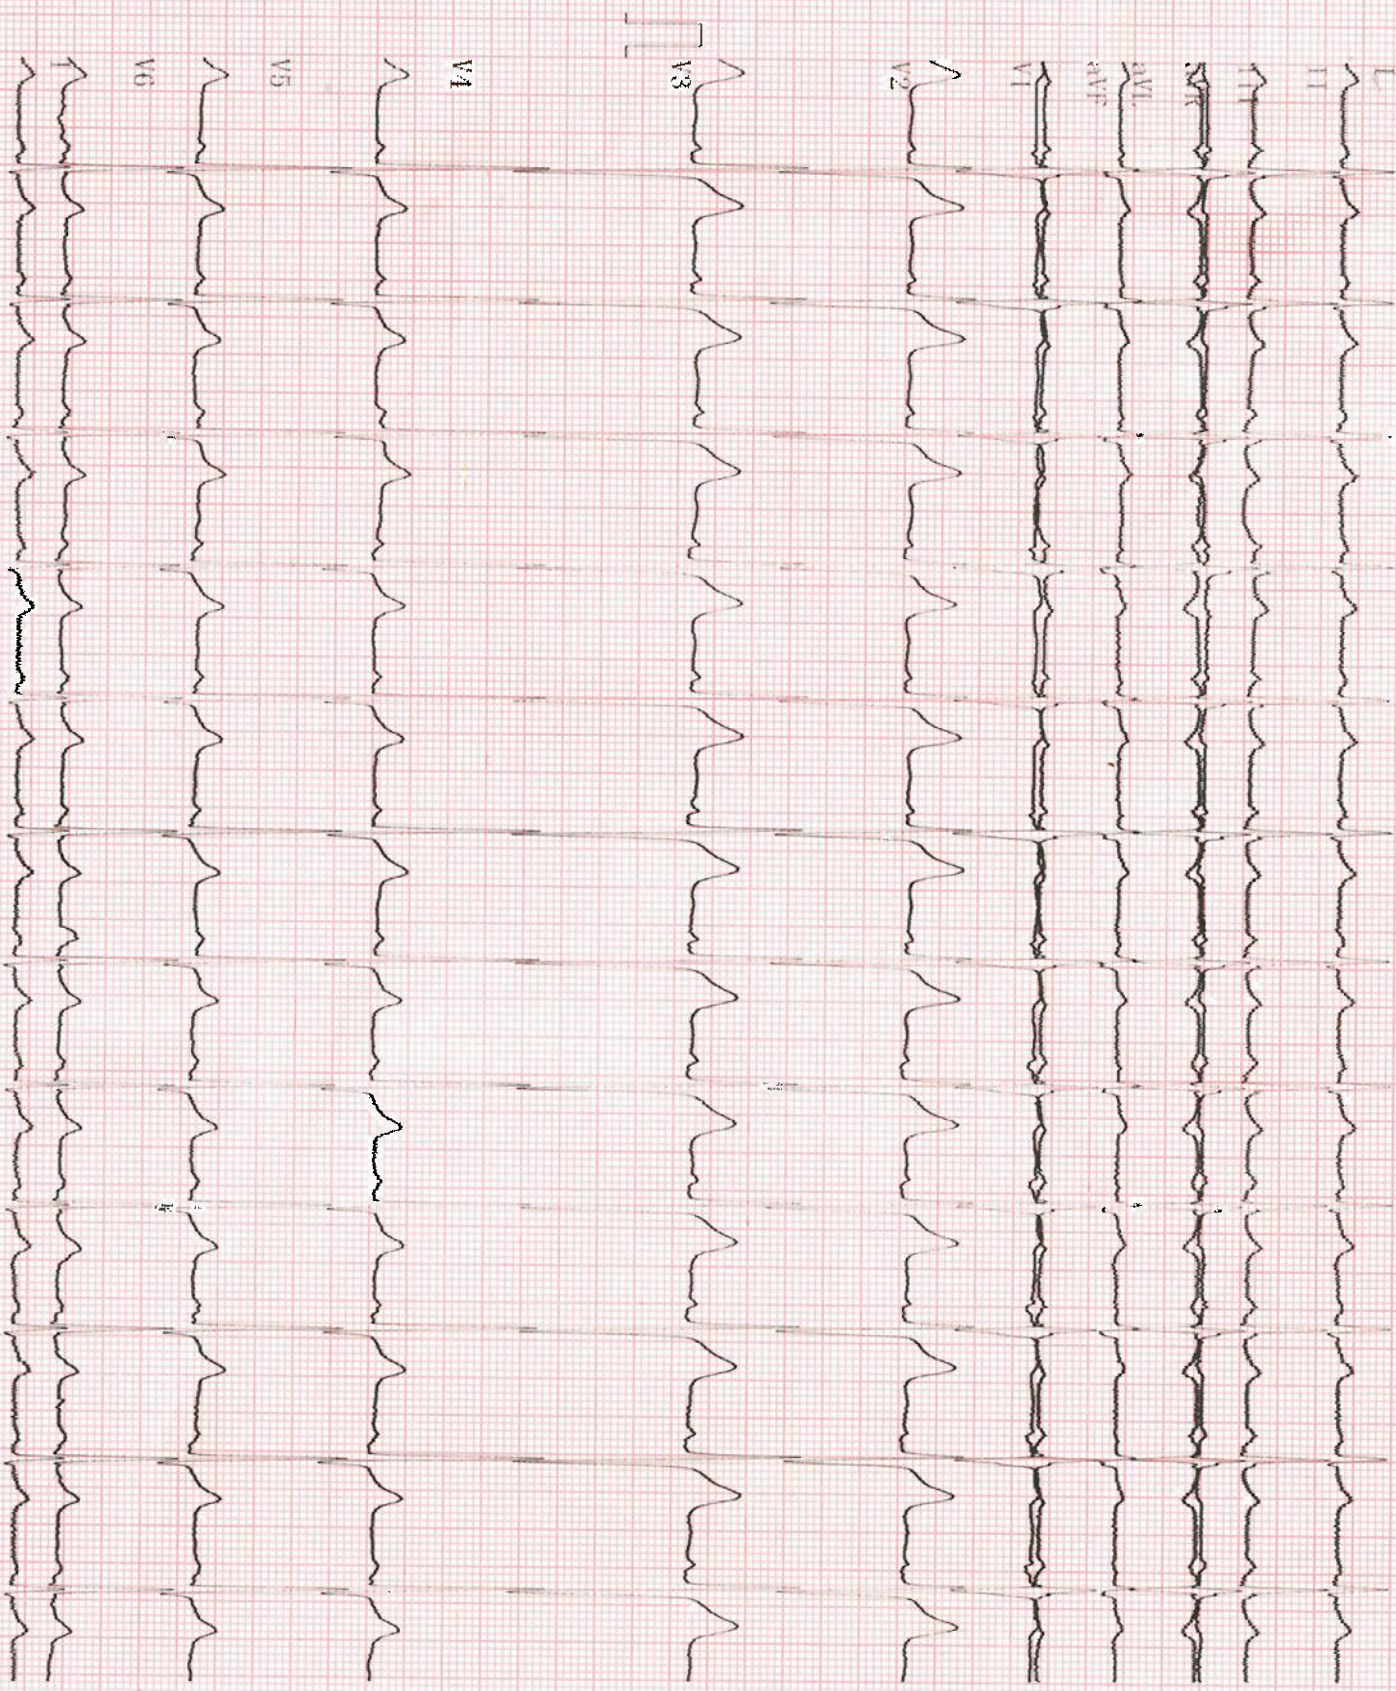

Velocidade: 25mm/s Filtro: 450 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARE ECG 1200 V4.06.000