


Rodolfo Silva de Sousa

2025 08 12, 08:19 Real Tempo Modo
10mm/mV

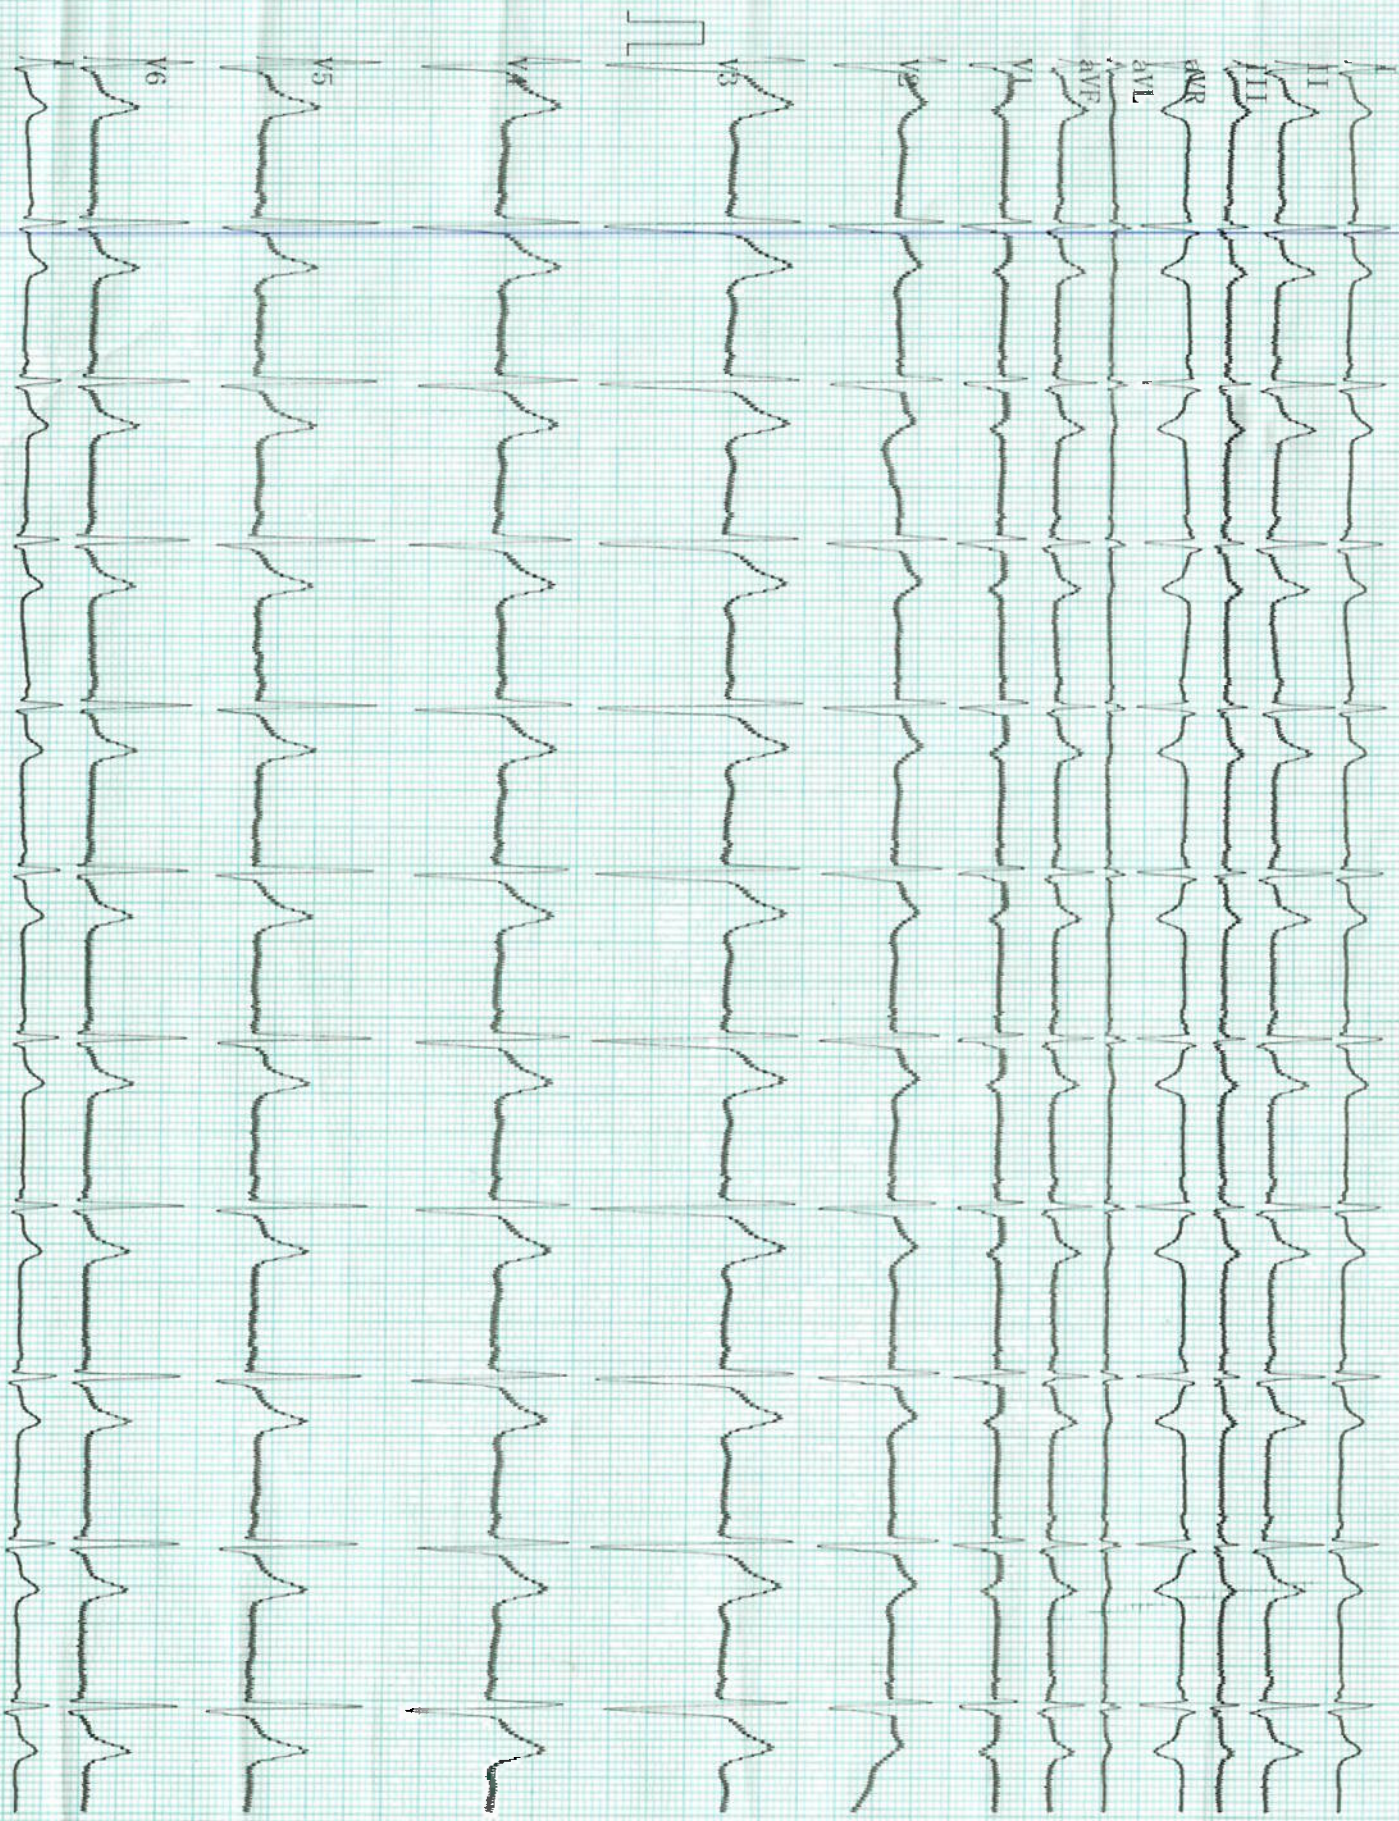

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARE ECG 1200 V4.06.000