


2025-07-29, 08:11
1.0mV/mV

Real Tempo Modo

Manual medição por via da SDA 33 aus

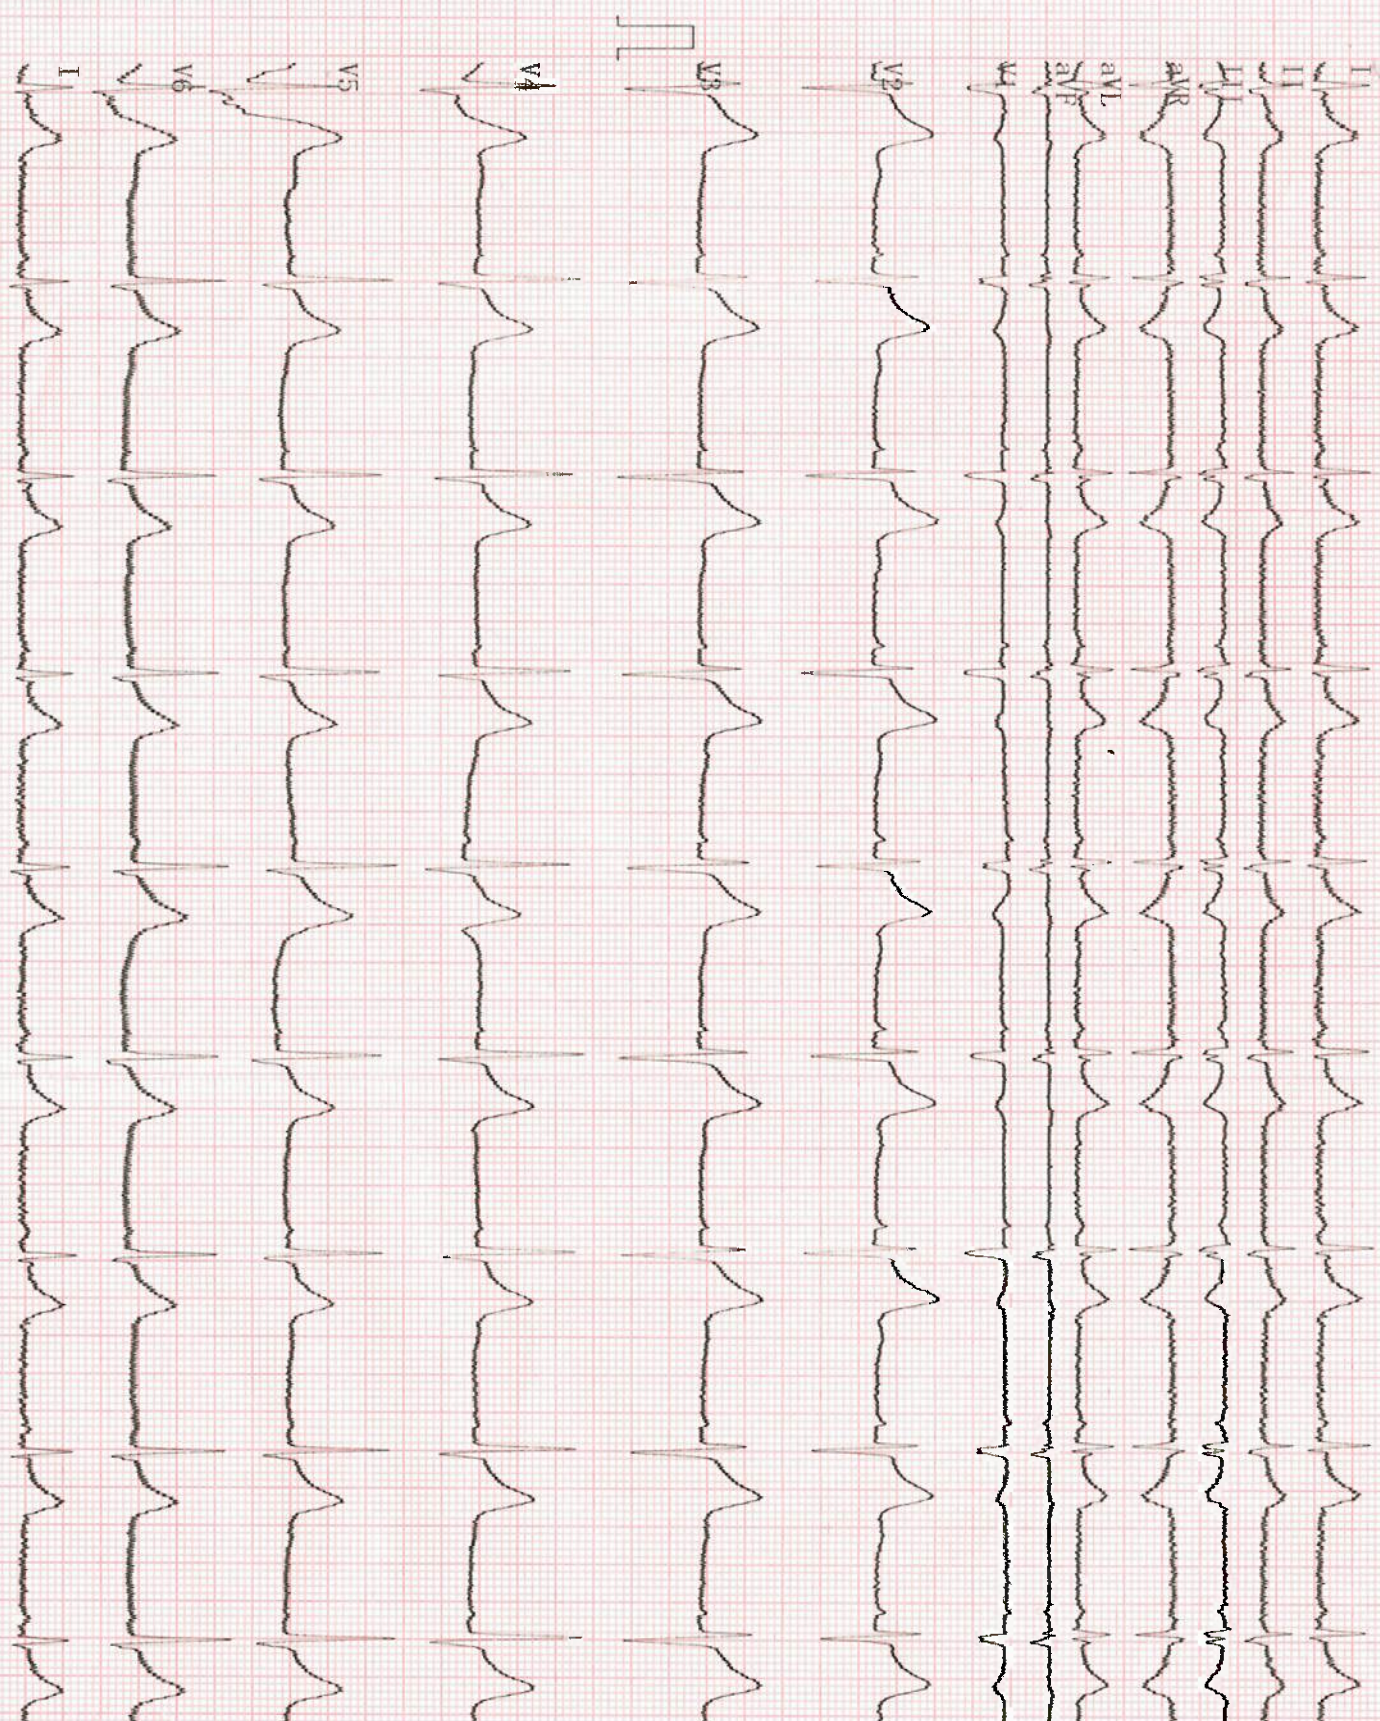

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARD ECG-1200 V4.06.000