


2025-07-29, 08:27
1.0mm/mV

Real-Time Modo

Ronaldo Henrique Trindade da Silva 44 anos

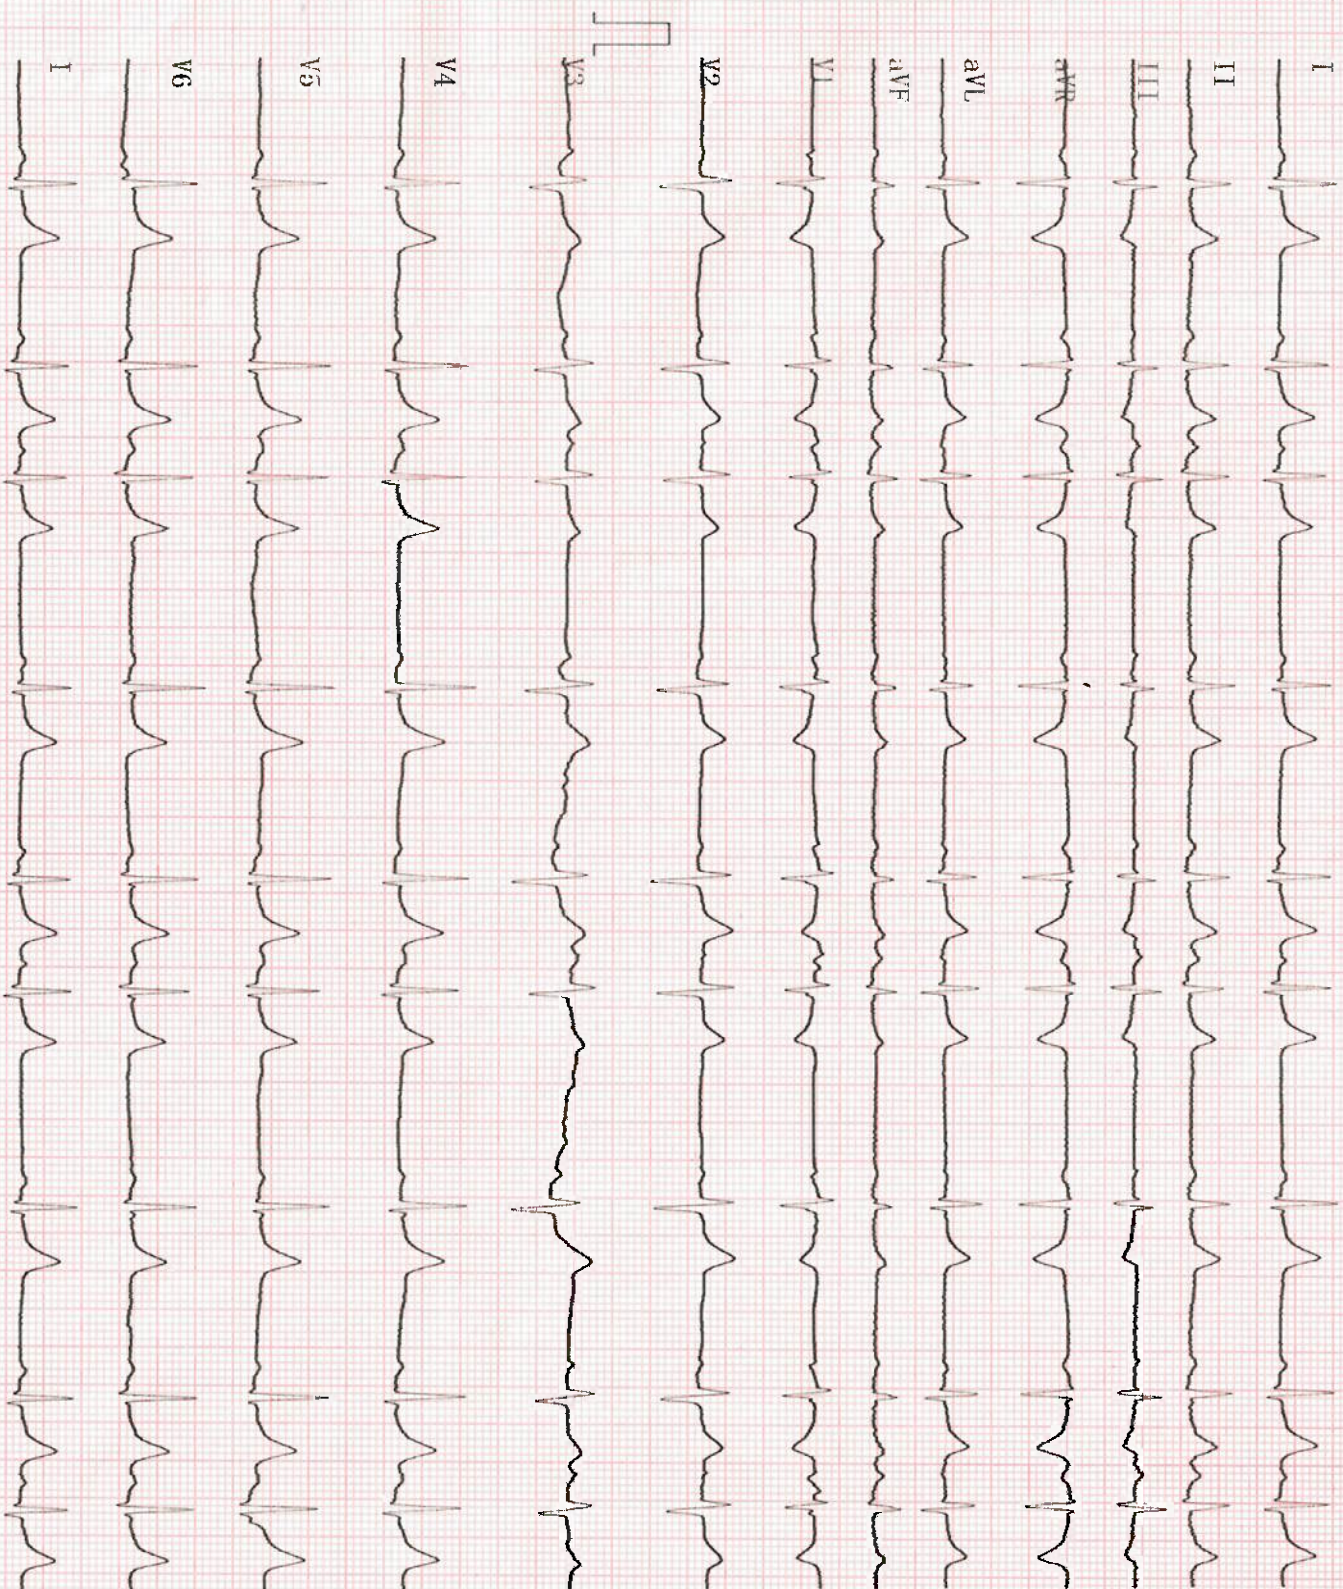

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARE ECG 1200 V4.06.000