CEM - CENTRO DE ESPECIALIDES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE
LAGOA FORMOSA - MG

Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

1 - Dados do Exame

Nº do Exame	Data de Instalação: 12/08/2025 15:19 Término: 13/08/2025 12:46	Código:
B21-00305	Protocolo de Medições: Padrão	**B21-00305**

2 - Paciente

Nome: WALTER PEREIRA DA SILVA
Idade: 68
Sexo: M
Altura: 1,76
Peso: 82
Fumante: Não
Tel:
Fax:

Diagnóstico:

Motivo do Exame:

3 - Médico Solicitante

Nome: JASSIARA SOARES DA SILVA
Tel:
Clínica:
Fax:

4 - Laudo Médico

5 - Data e Assinatura

13/08/2025

ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA
C.R.M.:

© 2015 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 5.382 compilação 110.78

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE
LAGOA FORMOSA - MG

Tabela das Medições

Nº do Exame	Paciente: WALTER PEREIRA DA SILVA	Código:
B21-00305	Data de Instalação: 12/08/2025 15:19:52	B21-00305

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	15:25	162	93	125	69	56	Medição manual								
2	15:30	156	95	123	61	65									
3	15:48	135	79	105	56	66									
4	16:00	138	92	113	46	57									
5	16:18	130	81	104	49	55									
6	17:15	138	72	102	66	60									
7	18:33	152	81	114	71	59									
8	19:00	130	88	107	42	60									
9	19:18	128	59	91	69	63									
10	19:33	145	78	109	67	65									
11	20:18	153	79	113	74	60									
12	20:48	145	86	113	59	60									
13	21:03	155	80	114	75	59									
14	21:30	170	99	132	71	61									
15	22:00	136	68	99	68	57									
16	22:30	122	62	90	60	56									
17	22:48	110	59	83	51	56									
18	23:03	123	70	94	53	56									
19	23:33	103	52	75	51	55									
20	00:03	116	56	84	60	53									
21	01:59						Aparelho foi religado								
22	02:29						Aparelho foi religado								
23	02:59						Aparelho foi religado								
24	03:29						Aparelho foi religado								
25	04:00	139	68	101	71	62									
26	05:33	130	75	100	55	71									
27	06:03	125	78	100	47	60									
28	06:30	236	181	206	55	65									
29	07:03	124	69	94	55	53									
30	08:45	114	70	90	44	61									
31	09:33	125	79	100	46	66									
32	10:00	104	61	80	43	76									
33	11:00	124	64	91	60	57									
34	12:30	131	76	101	55	59									
35	12:46						Aparelho desligado manualmente								

© 2015 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 5.382 compilação 110.78

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE
LAGOA FORMOSA - MG

Análise Estatística

Nº do Exame	Paciente: WALTER PEREIRA DA SILVA	Código:
B21-00305	Data de Instalação: 12/08/2025 15:19:52	**B21-00305**

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	**69**	
Medições Válidas:	**30 = 43%**	
2 - Valores Médios		**Valores Aceitáveis**
Período Total:	**137 / 78** mmHg	até 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	**136 / 77** mmHg	até 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	**139 / 83** mmHg	até 120 / 70 mmHg
Pressão Matinal:	**119 / 70** mmHg	
Ascenso Matinal*:	**5** mmHg	
Descenso de P.A. no Sono:	**-2% / -8%**	acima de 10% / 10%
Carga Pressórica** na Vigília:	**48% / 26%**	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	**71% / 43%**	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	**53% / 30%**	até 50% / 50%

* Ascenso Matinal: Diferença entre a média da pressão matinal e a média da menor pressão no sono.
** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.

3 - Valores Máximos em mmHg			**Comentários**
Período da Vigília:			
PAS:	**170 mmHg**	às 21:30 hs	
PAD:	**99 mmHg**	às 21:30 hs	
PAM:	**132 mmHg**	às 21:30 hs	
PP:	**75 mmHg**	às 21:03 hs	
Período do Sono:			
PAS:	**236 mmHg**	às 06:30 hs	
PAD:	**181 mmHg**	às 06:30 hs	
PAM:	**206 mmHg**	às 06:30 hs	
PP:	**71 mmHg**	às 04:00 hs	

4 - Valores Mínimos em mmHg			**Comentários**
Período da Vigília:			
PAS:	**104 mmHg**	às 10:00 hs	
PAD:	**59 mmHg**	às 19:18 hs	
PAM:	**80 mmHg**	às 10:00 hs	
PP:	**42 mmHg**	às 19:00 hs	
Período do Sono:			
PAS:	**103 mmHg**	às 23:33 hs	
PAD:	**52 mmHg**	às 23:33 hs	
PAM:	**75 mmHg**	às 23:33 hs	
PP:	**47 mmHg**	às 06:03 hs	

5 - Desvio Padrão das medições de P.A em mmHg		**Valores Aceitáveis**
Período Total:	**25,0 / 22,8**	
Período da Vigília:	**16,9 / 11,8**	até 12,0 / 9,0
Período do Sono:	**44,3 / 44,3**	até 10,0 / 8,0

© 2015 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 5.382 compilação 110.78

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE
LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico das Pressões

Nº do Exame	Paciente: WALTER PEREIRA DA SILVA	Código:
B21-00305	Data de Instalação: 12/08/2025 15:19:52	**B21-00305**

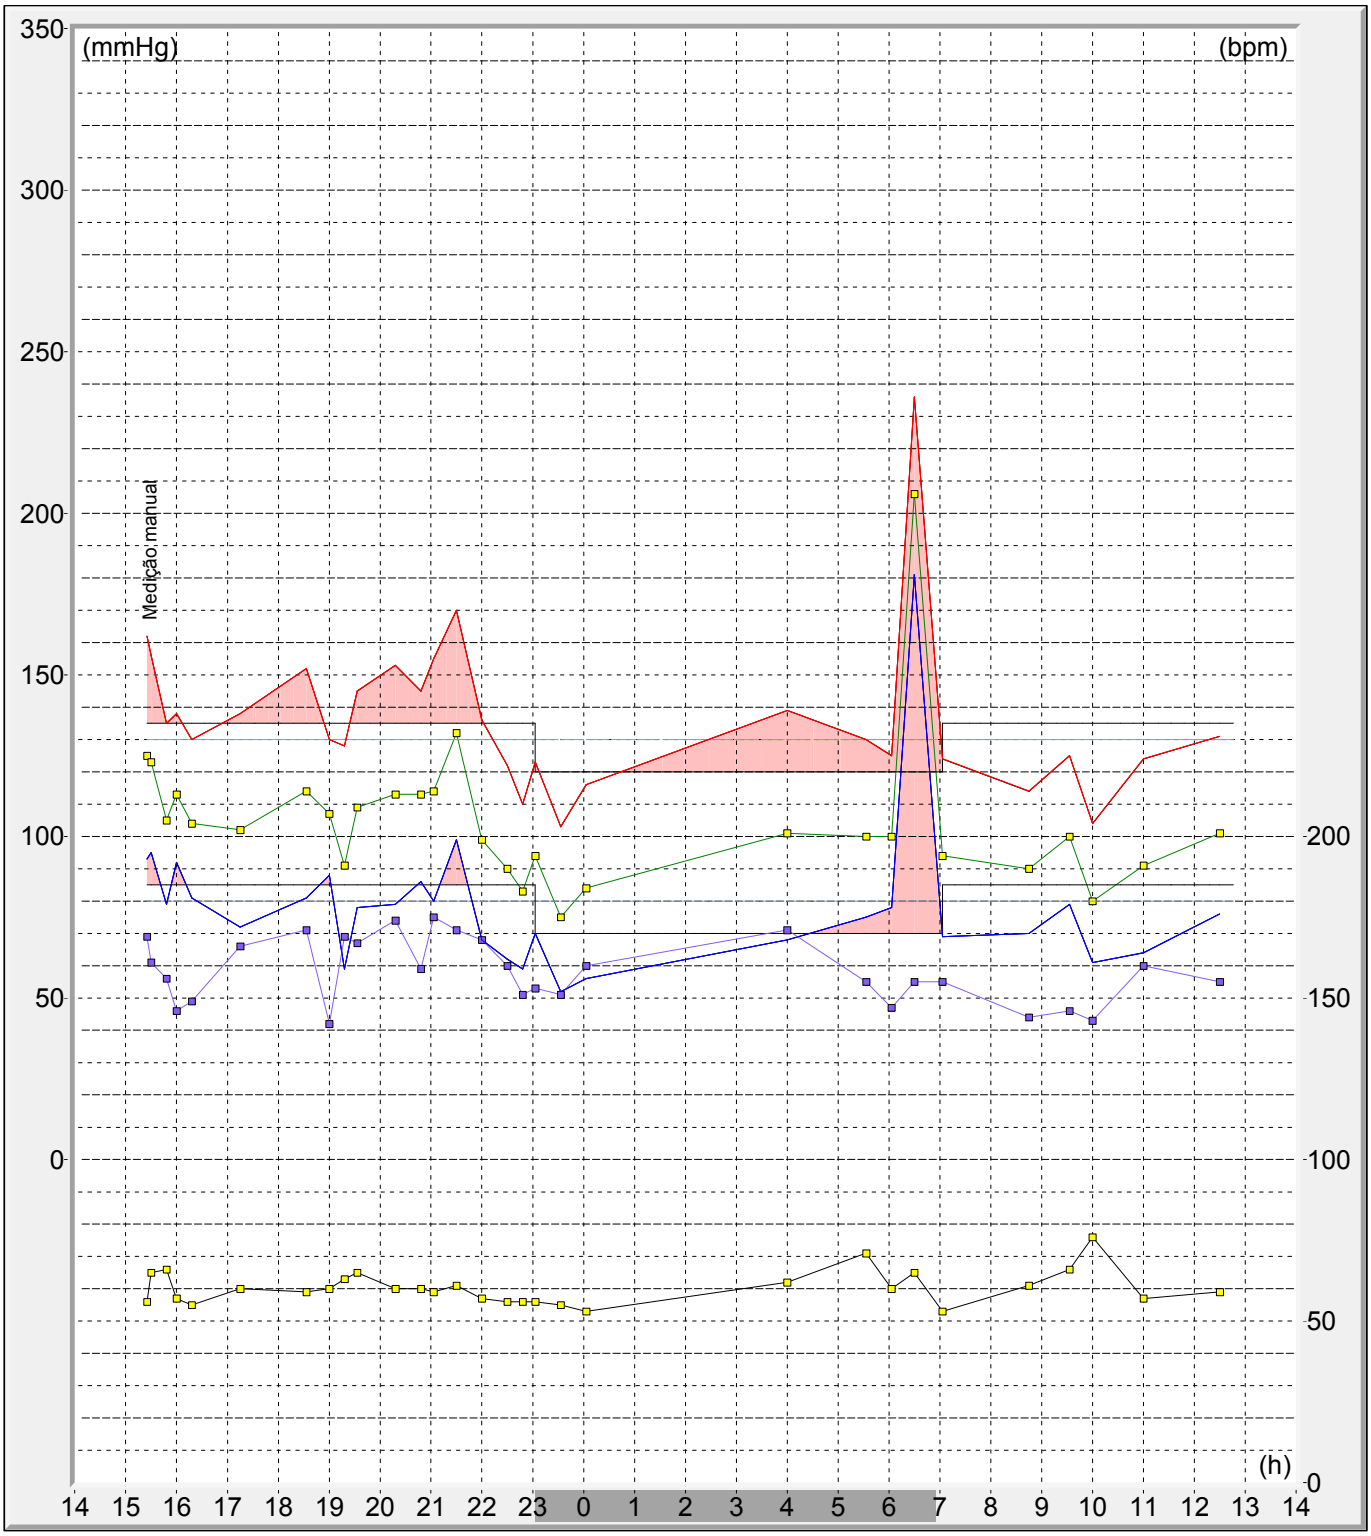

© 2015 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 5.382 compilação 110.78

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE
LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico de Tendências

Nº do Exame	Paciente: WALTER PEREIRA DA SILVA	Código:
B21-00305	Data de Instalação: 12/08/2025 15:19:52	**B21-00305**

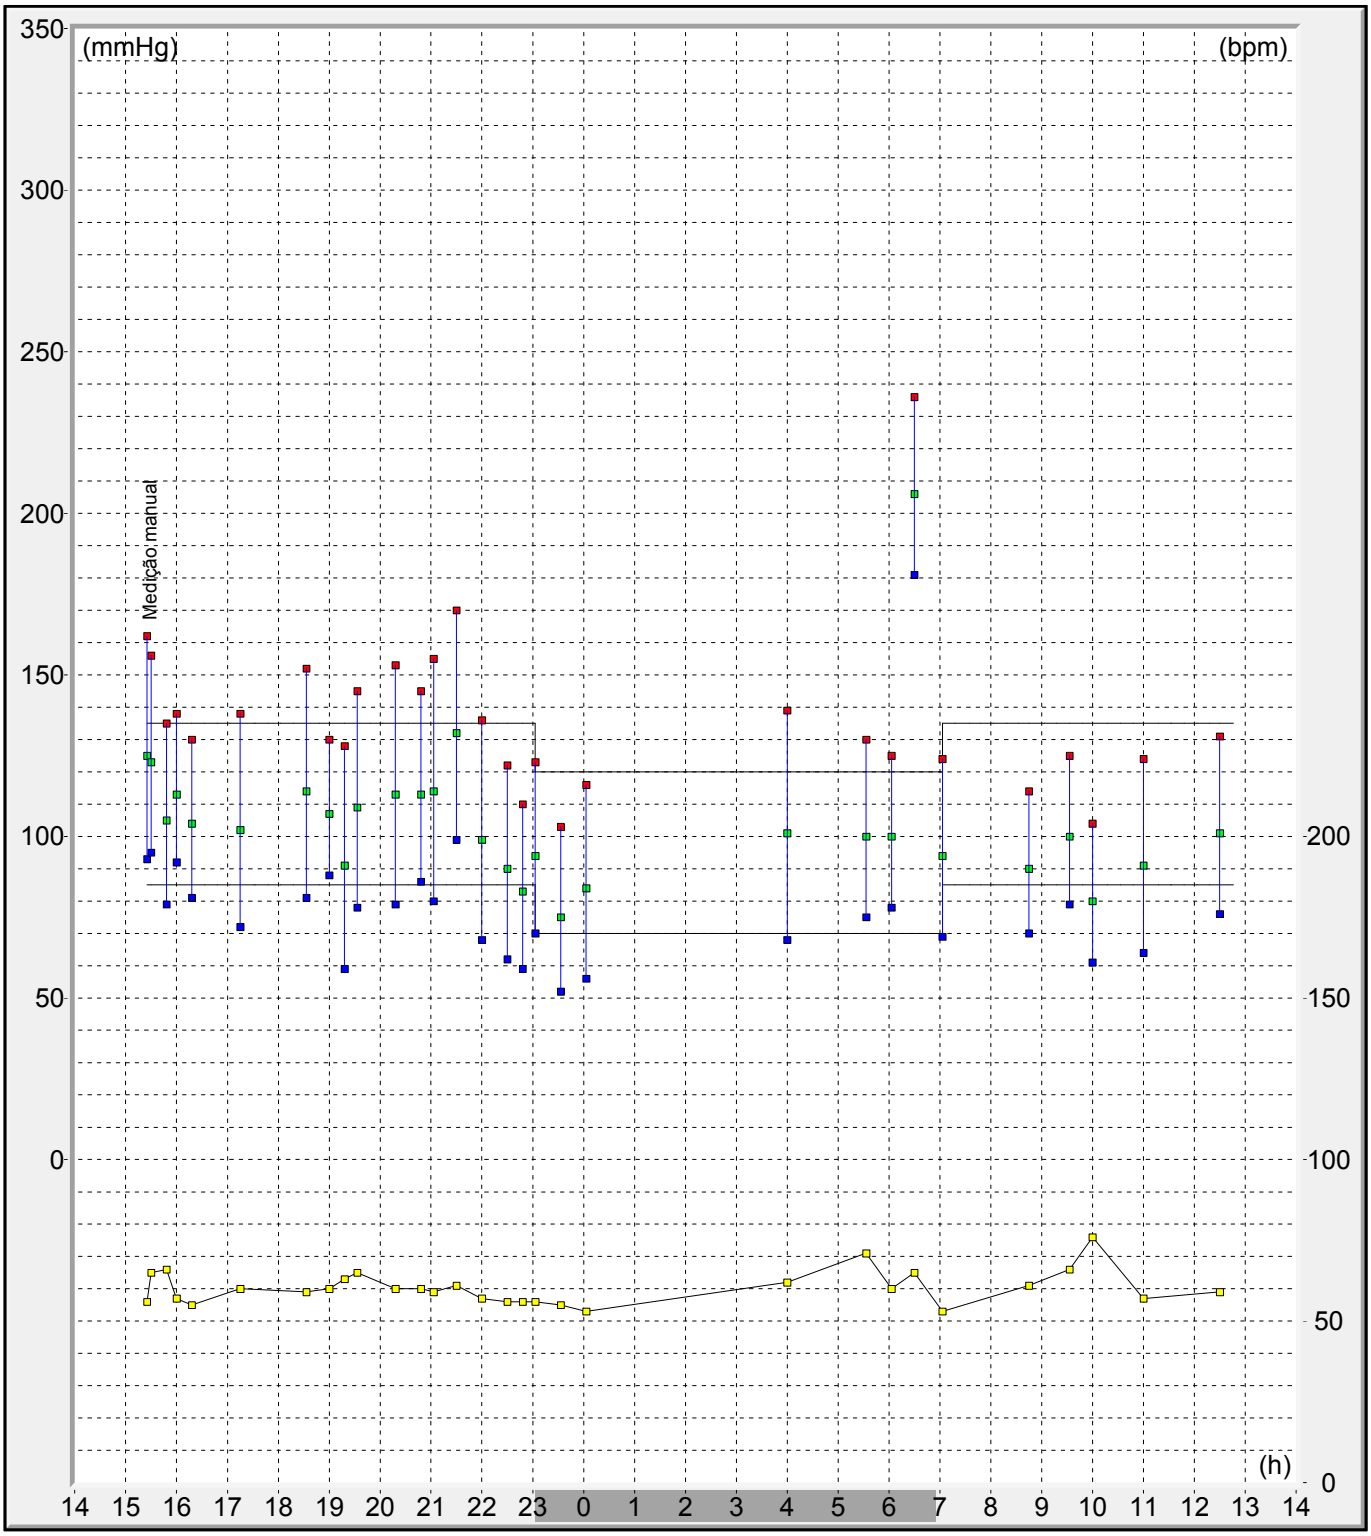

© 2015 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 5.382 compilação 110.78

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE
LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico de Correlação

Nº do Exame	Paciente: WALTER PEREIRA DA SILVA	Código:
B21-00305	Data de Instalação: 12/08/2025 15:19:52	B21-00305

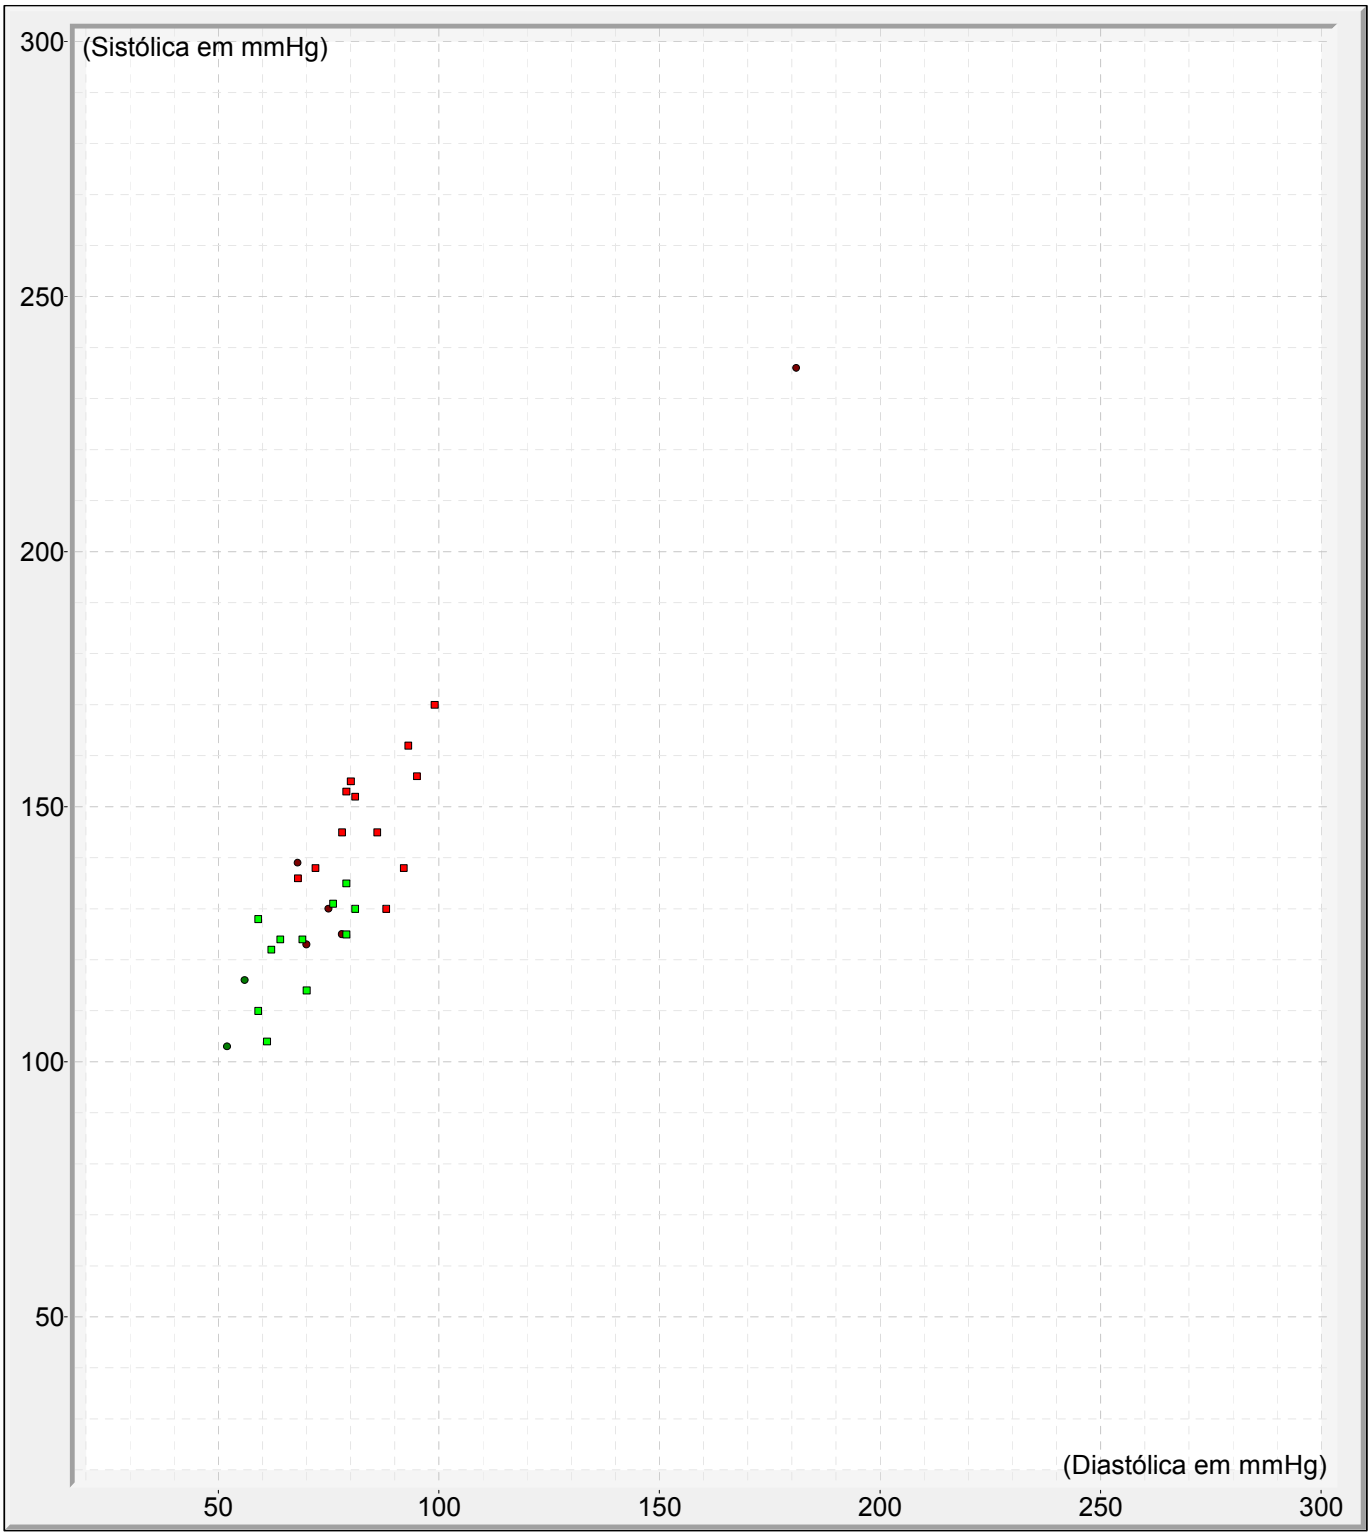

© 2015 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 5.382 compilação 110.78

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE
LAGOA FORMOSA - MG

Histogramas

Nº do Exame	Paciente: WALTER PEREIRA DA SILVA	Código:
B21-00305	Data de Instalação: 12/08/2025 15:19:52	**B21-00305**

© 2015 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 5.382 compilação 110.78