


gel como da sua DN. 12/05/1972

Real Tempo Modo

09:40
10mm/mV

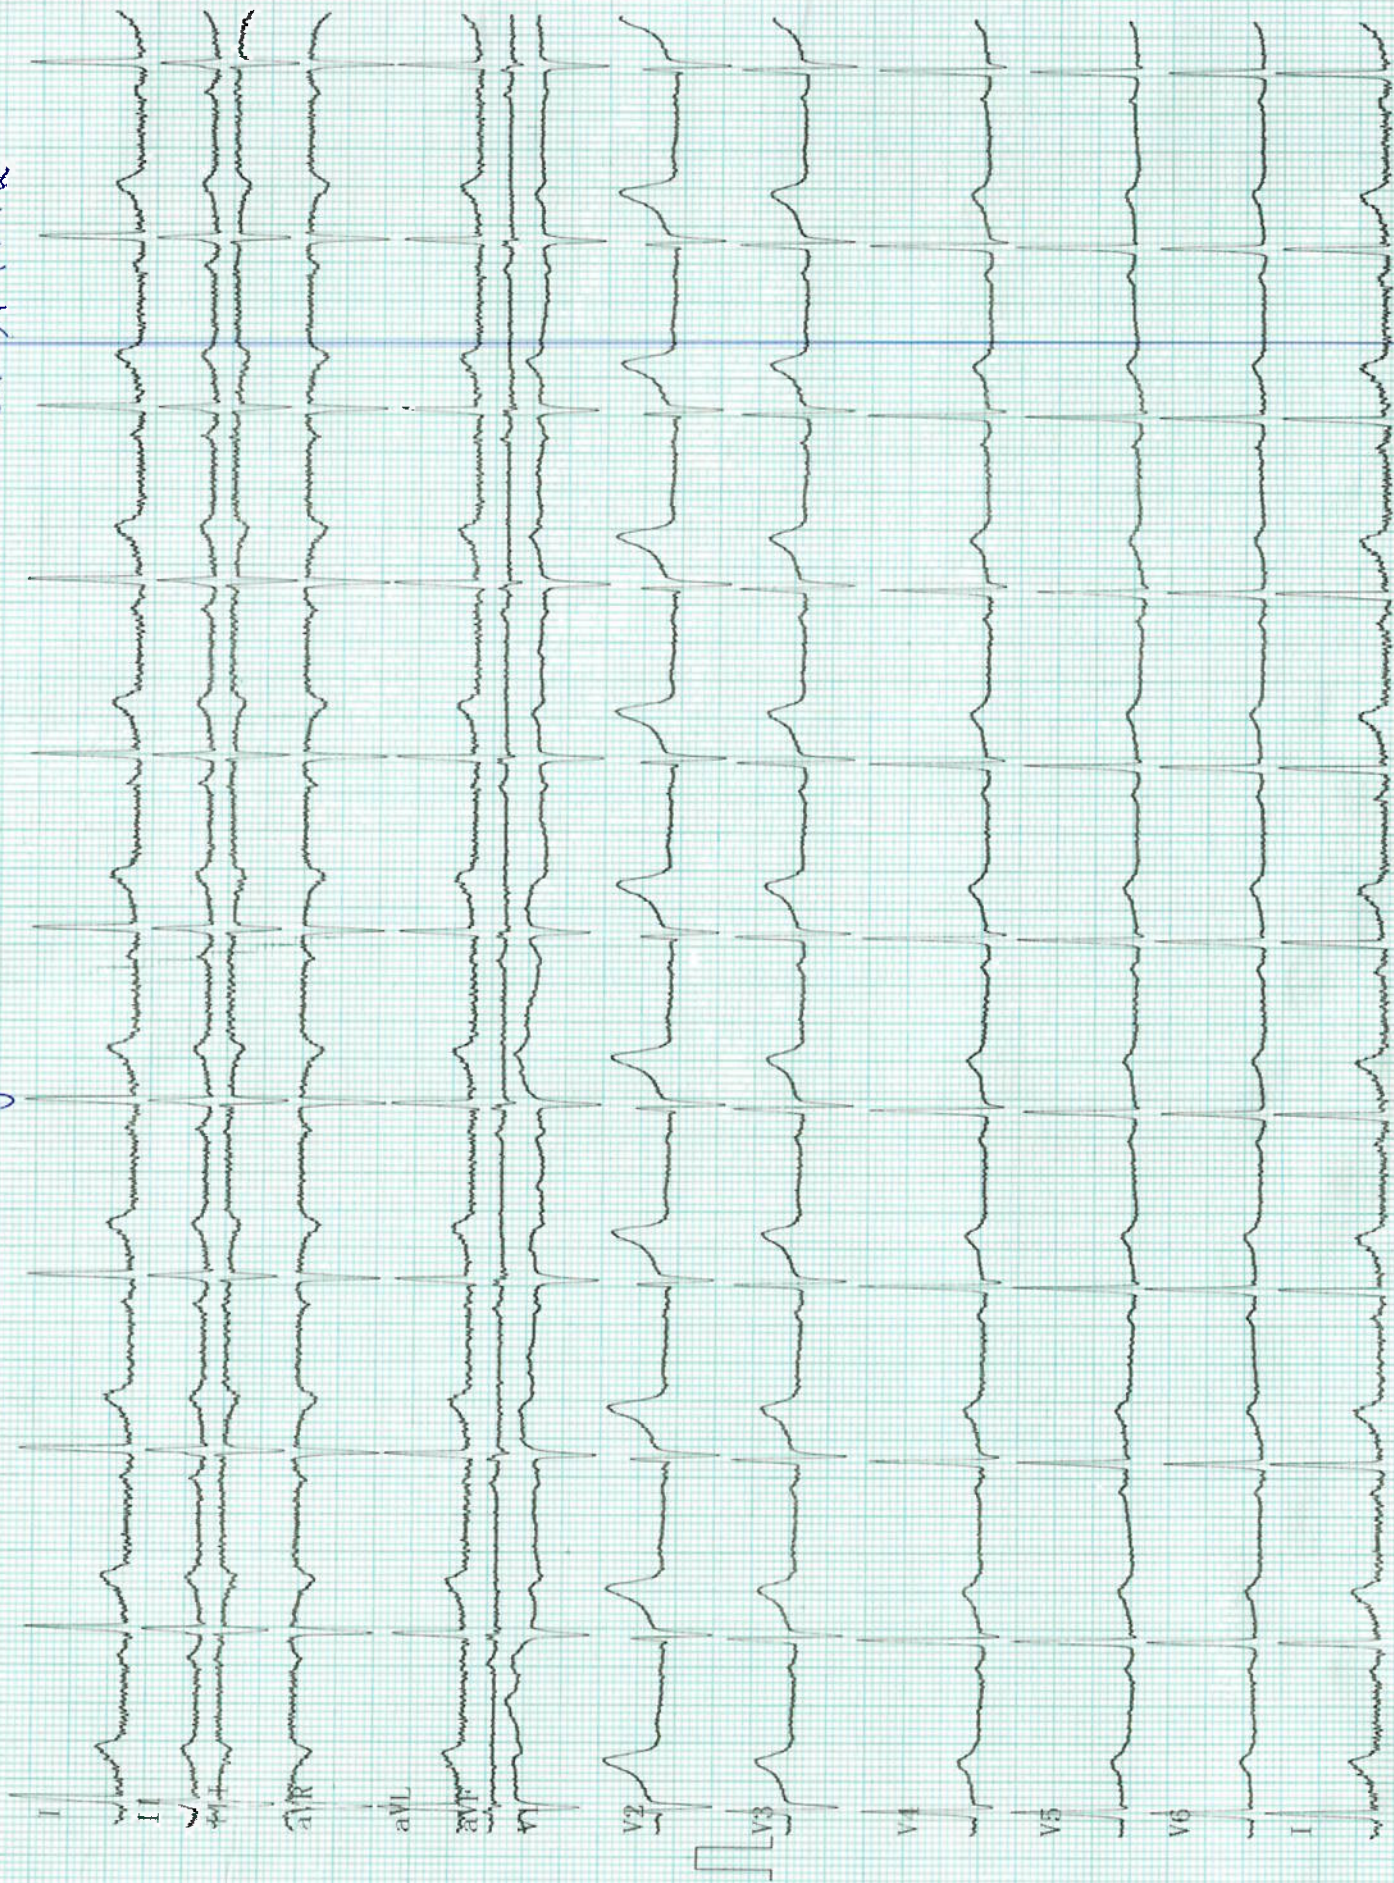

V...ade:25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC:50 Hz BIOCARD ECG 1200 V4.06.000