


2025-07-24, 08:19

Real Tempo Modo

Lead/mV

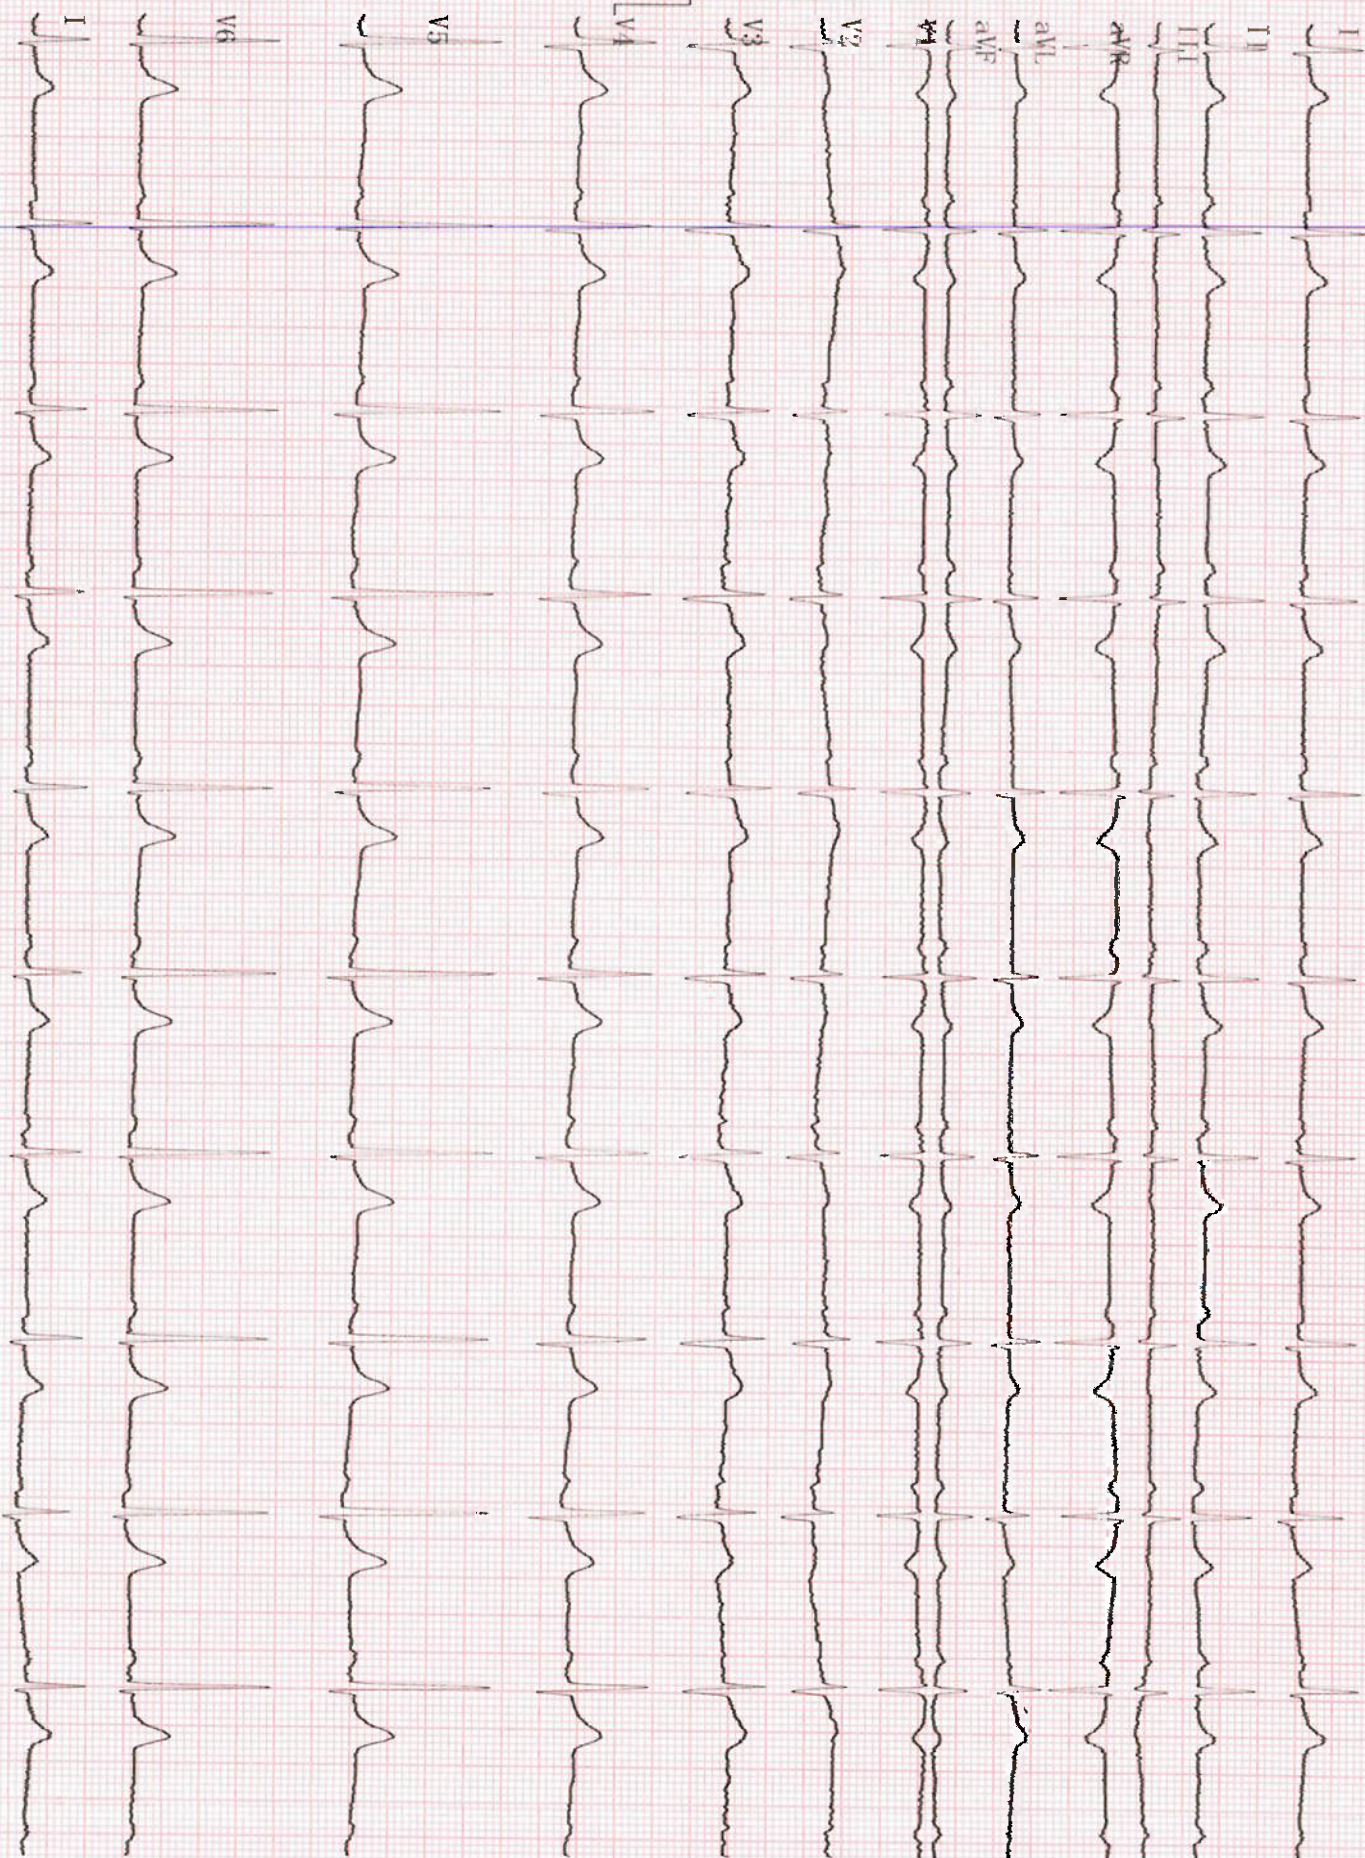

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BLOCARE ECG 1200 V4.06.000

Alderes Ferreira de Menezes