


João Carlos Araújo

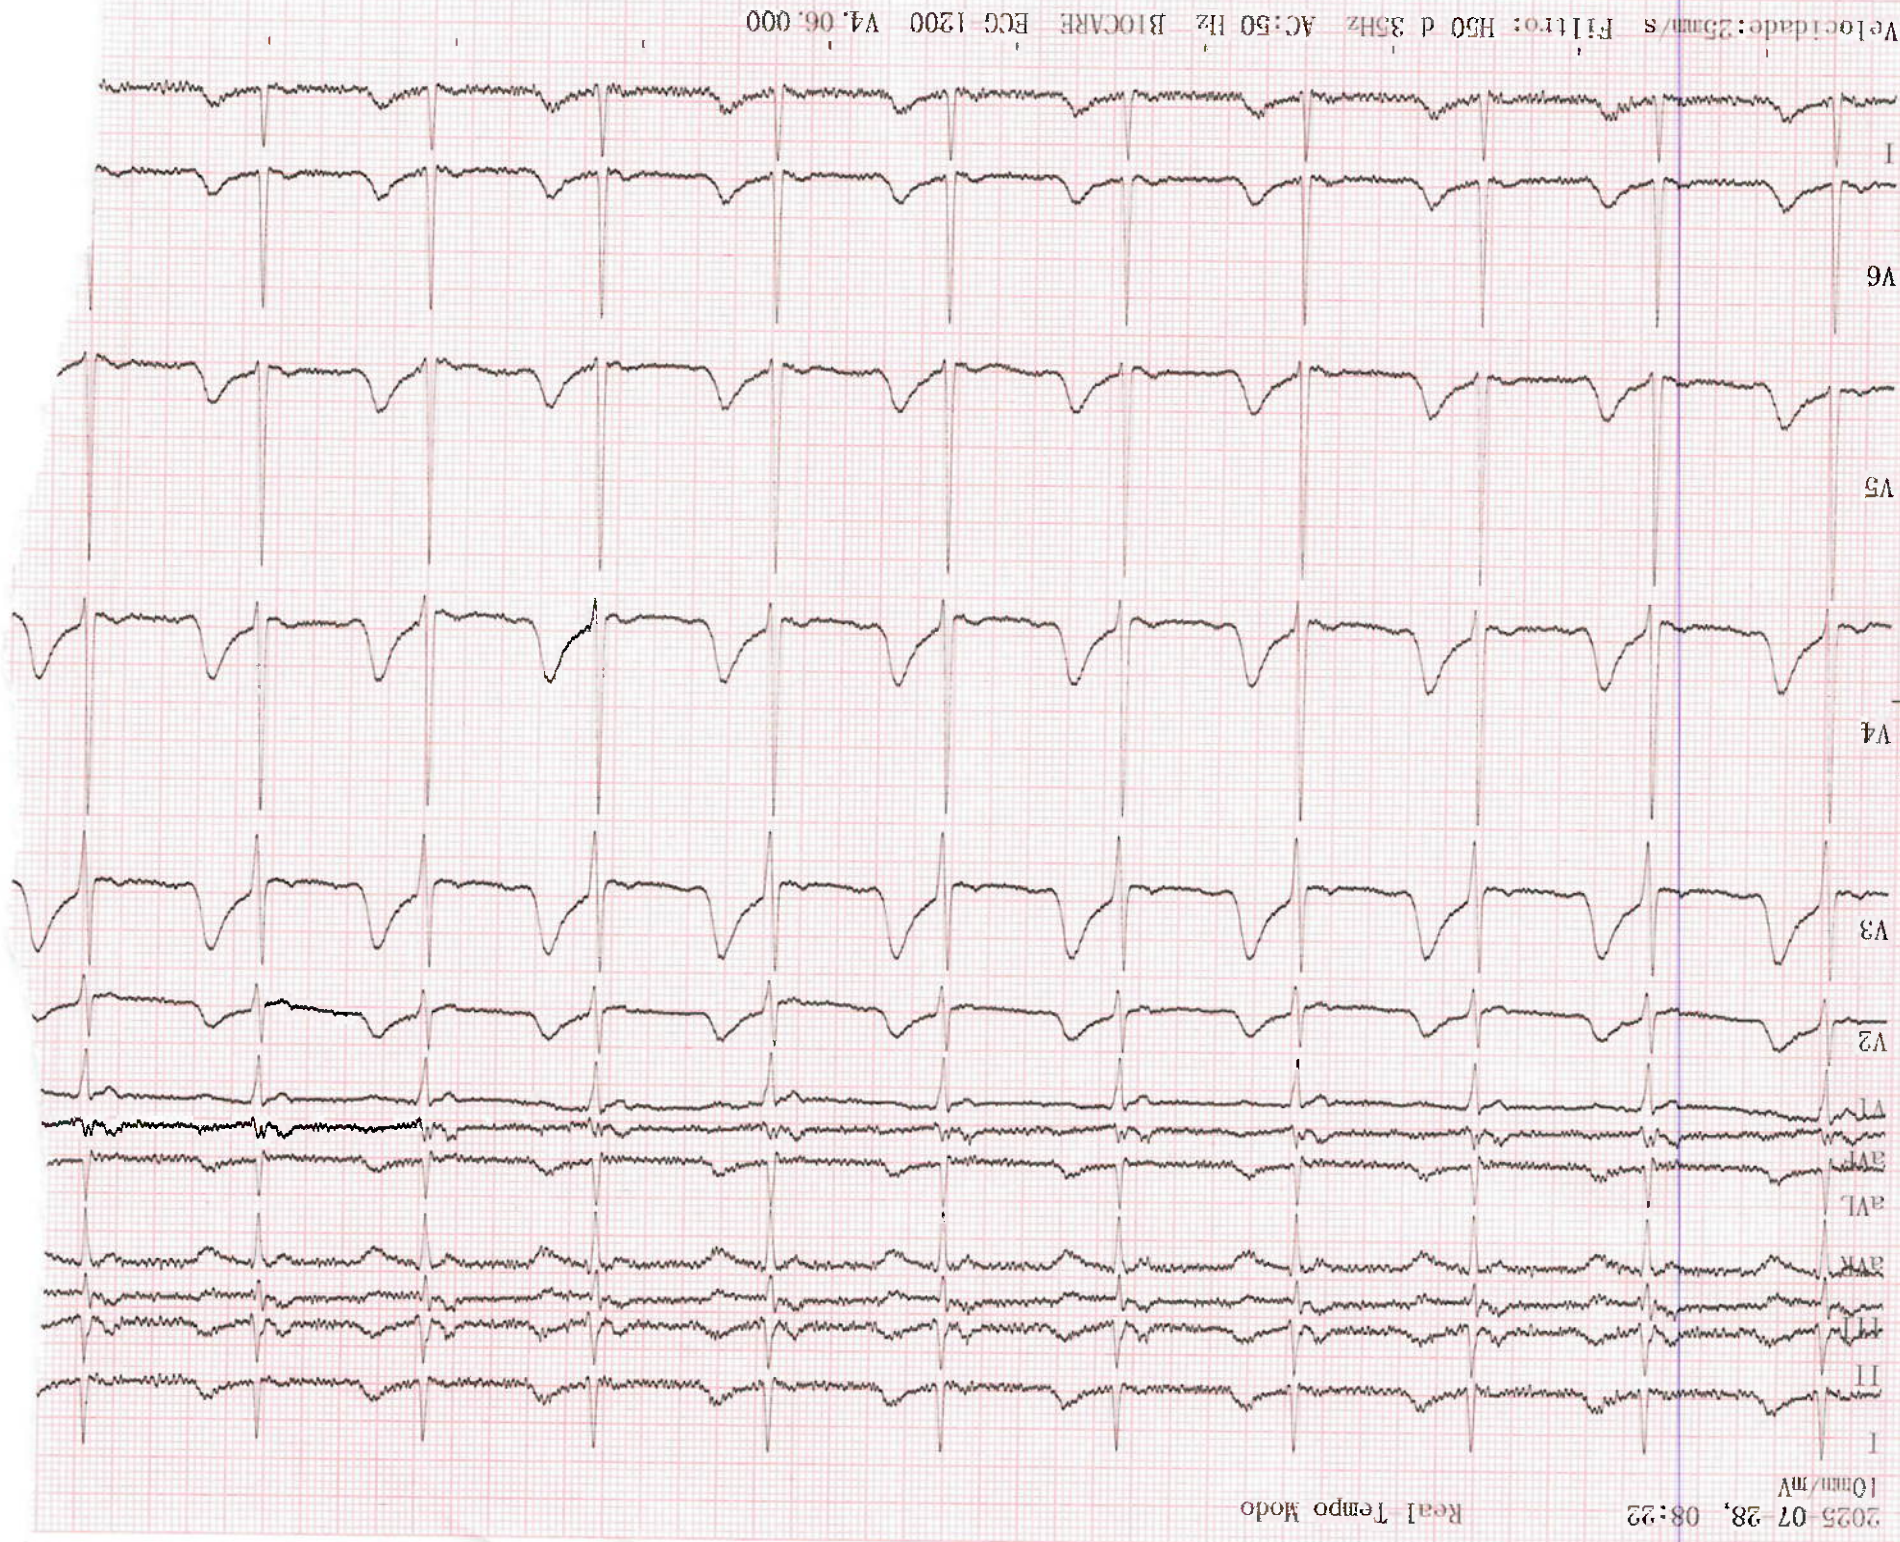

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARD ECG 1200 V4.06.000

2025-07-28, 08:22

Real Tempo Modo

10mm/mV