


Commodore 64, 23/08/1990

Real Tempo Mode
10mm/mV

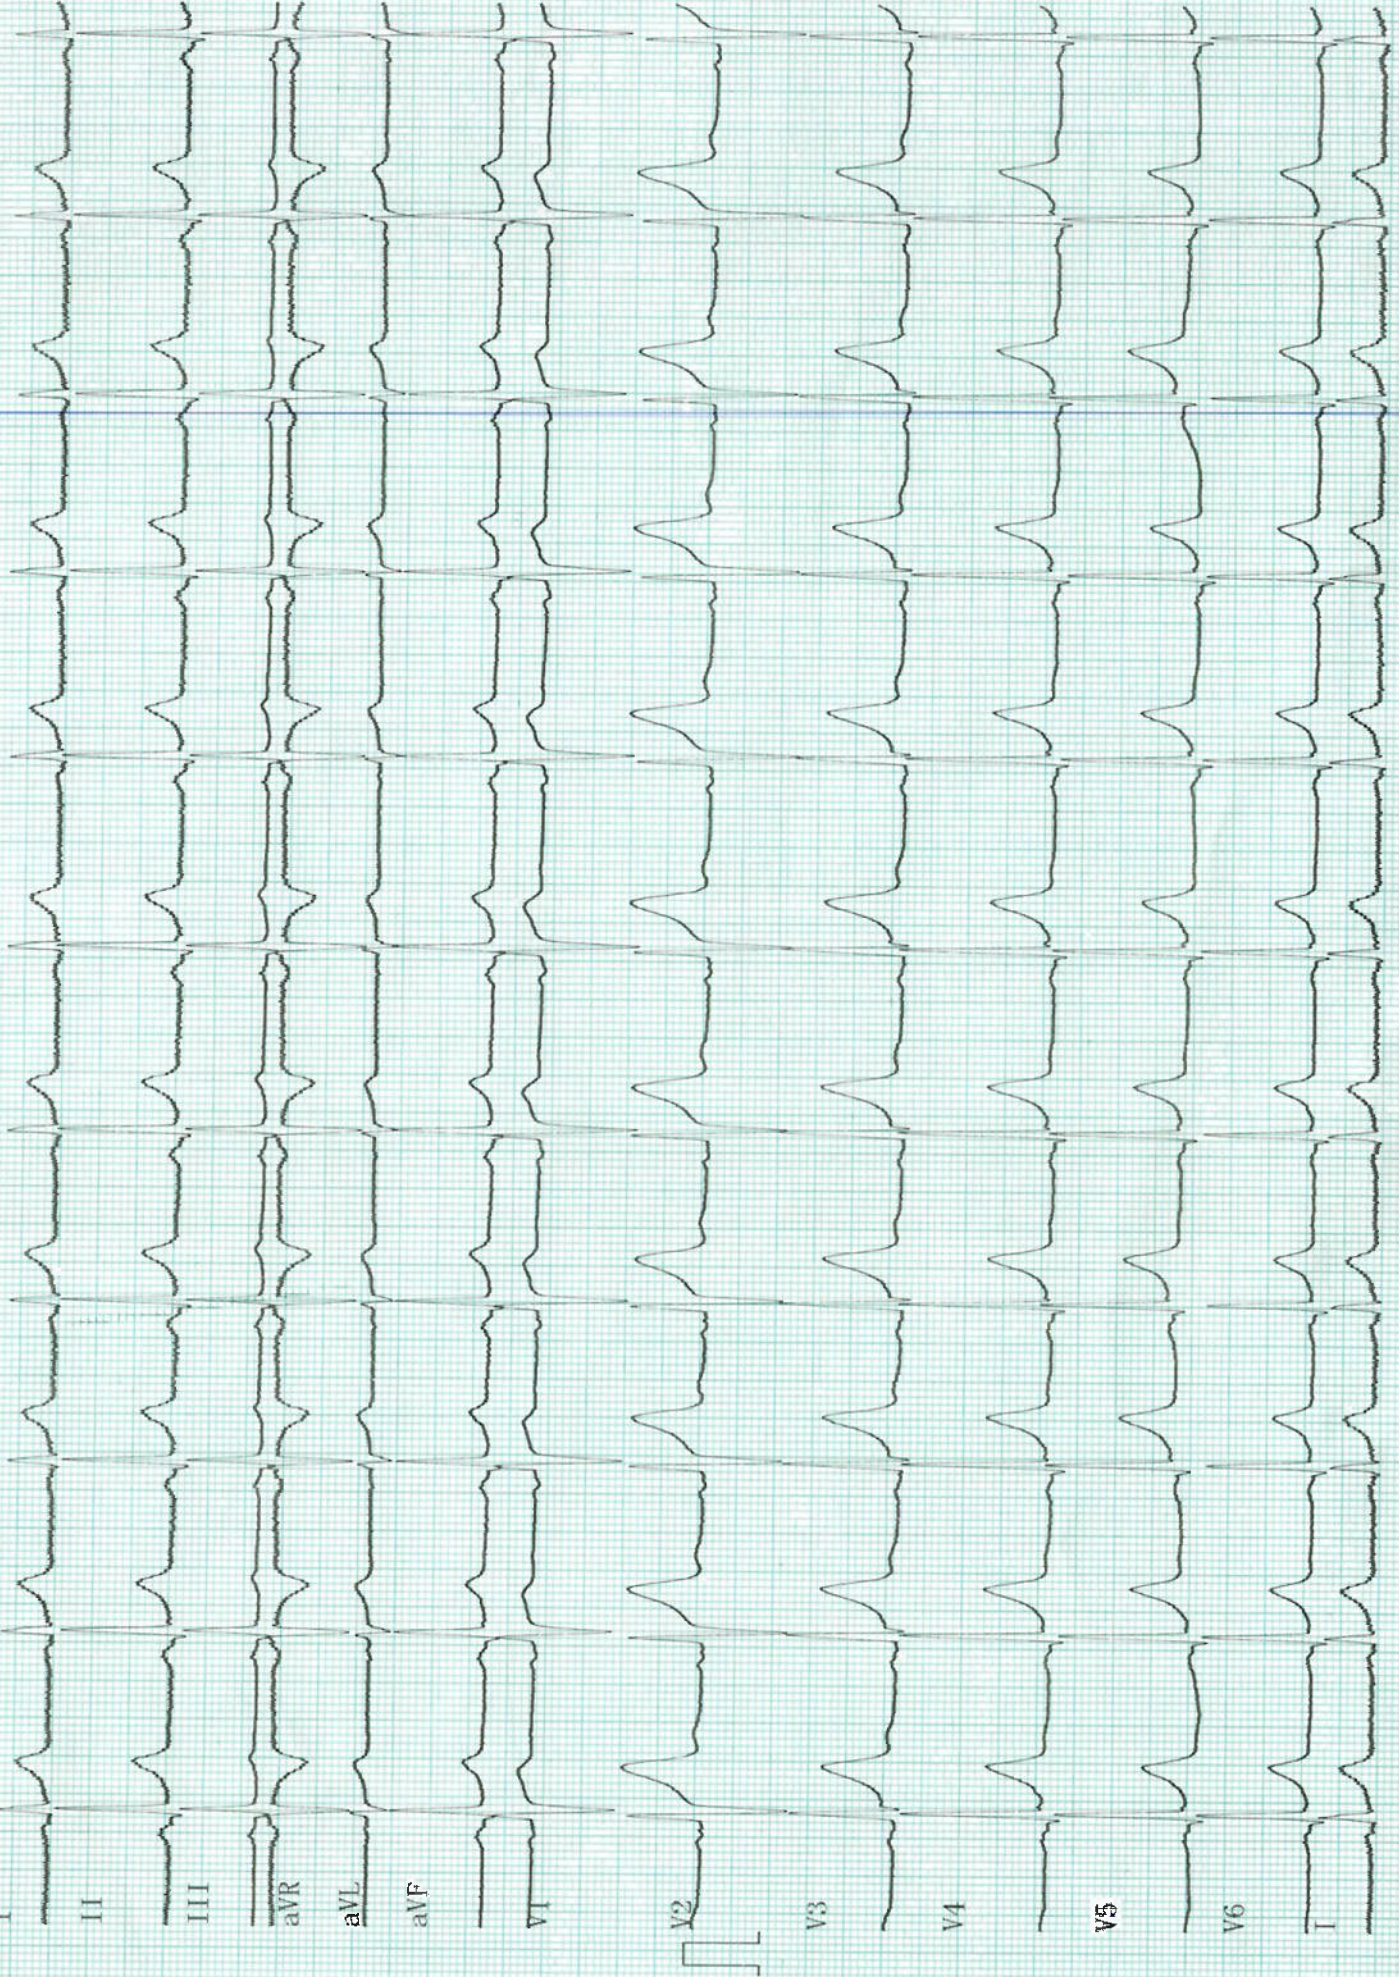

Velocidade: 25mm/s Filtro: 150 d 35Hz AC: 50 Hz BIO CARE ECG-1200 V4.06.000