

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

1 - Dados do Exame

Nº do Exame: CPN-02767	Data de Instalação: 21/07/2025 06:37 Término: 22/07/2025 07:08 Protocolo de Medições: Padrão	Código: CPN-02767
----------------------------------	--	------------------------------------

2 - Paciente

Nome: TELMA CARDOSO RIBEIRO	Idade: 60		
Sexo: F	Altura:	Peso:	Nascimento: 10/01/1965
Fumante: Não	Tel:		Fax:
Diagnóstico:			
Motivo do Exame:			

3 - Médico Solicitante

Nome: EMANUEL VALDEMERI	Tel:
Clínica:	Fax:

4 - Laudo Médico

--

5 - Data e Assinatura

22/07/2025	EMANOEL VALDAMERE C.R.M.:
-------------------	-------------------------------------

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Tabela das Medições

Nº do Exame: CPN-02767	Paciente: TELMA CARDOSO RIBEIRO Data de Instalação: 21/07/2025 06:37:33	Código: CPN-02767
---	--	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	06:39	128	89	107	39	99	Medição manual	48	19:00	101	66	82	35	86	
2	07:00	122	80	99	42	101		49	19:15	99	61	78	38	83	
3	07:15	120	82	99	38	84		50	19:30	95	64	78	31	81	
4	07:30	116	79	96	37	86		51	19:45	100	65	81	35	80	
5	07:45	121	74	95	47	82		52	20:00	96	70	82	26	76	
6	08:00	118	80	97	38	91		53	20:15	106	75	89	31	79	
7	08:15	110	77	92	33	88		54	20:30	102	72	86	30	75	
8	08:30	114	76	93	38	89		55	20:48	99	72	84	27	74	
9	08:45	115	80	96	35	85		56	21:00	102	67	83	35	72	
10	09:03	128	76	100	52	90		57	21:15	107	71	88	36	75	
11	09:15	118	79	97	39	89		58	21:30	101	69	84	32	71	
12	09:30	109	79	92	30	91		59	22:00	105	70	86	35	71	
13	09:45	104	81	91	23	108		60	22:15	101	72	85	29	74	
14	10:00	116	75	94	41	110		61	22:30	102	71	85	31	76	
15	10:18	107	75	89	32	120		62	22:45	99	67	81	32	77	
16	10:30	100	70	84	30	111		63	23:00	98	66	81	32	77	
17	11:00	105	76	89	29	103		64	23:30	99	58	77	41	79	
18	11:15	102	71	85	31	107		65	00:00	96	62	77	34	76	
19	11:33	102	70	84	32	89		66	00:30	115	83	98	32	87	
20	11:48	98	68	82	30	89		67	01:00	93	61	76	32	75	
21	12:00	99	67	82	32	85		68	01:30	92	58	74	34	79	
22	12:15	99	66	81	33	81		69	02:00	98	58	76	40	80	
23	12:30	99	69	83	30	83		70	02:30	87	55	69	32	75	
24	12:45	115	72	92	43	96		71	03:00	97	64	79	33	76	
25	13:00	104	68	84	36	83		72	03:30	105	62	82	43	76	
26	13:15	107	68	86	39	86		73	04:00	106	57	79	49	76	
27	13:30	107	70	87	37	88		74	04:30	81	56	67	25	80	
28	13:45	106	69	86	37	85		75	05:00	112	69	89	43	79	
29	14:00	108	74	90	34	89		76	05:30	107	70	87	37	78	
30	14:15	117	72	93	45	86		77	06:03	133	95	112	38	96	
31	14:30	94	80	87	14	89		78	07:08						Aparelho foi religado
32	14:45	114	80	95	34	89									
33	15:00	106	73	88	33	88									
34	15:15	111	76	92	35	87									
35	15:30	115	75	93	40	85									
36	15:45	113	79	95	34	102									
37	16:00	110	82	95	28	85									
38	16:15	118	80	98	38	81									
39	16:30	116	74	93	42	83									
40	16:48	108	78	92	30	84									
41	17:15	126	81	102	45	109									
42	17:30	107	78	91	29	97									
43	17:45	114	74	92	40	87									
44	18:00	96	74	84	22	81									
45	18:15	107	79	92	28	110									
46	18:30	109	75	90	34	78									
47	18:45	103	72	86	31	83									

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Análise Estatística

Nº do Exame: CPN-02767	Paciente: TELMA CARDOSO RIBEIRO Data de Instalação: 21/07/2025 06:37:33	Código: CPN-02767
---	--	------------------------------------


1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	80	
Medições Válidas:	77 = 96%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	107 / 72 mmHg	menor que 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	108 / 74 mmHg	menor que 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	101 / 65 mmHg	menor que 120 / 70 mmHg
Descenso Noturno:	6% / 12%	entre 10% e 20% / 10% e 20%
Carga Pressórica** na Vigília:	0% / 2%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	7% / 20%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	1% / 17%	até 50% / 50%
<small>** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.</small>		
3 - Valores Máximos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	128 mmHg às 06:39 h	Medição manual
PAD:	89 mmHg às 06:39 h	Medição manual
PAM:	107 mmHg às 06:39 h	Medição manual
PP:	52 mmHg às 09:03 h	
Período do Sono:		
PAS:	133 mmHg às 06:03 h	
PAD:	95 mmHg às 06:03 h	
PAM:	112 mmHg às 06:03 h	
PP:	49 mmHg às 04:00 h	
4 - Valores Mínimos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	94 mmHg às 14:30 h	
PAD:	61 mmHg às 19:15 h	
PAM:	78 mmHg às 19:15 h	
PP:	14 mmHg às 14:30 h	
Período do Sono:		
PAS:	81 mmHg às 04:30 h	
PAD:	55 mmHg às 02:30 h	
PAM:	67 mmHg às 04:30 h	
PP:	25 mmHg às 04:30 h	
5 - Desvio Padrão das medições de P.A.		Valores Aceitáveis
Período Total:	9,6 / 7,6mmHg	
Período da Vigília:	8,4 / 5,4mmHg	menor que 12,0 / 9,0
Período do Sono:	12,6 / 11,0mmHg	menor que 10,0 / 8,0

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico das Pressões

Nº do Exame: CPN-02767	Paciente: TELMA CARDOSO RIBEIRO Data de Instalação: 21/07/2025 06:37:33	Código: CPN-02767
---	--	------------------------------------

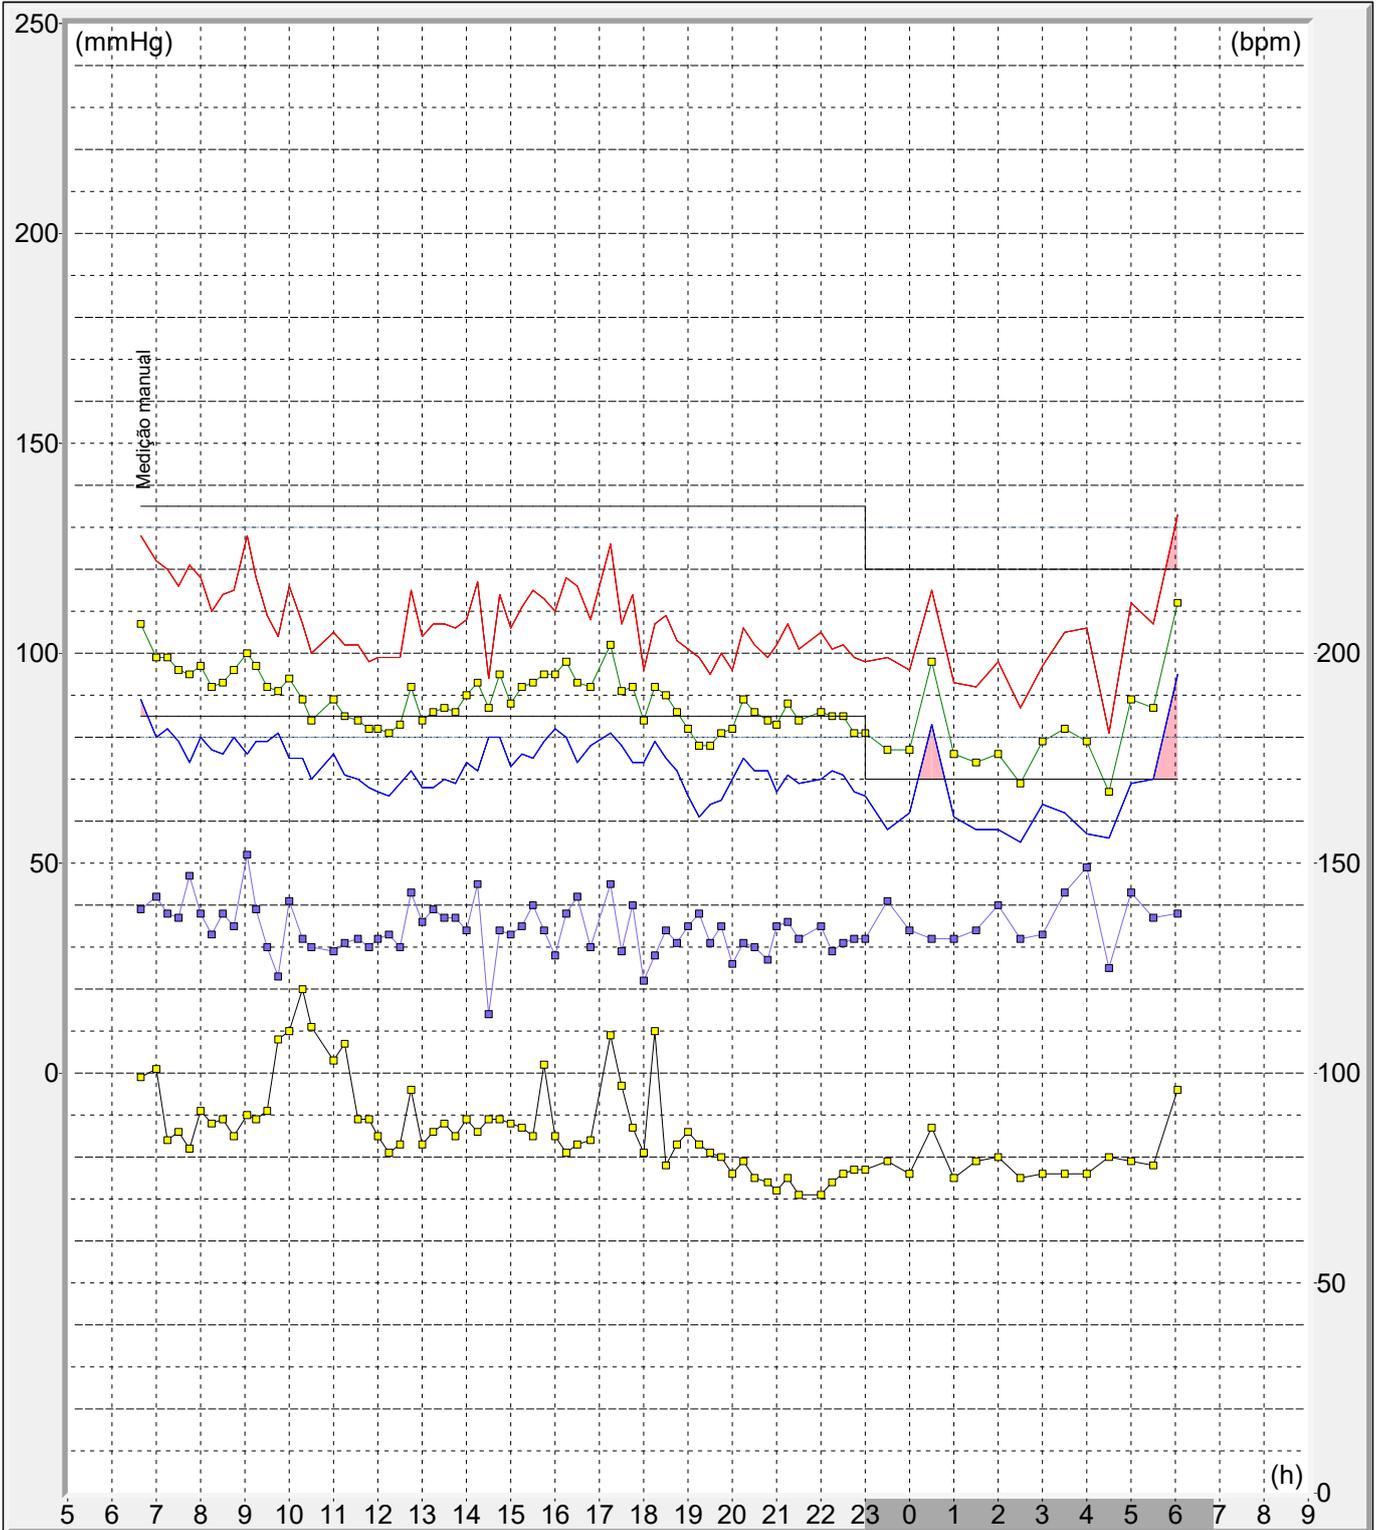


CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico de Tendências

Nº do Exame: CPN-02767	Paciente: TELMA CARDOSO RIBEIRO Data de Instalação: 21/07/2025 06:37:33	Código: CPN-02767
---	--	------------------------------------

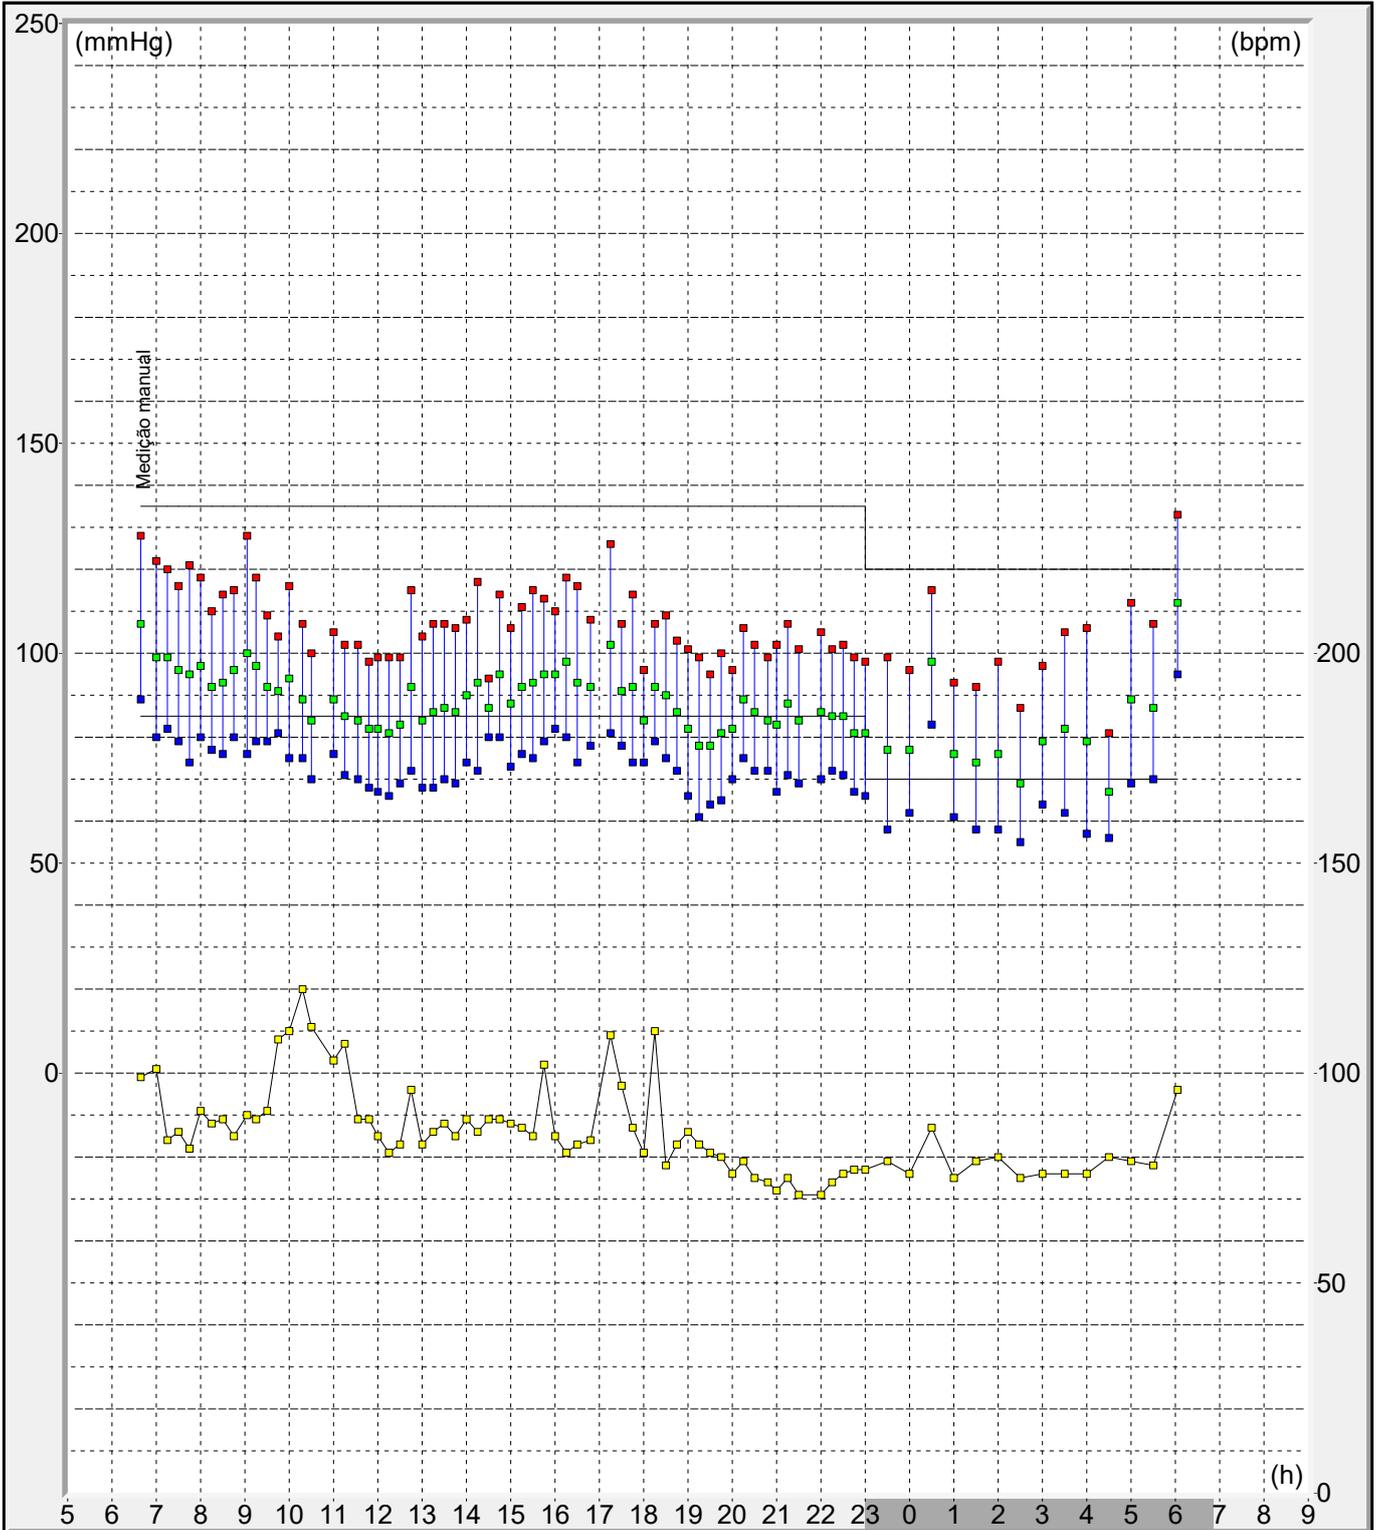


CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico de Correlação

Nº do Exame: CPN-02767	Paciente: TELMA CARDOSO RIBEIRO Data de Instalação: 21/07/2025 06:37:33	Código: CPN-02767
---	--	------------------------------------

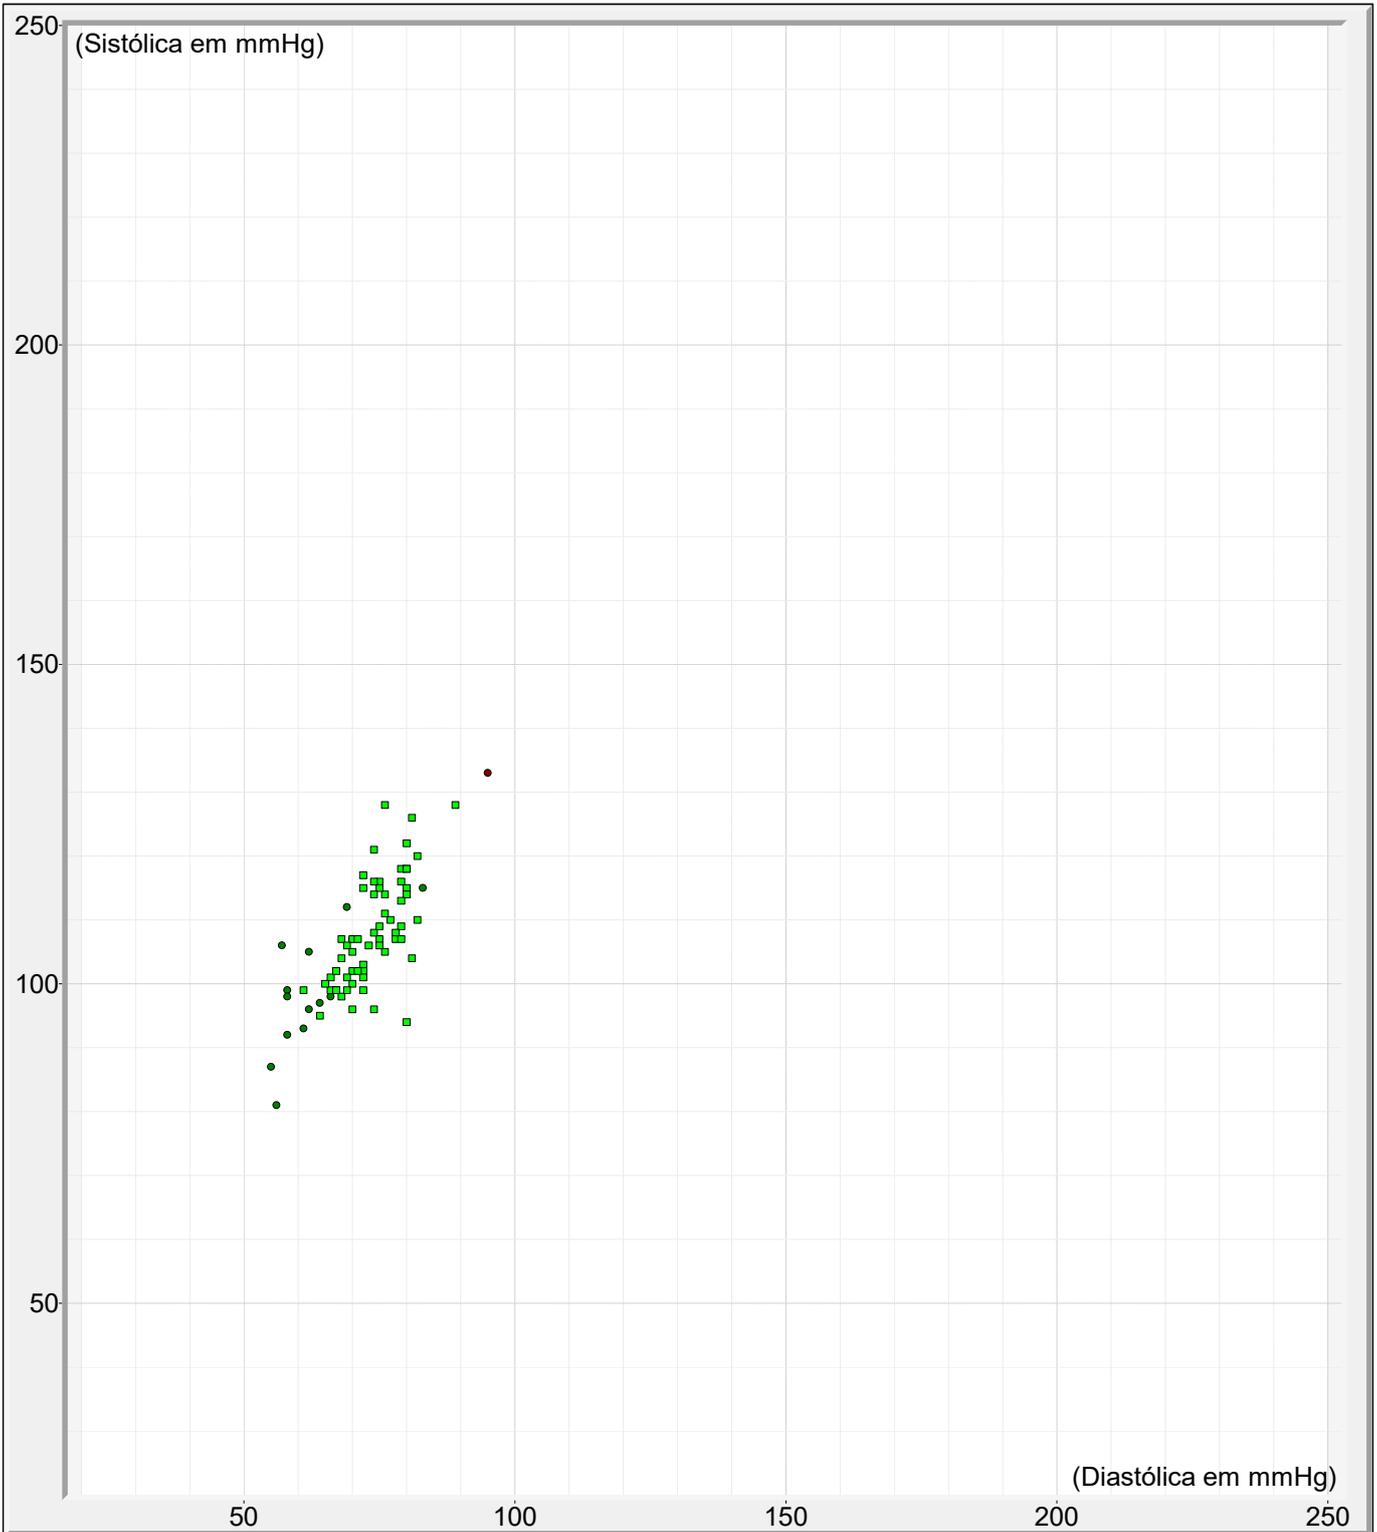

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Histogramas

Nº do Exame: CPN-02767	Paciente: TELMA CARDOSO RIBEIRO Data de Instalação: 21/07/2025 06:37:33	Código: CPN-02767
---	--	------------------------------------

