

**RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE
LAGOA FORMOSA - MG**

1 - Dados do Exame

2 - Paciente

3 - Médico Solicitante

4 - Laudo Médico

5 - Data e Assinatura

© 2015 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 5.382 compilação 110.78

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Tabela das Medições

Nº do Exame B21-00285	Paciente: VANIA XAVIER SOUSA Data de Instalação: 04/06/2025 13:40:17	Código: B21-00285
---------------------------------	---	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	13:42	130	78	102	52	113	Medição manual	49	07:33	134	97	114	37	108	
2	13:45	127	79	101	48	122		50	07:45	126	86	104	40	119	
3	14:00	118	80	97	38	105		51	08:03	133	102	116	31	109	
4	14:15	110	81	94	29	125		52	08:15	129	96	111	33	87	
5	14:33	131	89	108	42	116		53	08:33	121	89	104	32	102	
6	15:15	114	67	88	47	90		54	09:00	116	88	100	28	118	
7	16:15	110	88	98	22	95		55	09:18	127	95	110	32	94	
8	17:00	127	85	104	42	90		56	09:30	120	87	102	33	95	
9	17:15	126	94	108	32	91		57	10:00	102	69	84	33	139	
10	17:30	130	93	110	37	86		58	10:15	131	95	112	36	118	
11	17:45	140	101	118	39	89		59	10:30	136	91	112	45	142	
12	18:00	136	99	116	37	85		60	10:45	128	97	111	31	109	
13	18:33	132	92	110	40	92		61	11:00	123	89	105	34	106	
14	18:45	120	84	101	36	103		62	11:15	128	98	112	30	99	
15	19:00	111	84	96	27	97		63	11:33	127	89	106	38	114	
16	19:15	111	80	94	31	83		64	11:48	131	92	110	39	98	
17	19:30	107	79	92	28	86		65	12:03	129	107	117	22	124	
18	19:45	110	79	93	31	87		66	12:15	128	102	114	26	90	
19	20:00	115	77	94	38	86		67	12:30	130	96	112	34	105	
20	20:15	108	77	91	31	89		68	12:45	120	92	105	28	126	
21	20:30	106	71	87	35	88		69	13:00	108	85	95	23	117	
22	20:45	110	79	93	31	87		70	13:08						Aparelho desligado manualmente
23	21:00	88	69	78	19	87									
24	21:18	107	70	87	37	82									
25	21:30	104	69	85	35	78									
26	21:45	117	79	97	38	76									
27	22:00	118	84	100	34	82									
28	22:15	118	81	98	37	74									
29	22:30	122	79	98	43	72									
30	22:45	117	76	95	41	70									
31	23:00	121	79	98	42	76									
32	23:30	115	67	89	48	77									
33	00:00	113	75	93	38	74									
34	00:30	119	79	97	40	70									
35	01:00	117	82	98	35	70									
36	01:30	122	80	99	42	72									
37	02:00	129	83	104	46	73									
38	02:30	102	69	84	33	78									
39	03:00	99	75	86	24	73									
40	03:30	116	76	94	40	75									
41	04:03	102	68	84	34	76									
42	04:30	98	66	81	32	71									
43	05:00	114	77	94	37	67									
44	05:33	106	72	88	34	84									
45	06:00	113	79	94	34	85									
46	06:30	110	87	97	23	110									
47	07:00	121	95	107	26	107									
48	07:15	120	100	109	20	106									

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Análise Estatística

Nº do Exame B21-00285	Paciente: VANIA XAVIER SOUSA Data de Instalação: 04/06/2025 13:40:17	Código: B21-00285
---------------------------------	---	------------------------------------

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	79	
Medições Válidas:	69 = 87%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	119 / 84 mmHg	até 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	121 / 86 mmHg	até 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	112 / 76 mmHg	até 120 / 70 mmHg
Pressão Matinal:	125 / 94 mmHg	
Ascenso Matinal*:	20 mmHg	
Descenso de P.A. no Sono:	7% / 12%	acima de 10% / 10%
Carga Pressórica** na Vigília:	6% / 53%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	19% / 75%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	9% / 58%	até 50% / 50%
* Ascenso Matinal: Diferença entre a média da pressão matinal e a média da menor pressão no sono.		
** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.		
3 - Valores Máximos em mmHg		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	140 mmHg às 17:45 hs	
PAD:	107 mmHg às 12:03 hs	
PAM:	118 mmHg às 17:45 hs	
PP:	52 mmHg às 13:42 hs	
Período do Sono:		
PAS:	129 mmHg às 02:00 hs	
PAD:	87 mmHg às 06:30 hs	
PAM:	104 mmHg às 02:00 hs	
PP:	48 mmHg às 23:30 hs	
		Medição manual
4 - Valores Mínimos em mmHg		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	88 mmHg às 21:00 hs	
PAD:	67 mmHg às 15:15 hs	
PAM:	78 mmHg às 21:00 hs	
PP:	19 mmHg às 21:00 hs	
Período do Sono:		
PAS:	98 mmHg às 04:30 hs	
PAD:	66 mmHg às 04:30 hs	
PAM:	81 mmHg às 04:30 hs	
PP:	23 mmHg às 06:30 hs	
5 - Desvio Padrão das medições de P.A em mmHg		Valores Aceitáveis
Período Total:	10,7 / 10,2	
Período da Vigília:	10,6 / 9,9	até 12,0 / 9,0
Período do Sono:	8,9 / 6,1	até 10,0 / 8,0


CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico das Pressões

Nº do Exame B21-00285	Paciente: VANIA XAVIER SOUSA Data de Instalação: 04/06/2025 13:40:17	Código: B21-00285
---------------------------------	---	------------------------------------

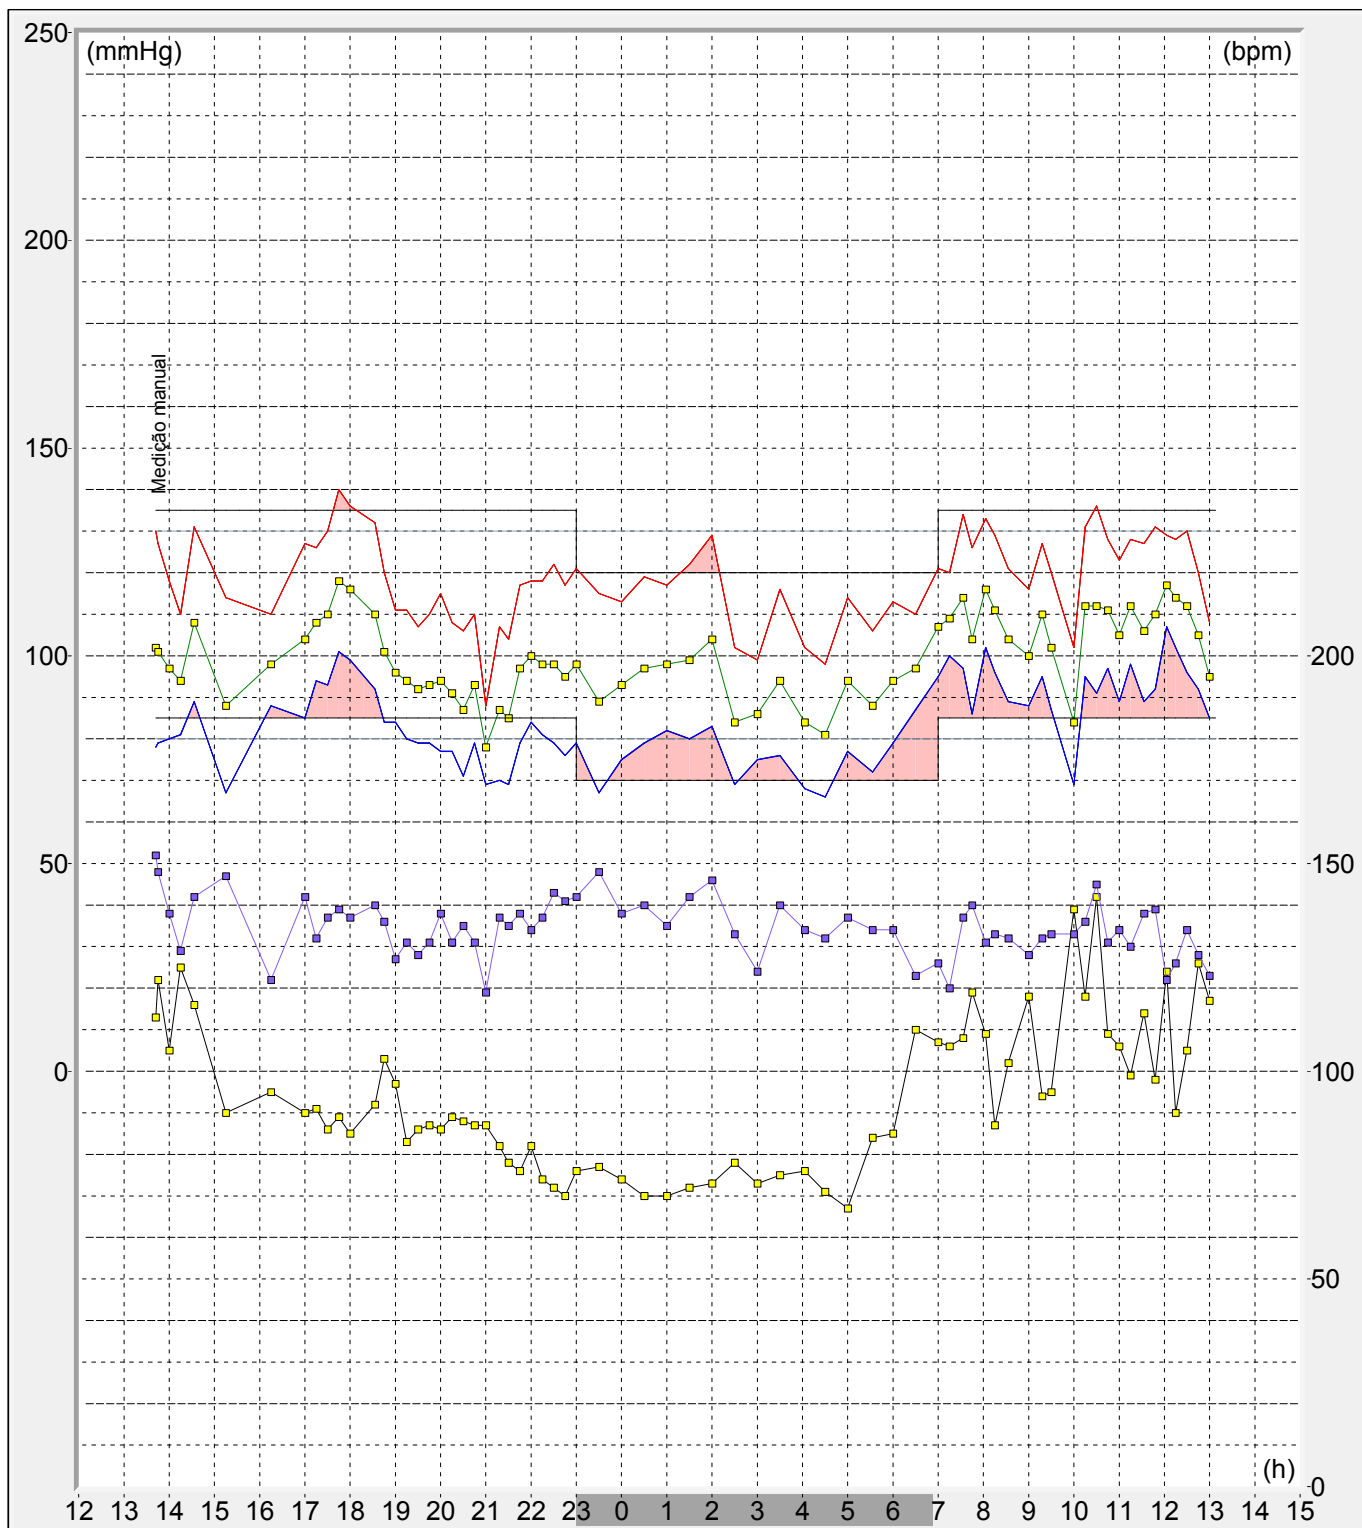

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE


LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico de Tendências

Nº do Exame
B21-00285

Paciente: VANIA XAVIER SOUSA
Data de Instalação: 04/06/2025 13:40:17

Código:
B21-00285

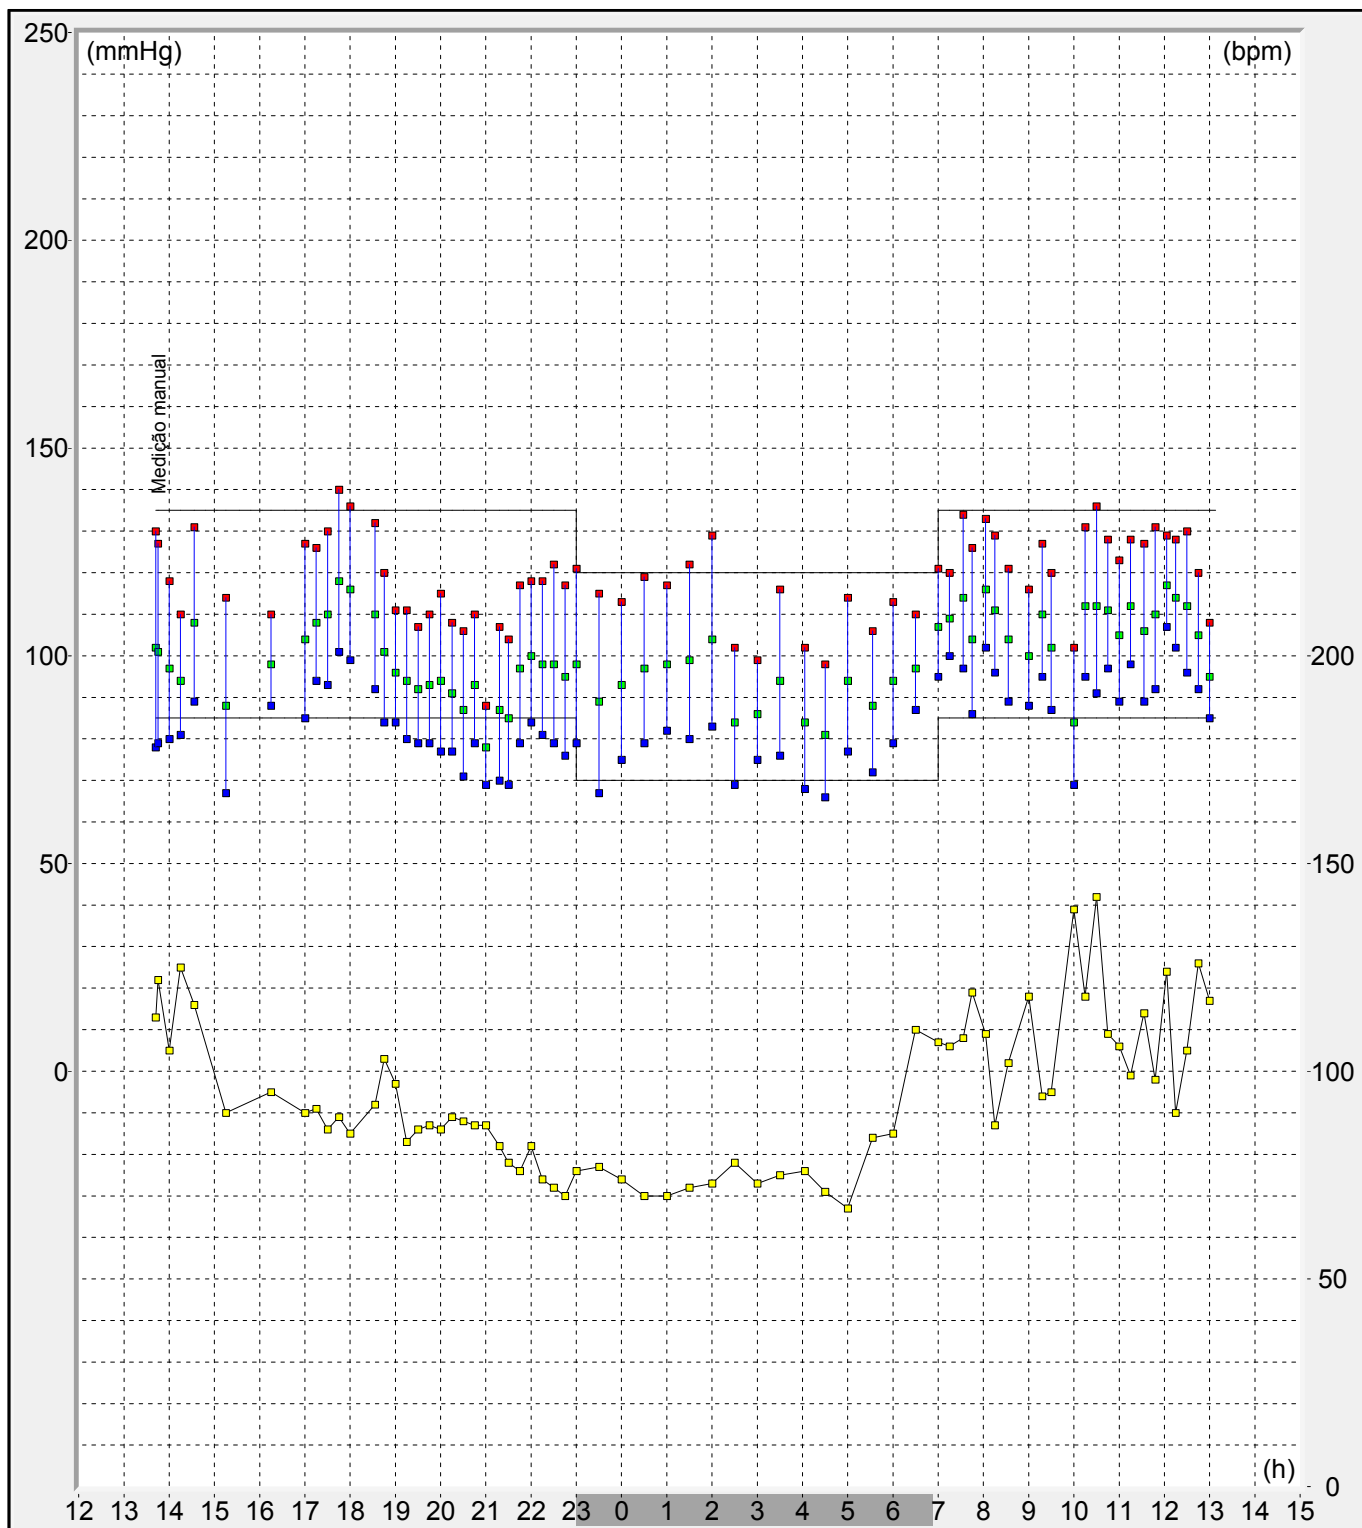


CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico de Correlação

Nº do Exame B21-00285	Paciente: VANIA XAVIER SOUSA Data de Instalação: 04/06/2025 13:40:17	Código: B21-00285
---------------------------------	---	------------------------------------

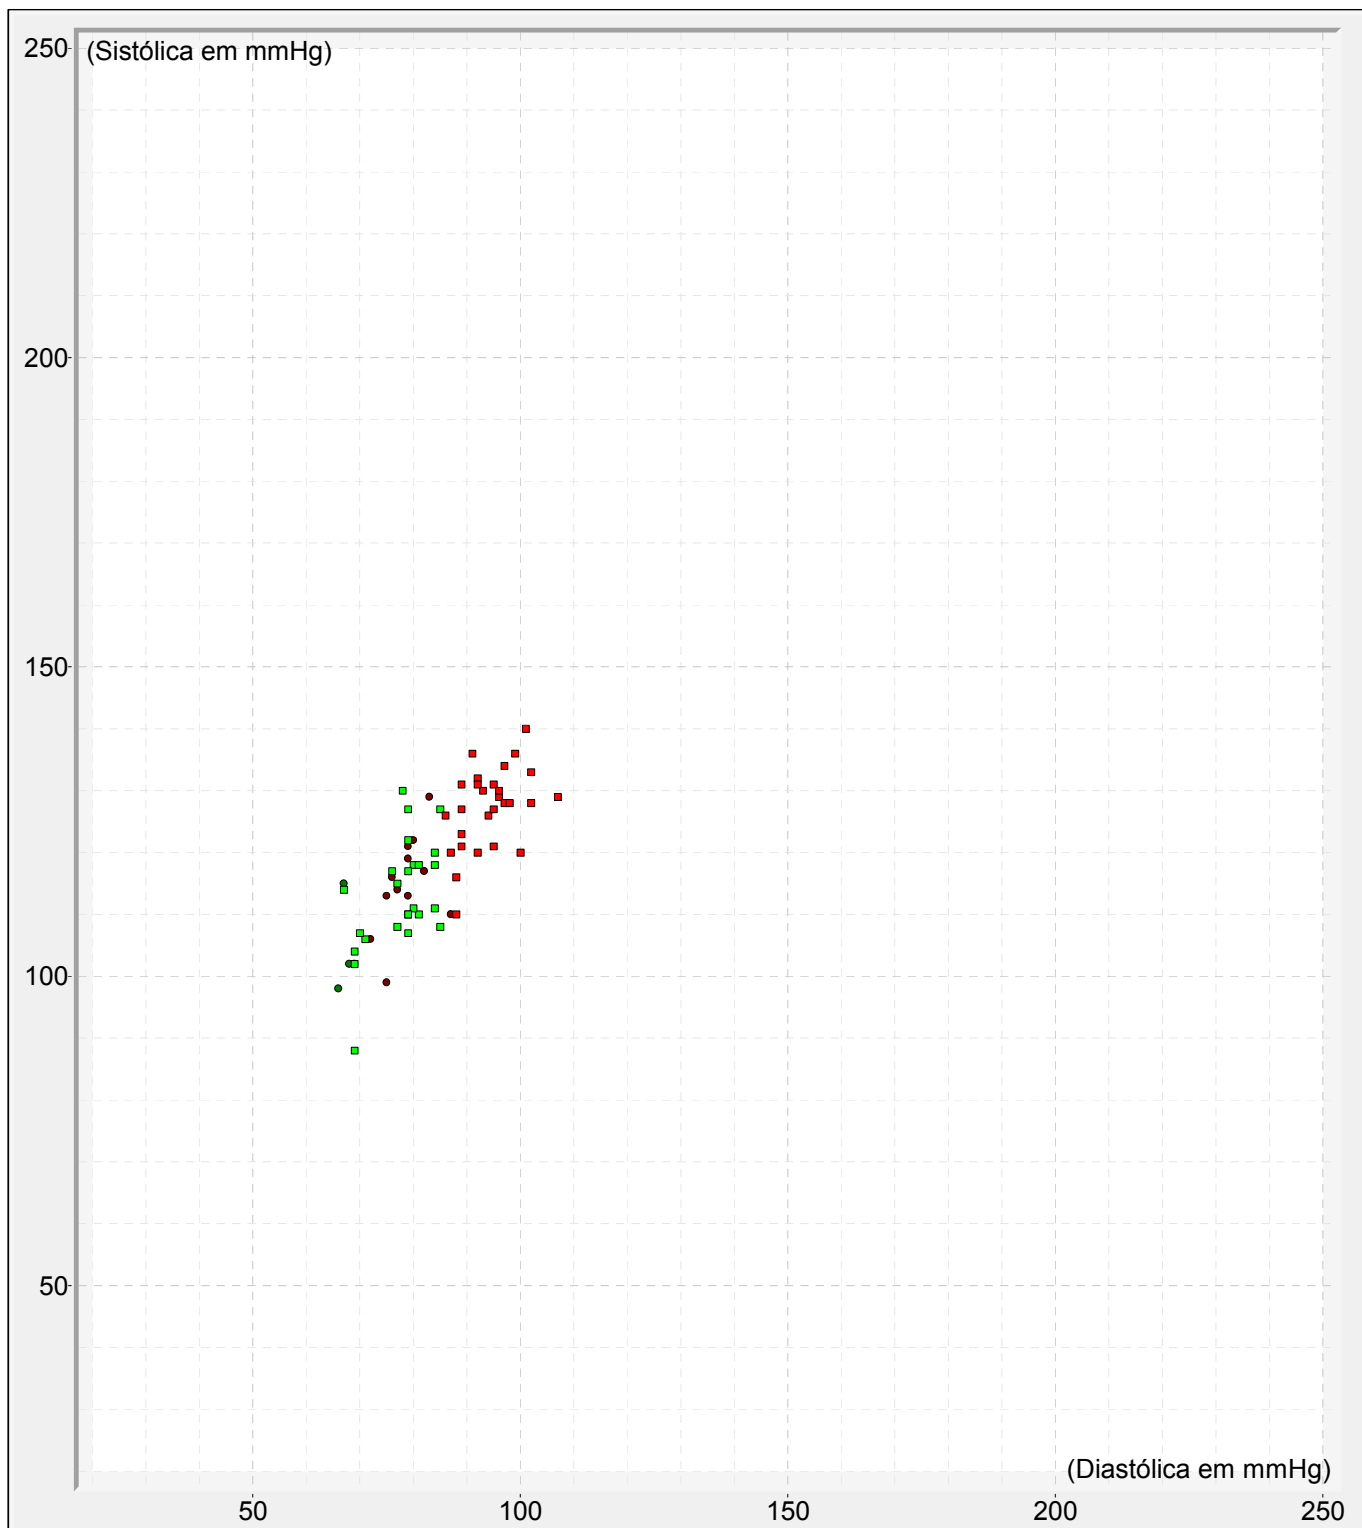

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Histogramas

Nº do Exame
B21-00285

Paciente: VANIA XAVIER SOUSA
Data de Instalação: 04/06/2025 13:40:17

Código:
B21-00285

