


Luís Henrique Pereira da Silva

2025 07 28 10:08
10mm/mV

Real-Time Modo

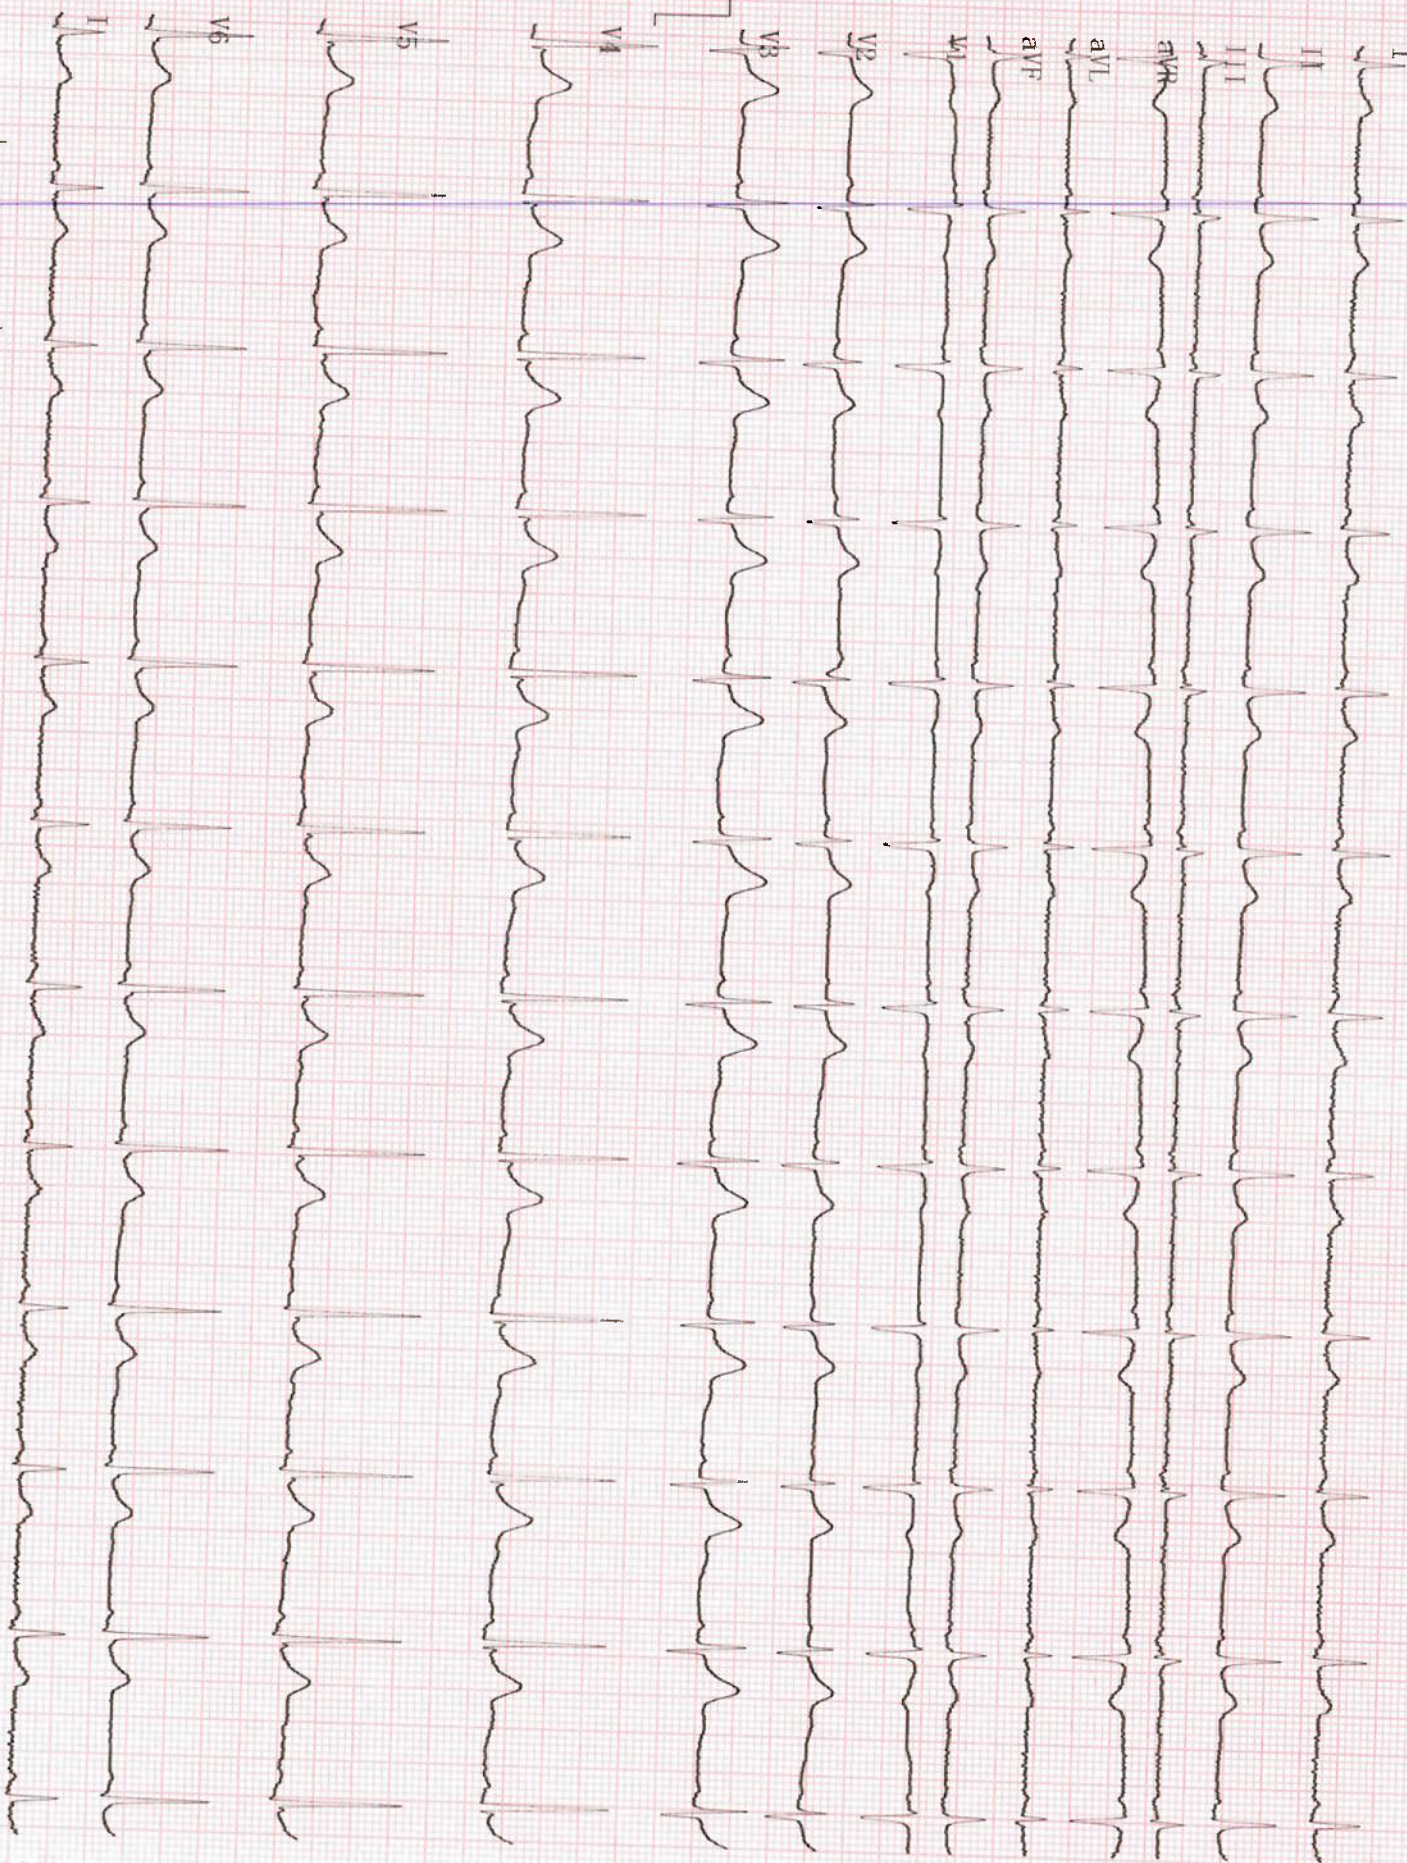

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARD ECG-1200 V4.06.000