


forneço seleção de deriva

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARD ECG-1200 V1.06.000

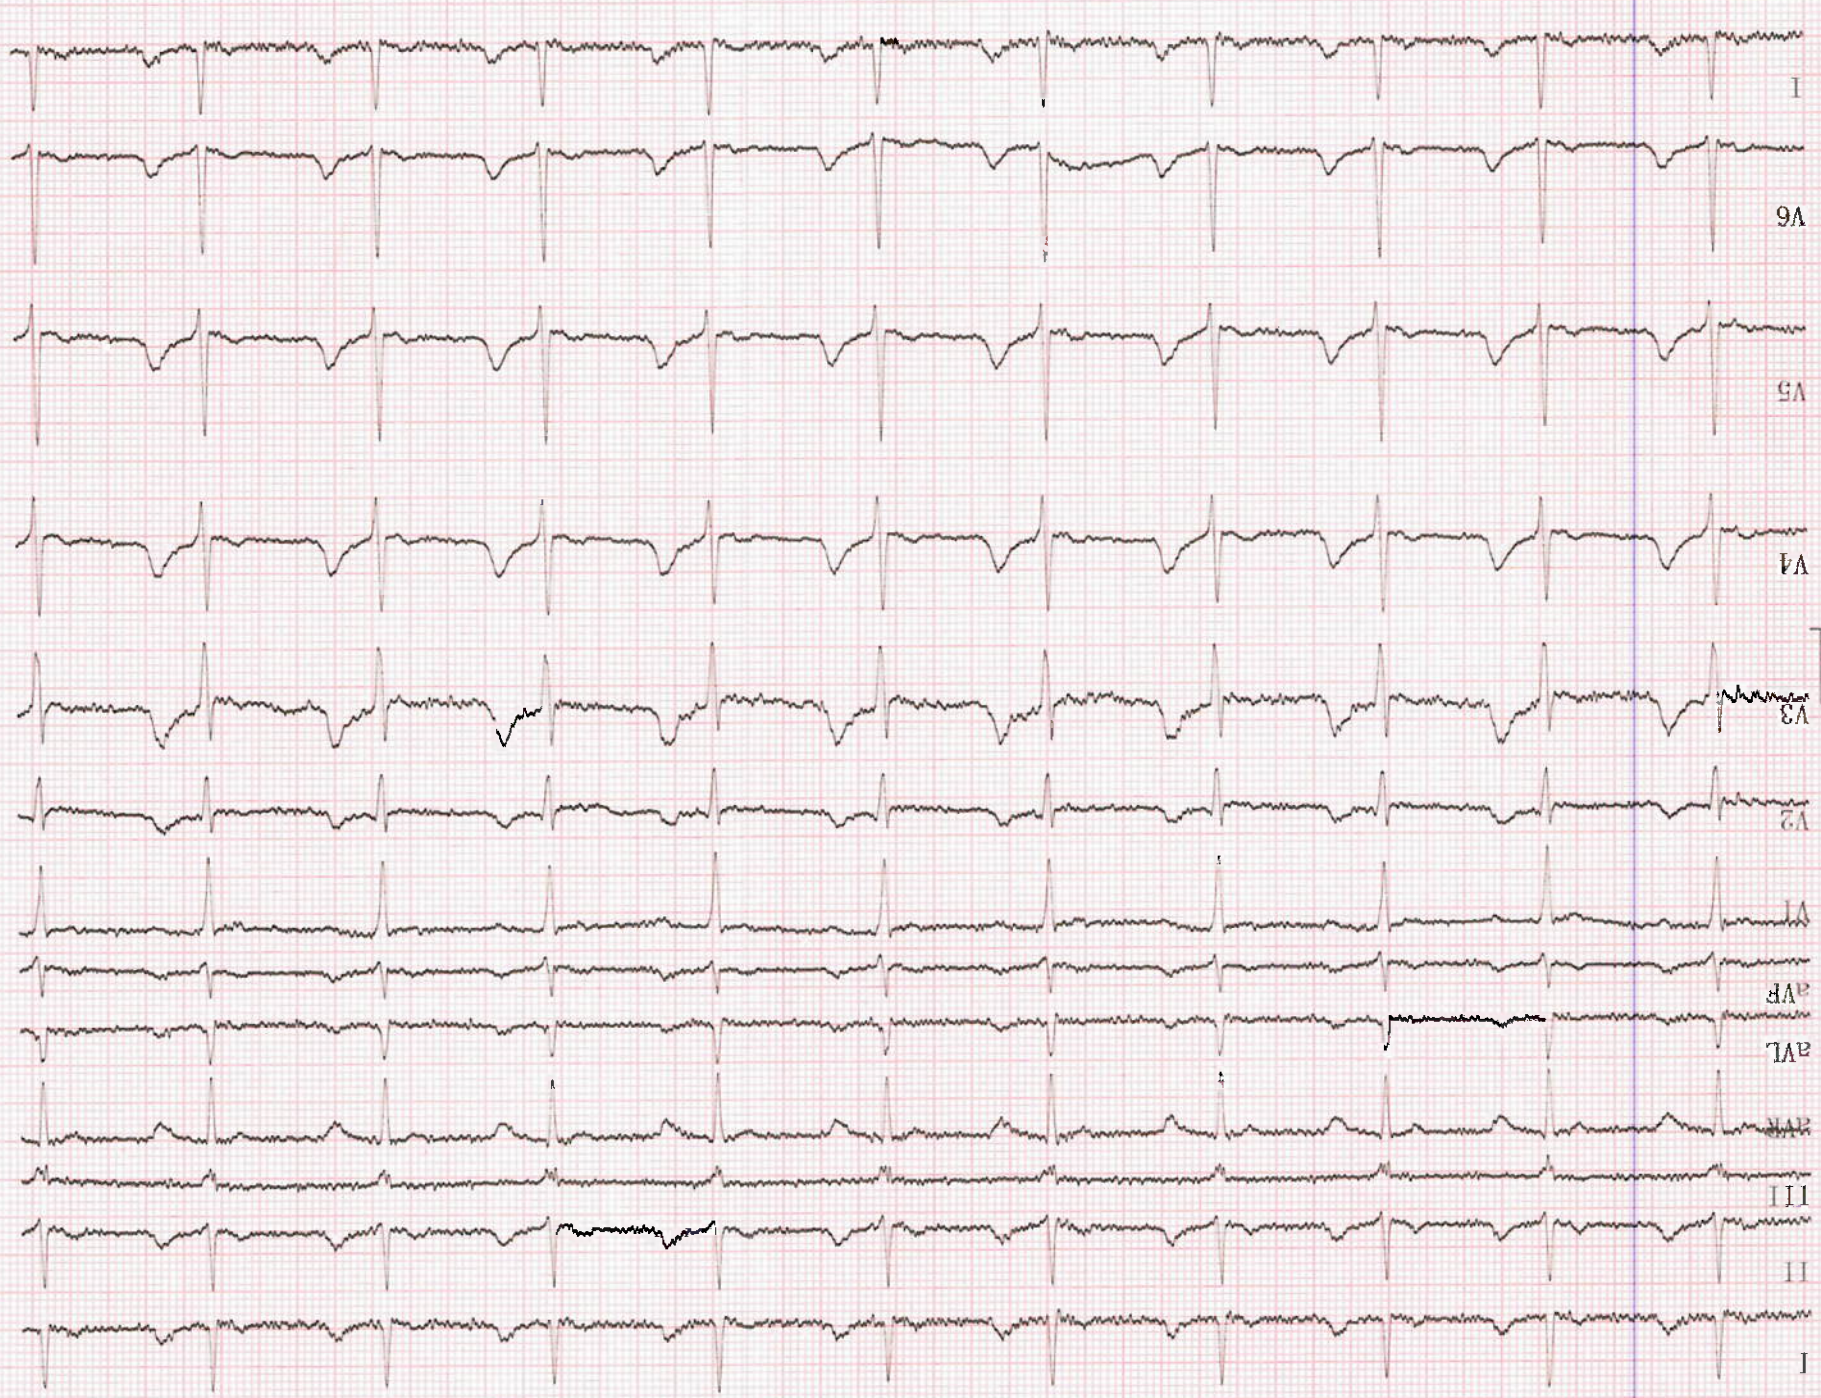

2025 07 28, 09:46 Real-Tempo Modo 10mm/mV