


2025-08-12, 08:53

Real Tempo Modo

1.0mV/mV

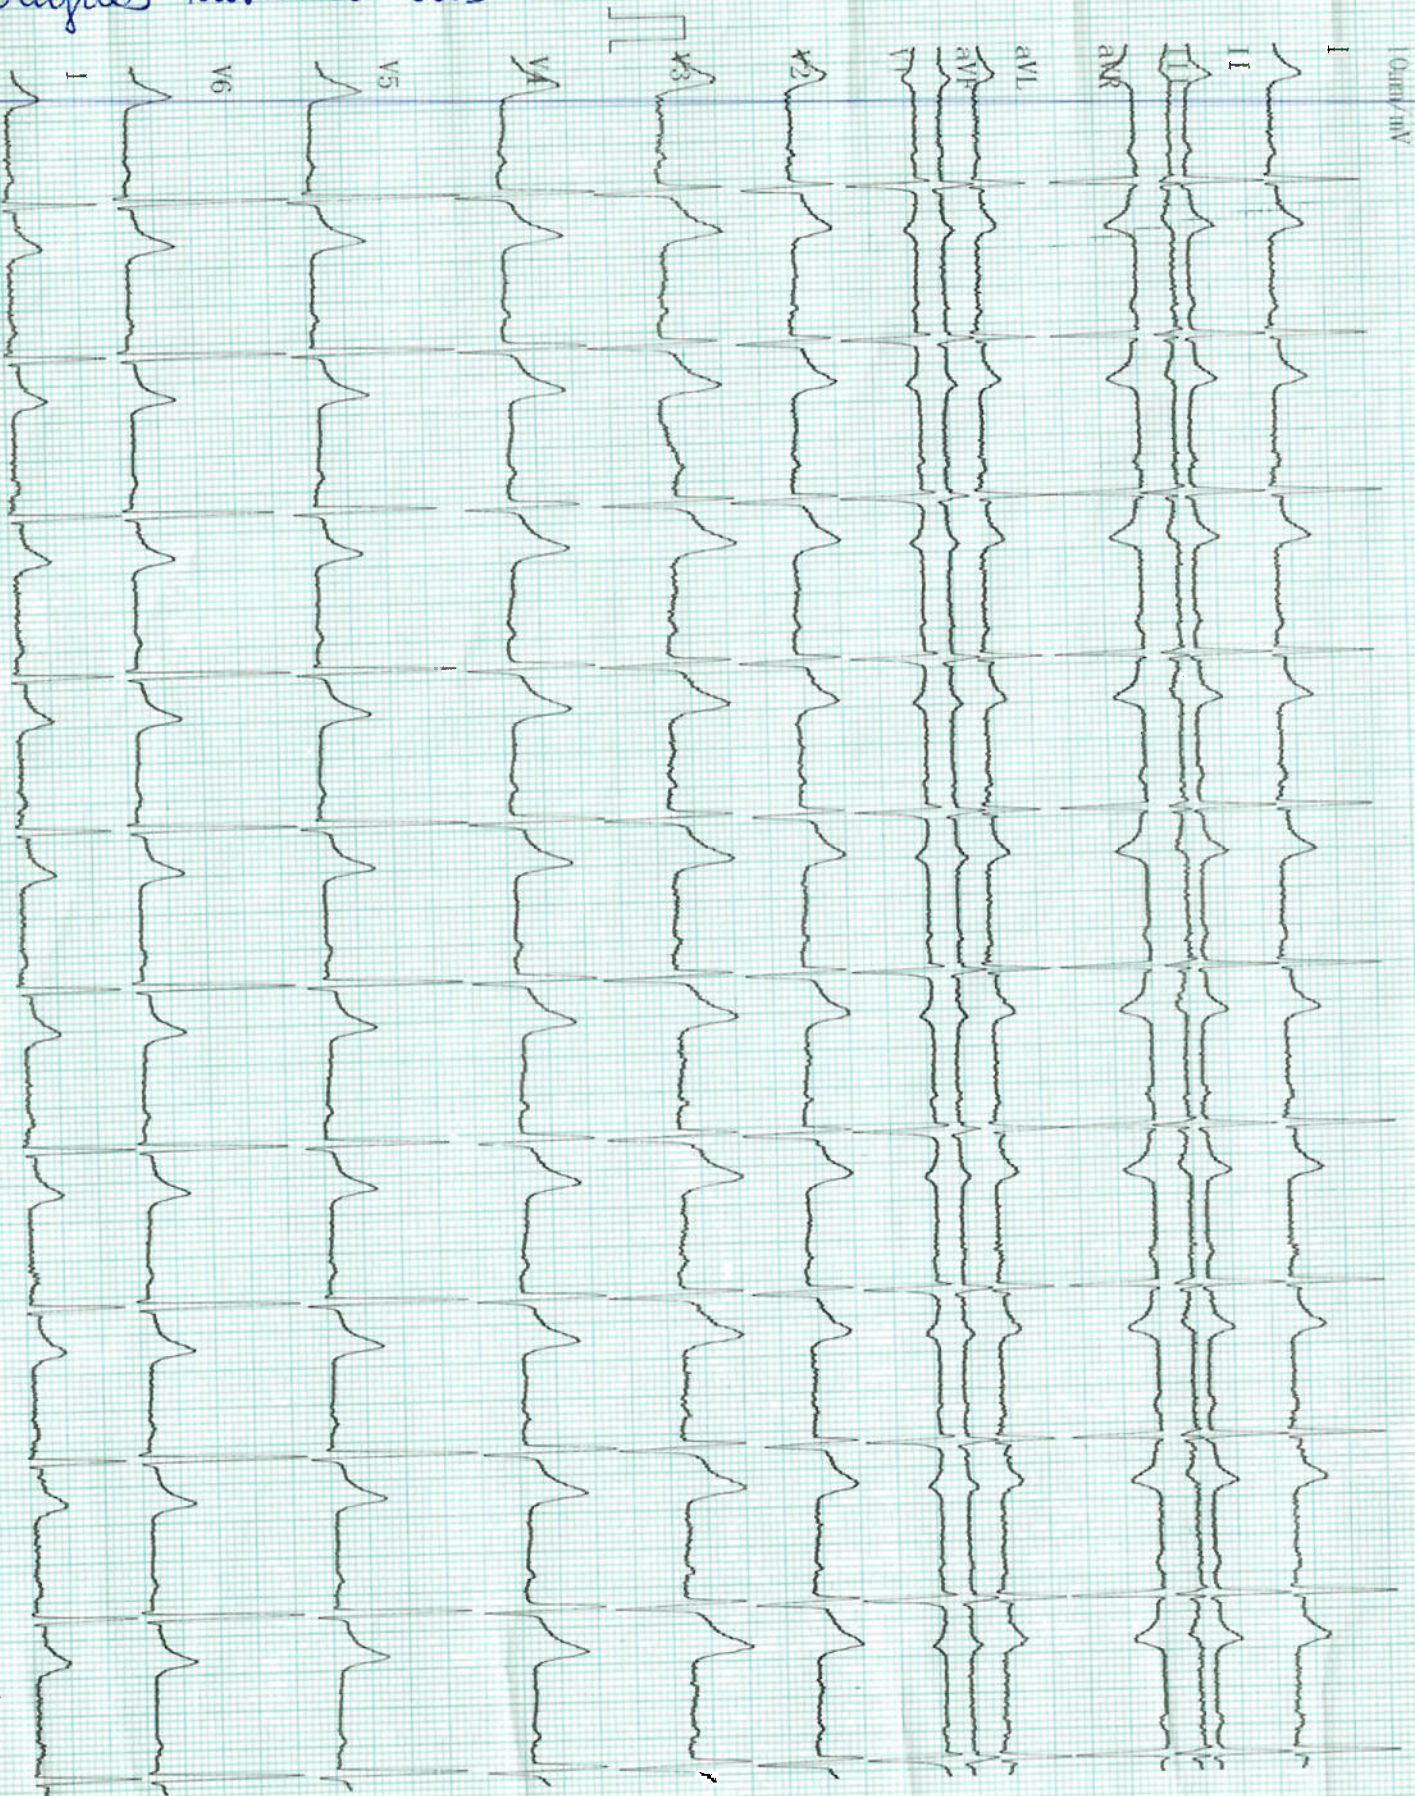

Rodrigues Manoel dos Santos

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOARE ECG-1200 V4.06.000