


2025-07-21, 11:46
1.0mV/mV

Real Tempo Modo

Francisco Antonio da Silva 59 an

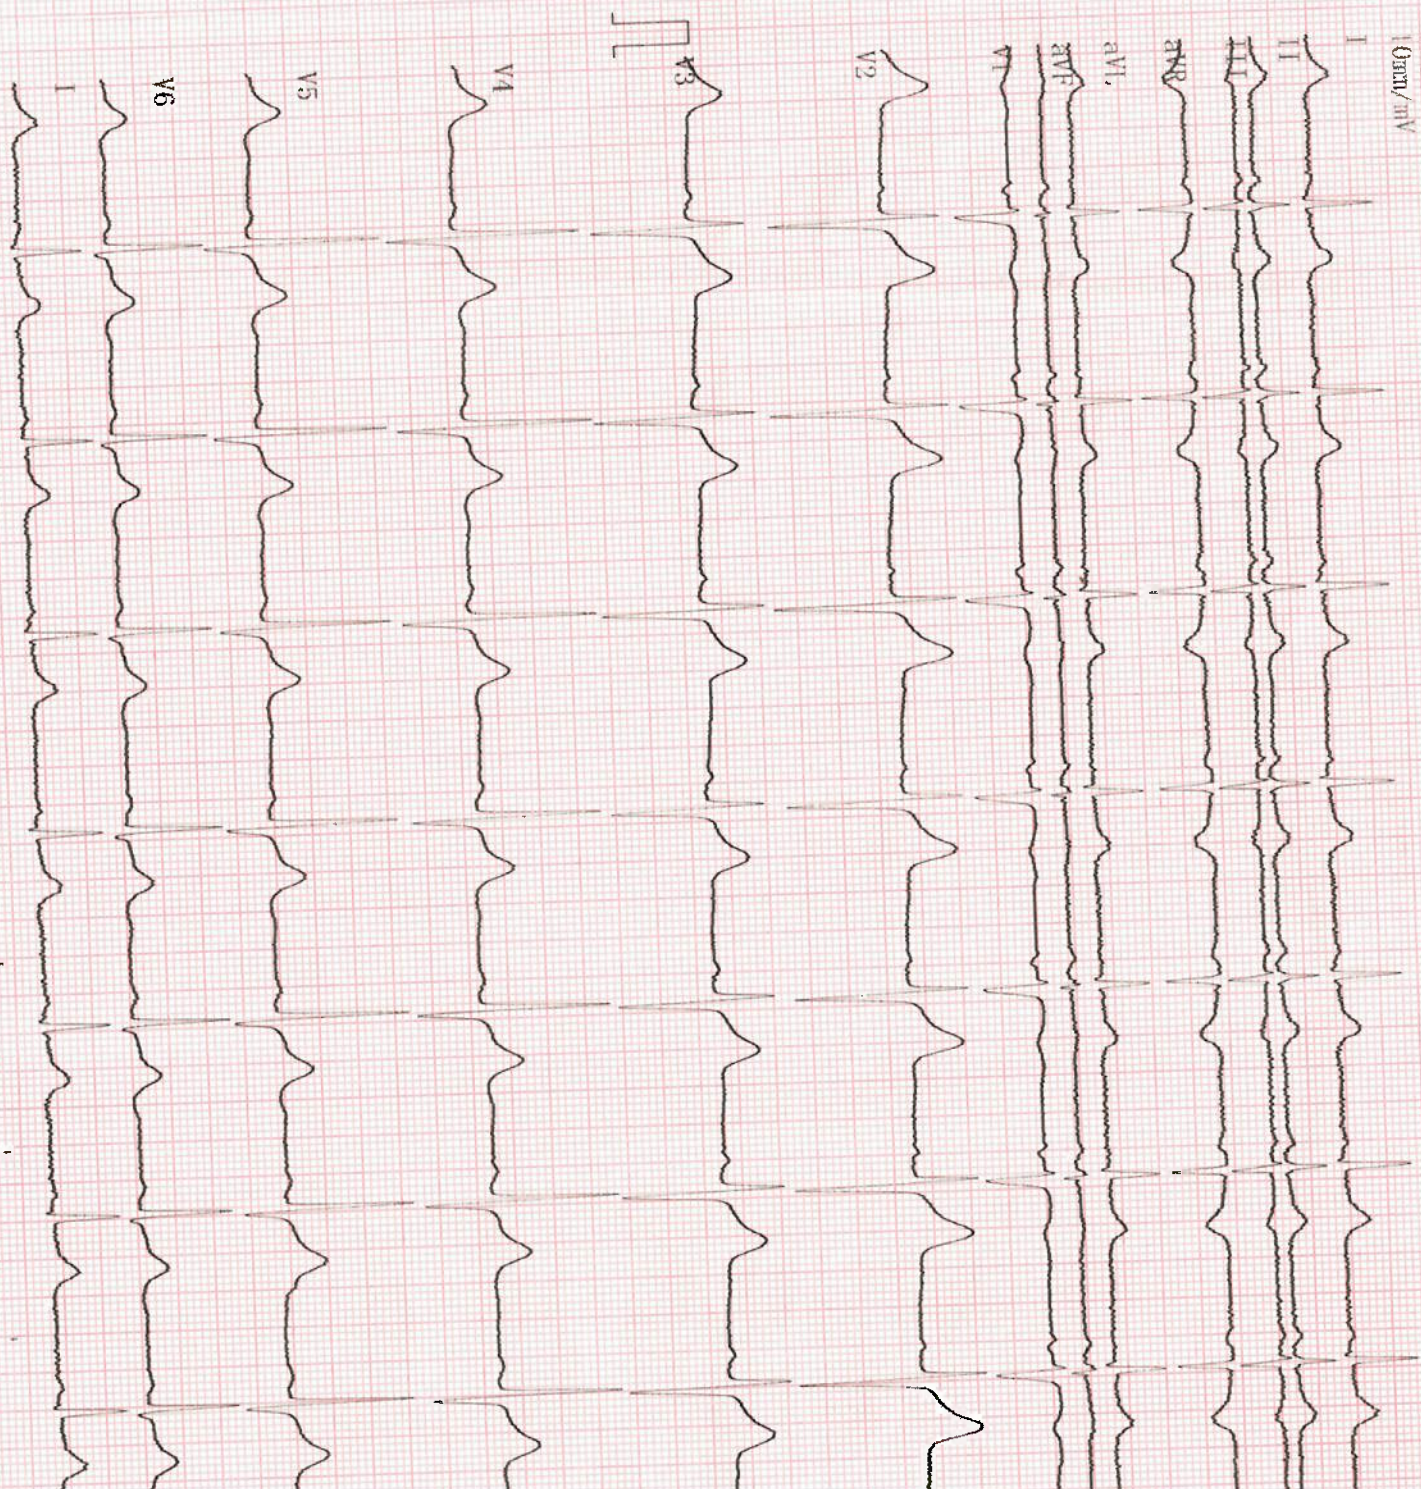

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARE ECG 1200 V4.06.000