



**PREFEITURA DE
CAÇADOR**
Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso, Caçador - SC, 89503-079

Fone: (49) 3561-0904 / (49) 3561-0900

Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

1 - Dados do Exame

Nº do Exame: BL5-00816	Data de Instalação: 10/07/2025 13:24 Término: 11/07/2025 13:51 Protocolo de Medições: Padrão	Código: BL5-00816
----------------------------------	--	------------------------------------

2 - Paciente

Nome: ELENITA APARECIDA LINHARES DA SILVA ALVES **Idade:** 60
Sexo: F **Altura:** 152 **Peso:** 100 **Nascimento:** 11/07/1964
Fumante: Não **Tel:** **Fax:**

Diagnóstico:

Motivo do Exame:

3 - Médico Solicitante

Nome: DANIEL CALHEIROS BATISTA
Clínica:

Tel:
Fax:

4 - Laudo Médico

5 - Data e Assinatura

11/07/2025

DANIEL CALHEIROS BATISTA
C.R.M.: 26357

Tabela das Medições

Nº do Exame: BL5-00816	Paciente: ELENITA APARECIDA LINHARES DA SILVA ALVES Data de Instalação: 10/07/2025 13:24:30	Código: BL5-00816
---	--	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	13:27	138	77	105	61	77	Medição manual	48	06:00	98	44	69	54	58	
2	13:30	145	68	104	77	80		49	06:30	101	45	71	56	60	
3	14:30	104	58	79	46	60		50	07:00	115	53	82	62	56	
4	14:45	119	68	92	51	56		51	07:15	105	56	79	49	58	
5	15:00	110	55	80	55	61		52	07:30	111	53	80	58	58	
6	15:15	113	56	82	57	66		53	07:45	116	63	87	53	67	
7	15:33	120	63	89	57	59		54	08:00	132	53	89	79	71	
8	15:45	117	53	83	64	61		55	08:15	125	67	93	58	73	
9	16:03	117	52	82	65	62		56	08:30	125	63	92	62	65	
10	16:15	144	50	94	94	65		57	08:45	122	63	90	59	69	
11	16:30	116	56	84	60	58		58	09:00	122	61	89	61	67	
12	16:45	132	52	88	80	62		59	09:15	135	43	85	92	64	
13	17:00	112	39	72	73	62		60	09:30	116	64	88	52	64	
14	17:15	120	61	88	59	60		61	09:45	122	45	80	77	64	
15	17:33	113	66	88	47	59		62	10:00	118	57	85	61	60	
16	17:45	112	60	84	52	60		63	10:18	126	57	88	69	58	
17	18:00	111	49	77	62	64		64	10:30	141	62	98	79	66	
18	18:15	112	64	86	48	65		65	10:48	125	56	88	69	62	
19	18:30	122	71	94	51	73		66	11:00	121	72	95	49	76	
20	18:45	124	67	93	57	74		67	11:15	114	57	83	57	65	
21	19:00	124	54	86	70	63		68	11:30	118	56	84	62	64	
22	19:15	126	55	88	71	68		69	11:45	122	63	90	59	73	
23	19:30	129	78	101	51	71		70	12:00	117	61	87	56	72	
24	19:48	128	62	92	66	66		71	12:15	119	71	93	48	76	
25	20:00	127	63	92	64	64		72	12:30	113	61	85	52	70	
26	20:18	127	74	98	53	65		73	12:45	130	77	102	53	82	
27	20:30	115	70	91	45	78		74	13:00	124	62	91	62	78	
28	20:45	125	66	93	59	76		75	13:33	109	64	85	45	77	
29	21:00	114	65	87	49	72		76	13:48	94	69	81	25	69	
30	21:15	131	63	94	68	69		77	13:51						Aparelho desligado manualmente
31	21:30	120	55	85	65	71									
32	21:45	129	69	97	60	76									
33	22:00	110	55	80	55	68									
34	22:15	112	55	81	57	67									
35	22:30	113	54	81	59	62									
36	22:45	112	55	81	57	59									
37	23:00	110	55	81	55	63									
38	00:03	107	53	77	54	66									
39	00:30	119	64	89	55	58									
40	01:00	83	37	58	46	58									
41	01:30	78	37	56	41	56									
42	02:30	84	36	58	48	56									
43	03:00	105	56	78	49	57									
44	03:30	106	49	75	57	56									
45	04:00	120	66	91	54	59									
46	04:33	87	42	63	45	56									
47	05:30	116	57	84	59	52									



Análise Estatística

Nº do Exame: BL5-00816	Paciente: ELENITA APARECIDA LINHARES DA SILVA ALVES Data de Instalação: 10/07/2025 13:24:30	Código: BL5-00816
---	--	------------------------------------

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	85	
Medições Válidas:	76 = 89%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	117 / 59 mmHg	menor que 125 / 75 mmHg
Período da Vigília:	120 / 60 mmHg	menor que 130 / 85 mmHg
Período do Sono:	101 / 49 mmHg	menor que 110 / 70 mmHg
Descenso Noturno:	16% / 18%	entre 10% e 20% / 10% e 20%
3 - Valores Máximos		Comentários
Período da Vigília:		Medição manual
PAS:	145 mmHg às 13:30 h	
PAD:	78 mmHg às 19:30 h	
PAM:	105 mmHg às 13:27 h	
PP:	94 mmHg às 16:15 h	
Período do Sono:		
PAS:	120 mmHg às 04:00 h	
PAD:	66 mmHg às 04:00 h	
PAM:	91 mmHg às 04:00 h	
PP:	59 mmHg às 05:30 h	
4 - Valores Mínimos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	94 mmHg às 13:48 h	
PAD:	39 mmHg às 17:00 h	
PAM:	72 mmHg às 17:00 h	
PP:	25 mmHg às 13:48 h	
Período do Sono:		
PAS:	78 mmHg às 01:30 h	
PAD:	36 mmHg às 02:30 h	
PAM:	56 mmHg às 01:30 h	
PP:	41 mmHg às 01:30 h	



**PREFEITURA DE
CAÇADOR**
Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso, Caçador - SC, 89503-079

Fone: (49) 3561-0904 / (49) 3561-0900

Gráfico das Pressões

Nº do Exame: BL5-00816	Paciente: ELENITA APARECIDA LINHARES DA SILVA ALVES Data de Instalação: 10/07/2025 13:24:30	Código: BL5-00816
---	--	------------------------------------


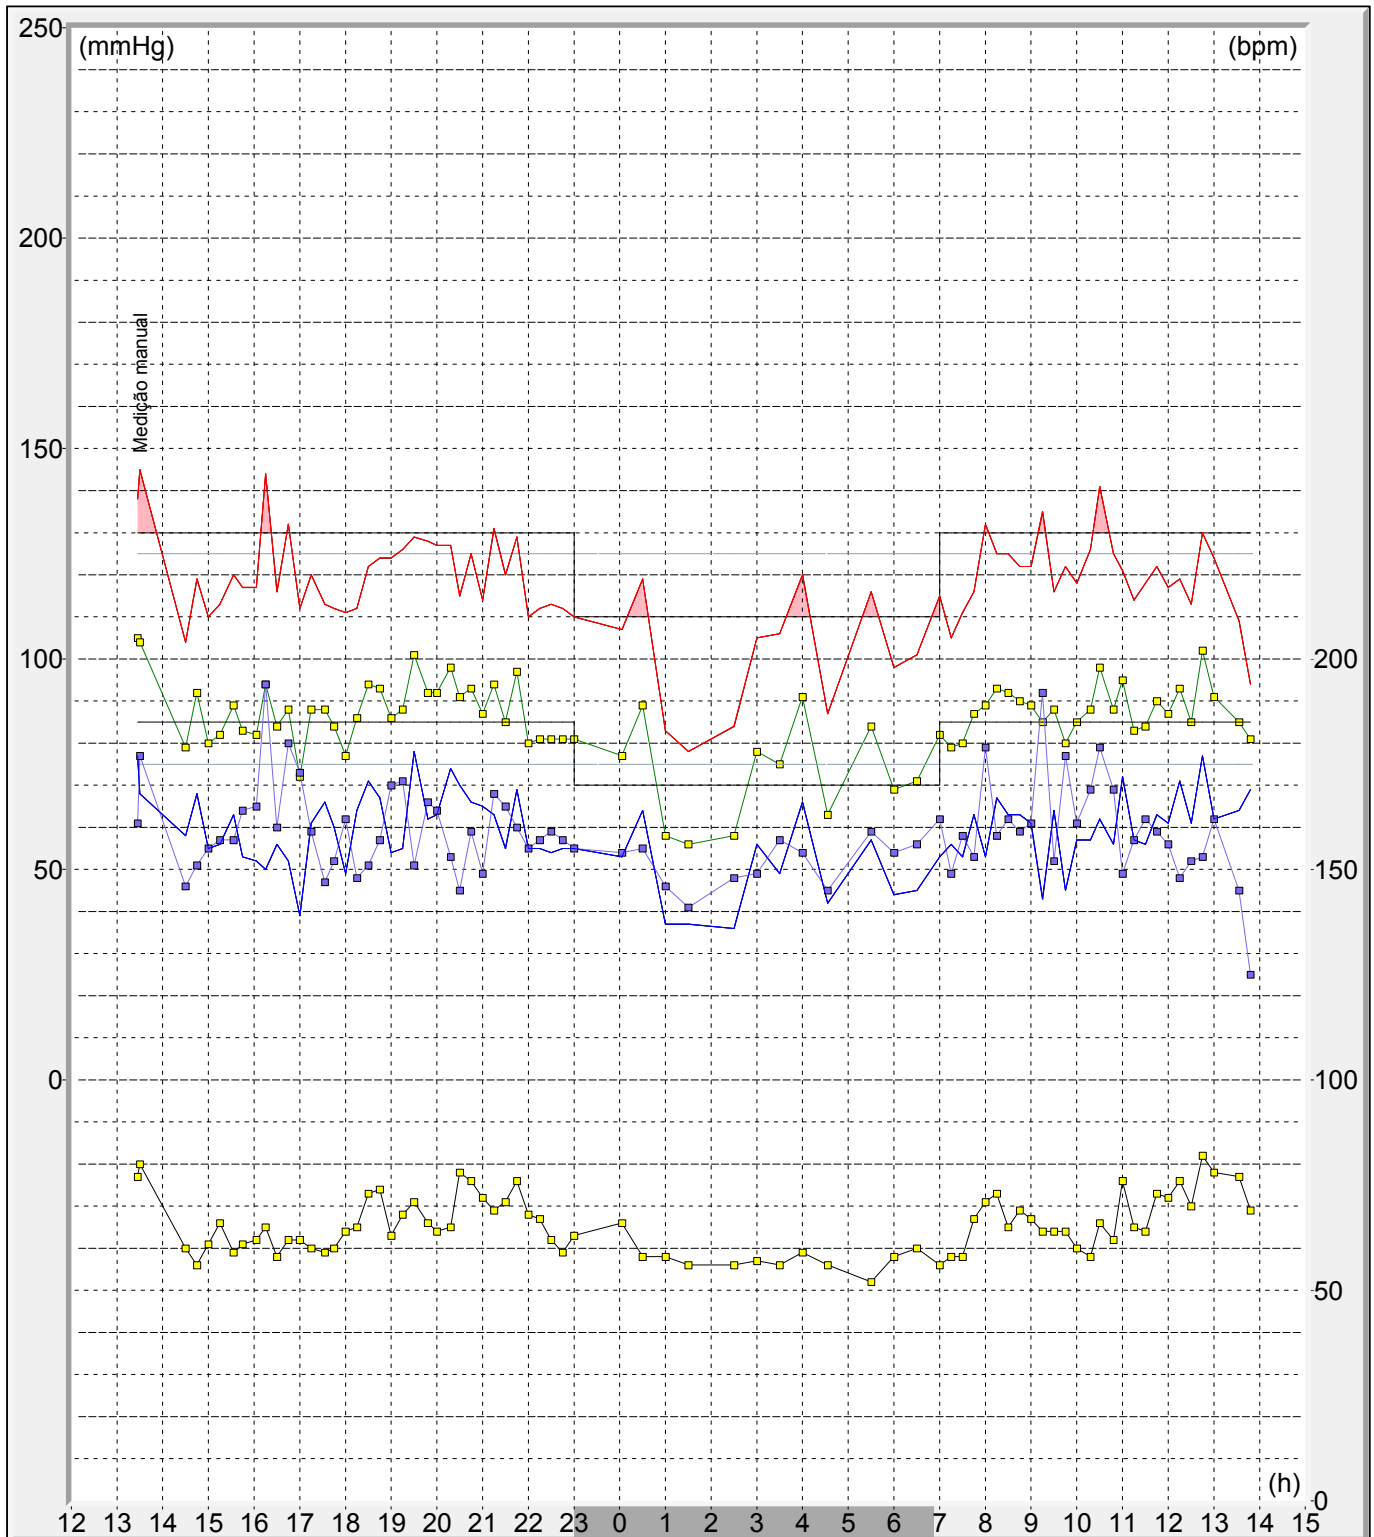


Gráfico de Tendências

Nº do Exame: BL5-00816	Paciente: ELENITA APARECIDA LINHARES DA SILVA ALVES Data de Instalação: 10/07/2025 13:24:30	Código: BL5-00816
---	--	------------------------------------



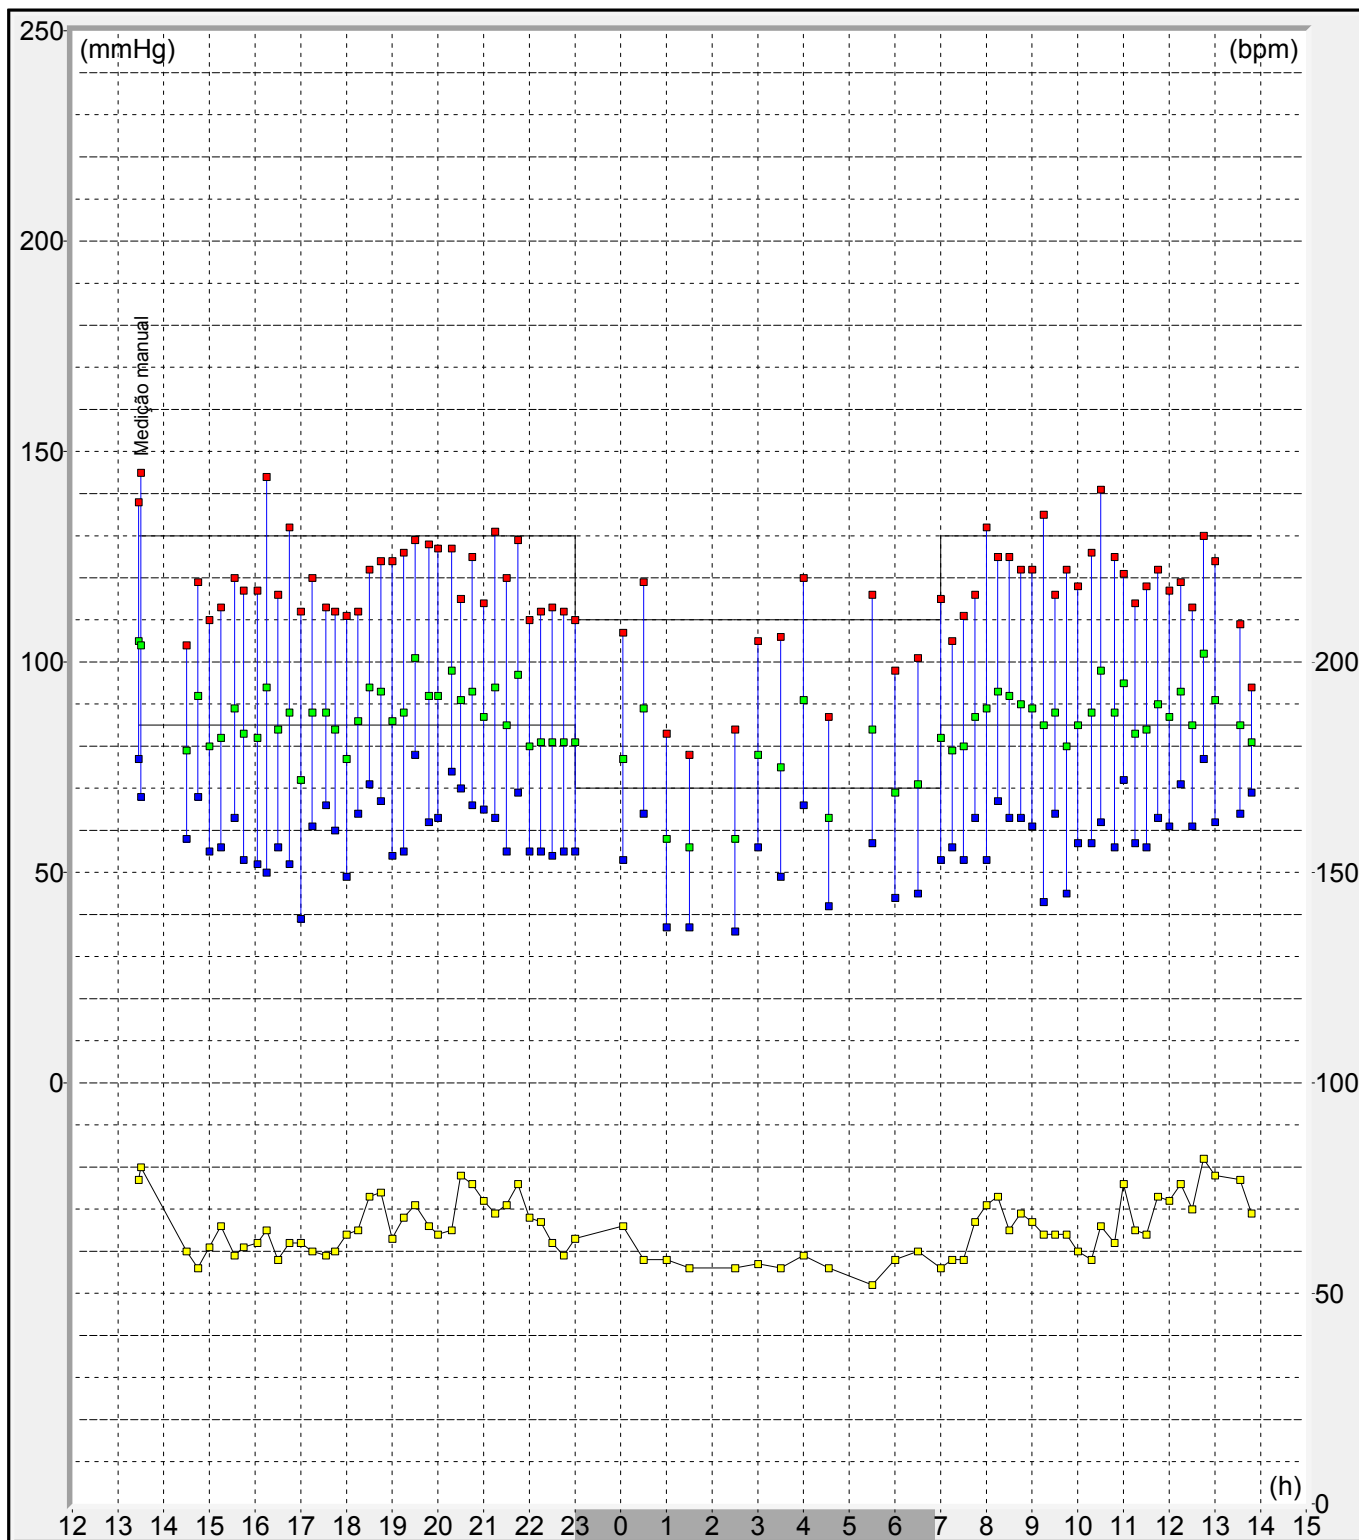

**PREFEITURA DE
CAÇADOR**
Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso, Caçador - SC, 89503-079

Fone: (49) 3561-0904 / (49) 3561-0900

Gráfico de Correlação

Nº do Exame: BL5-00816	Paciente: ELENITA APARECIDA LINHARES DA SILVA ALVES Data de Instalação: 10/07/2025 13:24:30	Código: BL5-00816
---	--	------------------------------------

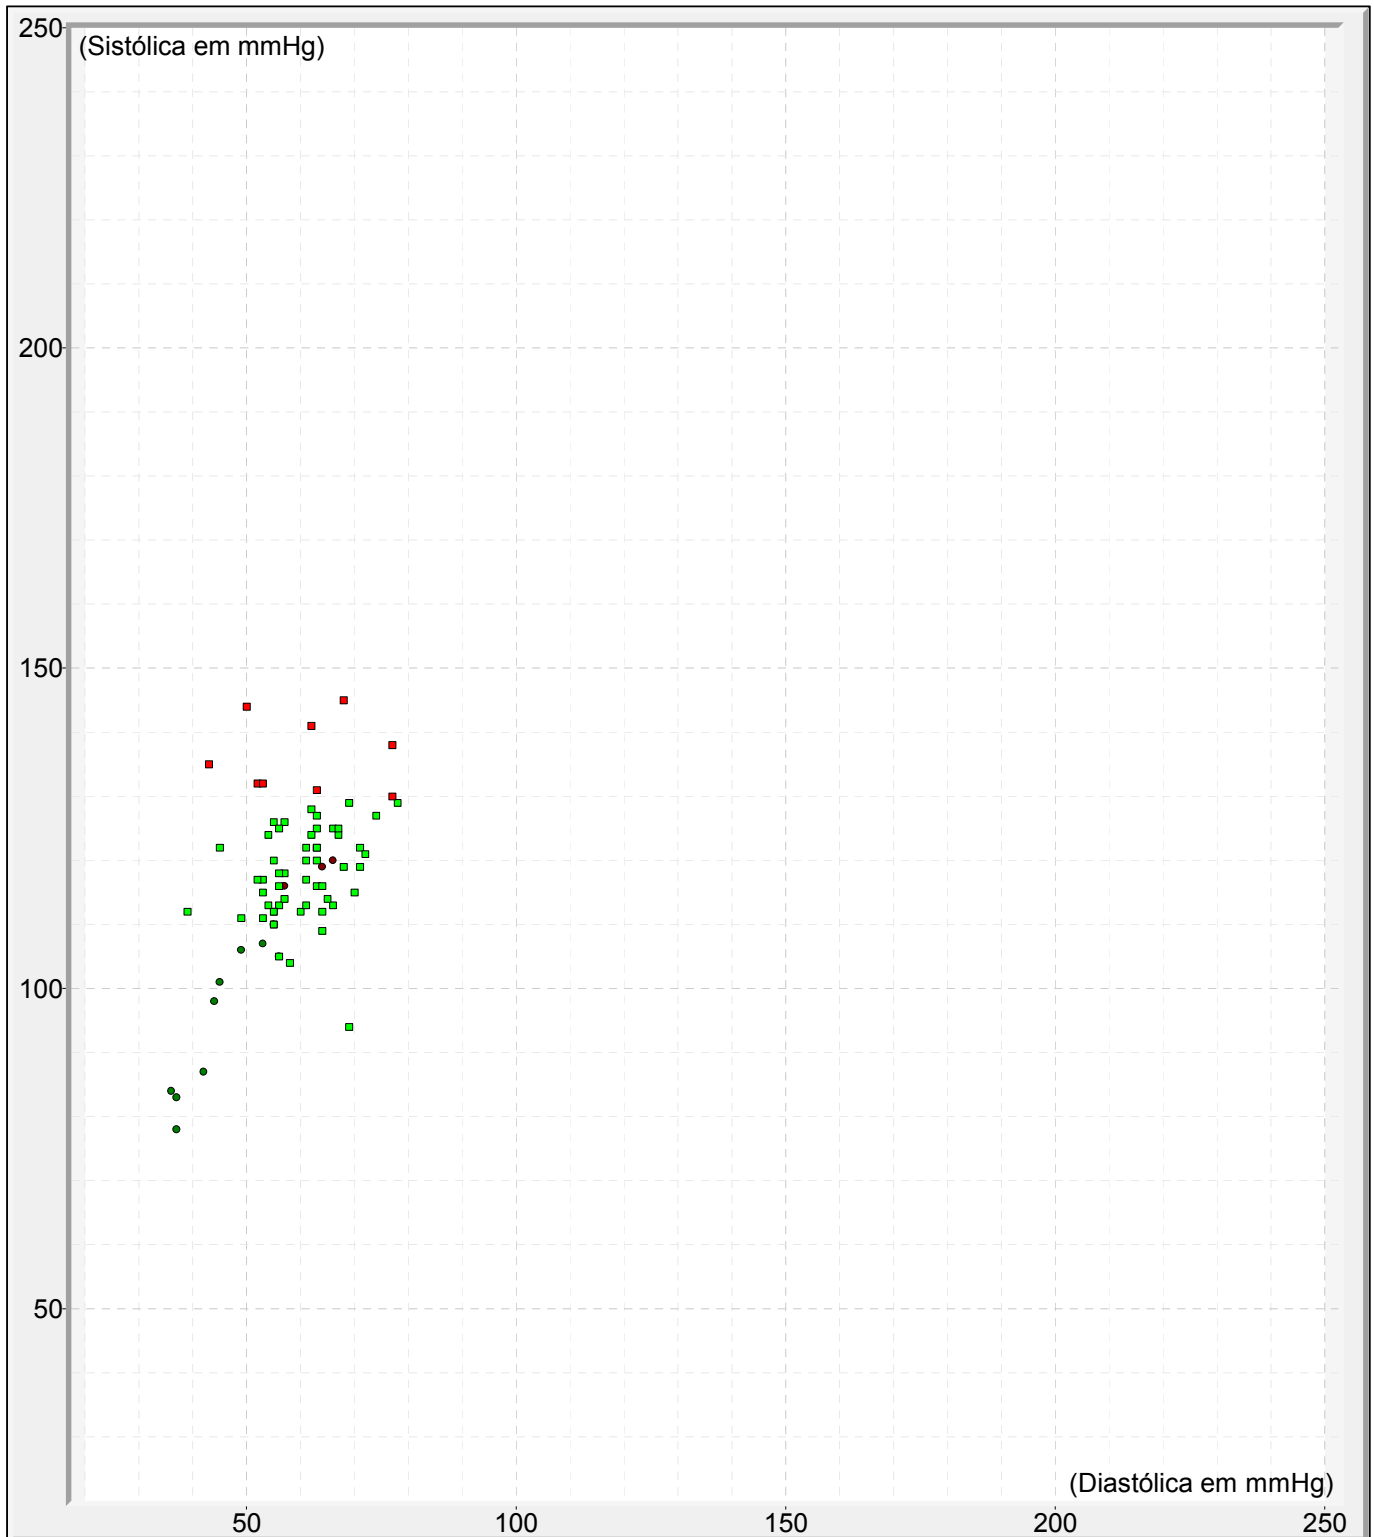

Histogramas

Nº do Exame: BL5-00816	Paciente: ELENITA APARECIDA LINHARES DA SILVA ALVES Data de Instalação: 10/07/2025 13:24:30	Código: BL5-00816
---	---	------------------------------------

