


Cardine Nascimento Oliveira Falcão

2025 07 23, 09:11
1.0mm/mV

Real Tempo Modo

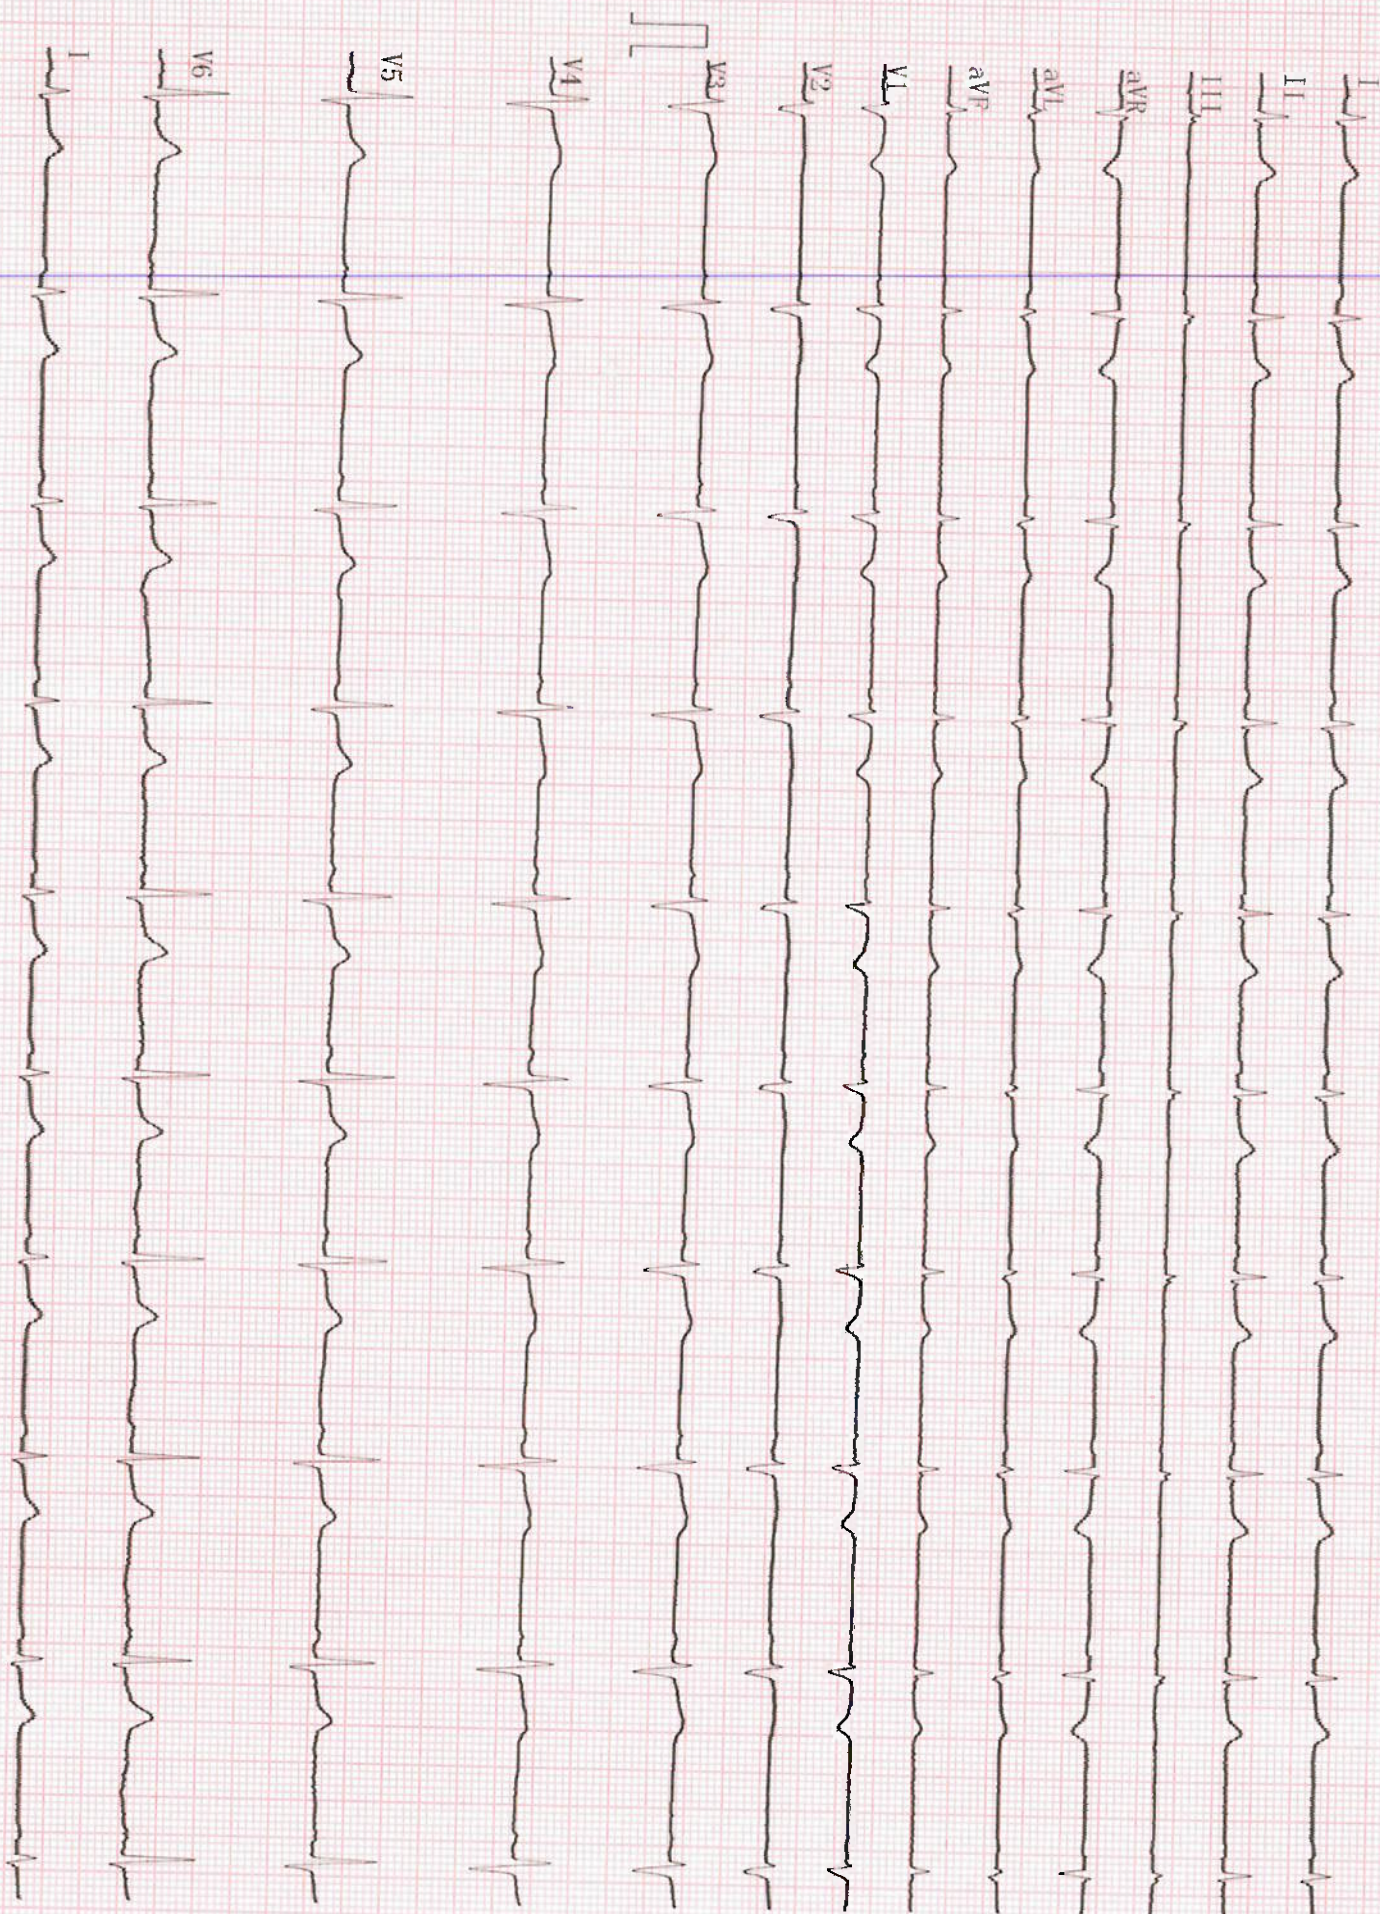

Velocidade: 25mm/s Filtro: 150 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARE ECG 1200 V4.06.000