


JOÃO FERNANDO MAC DA SILVA DN. 2710811993

Real Tempo Modo

10mm/mV

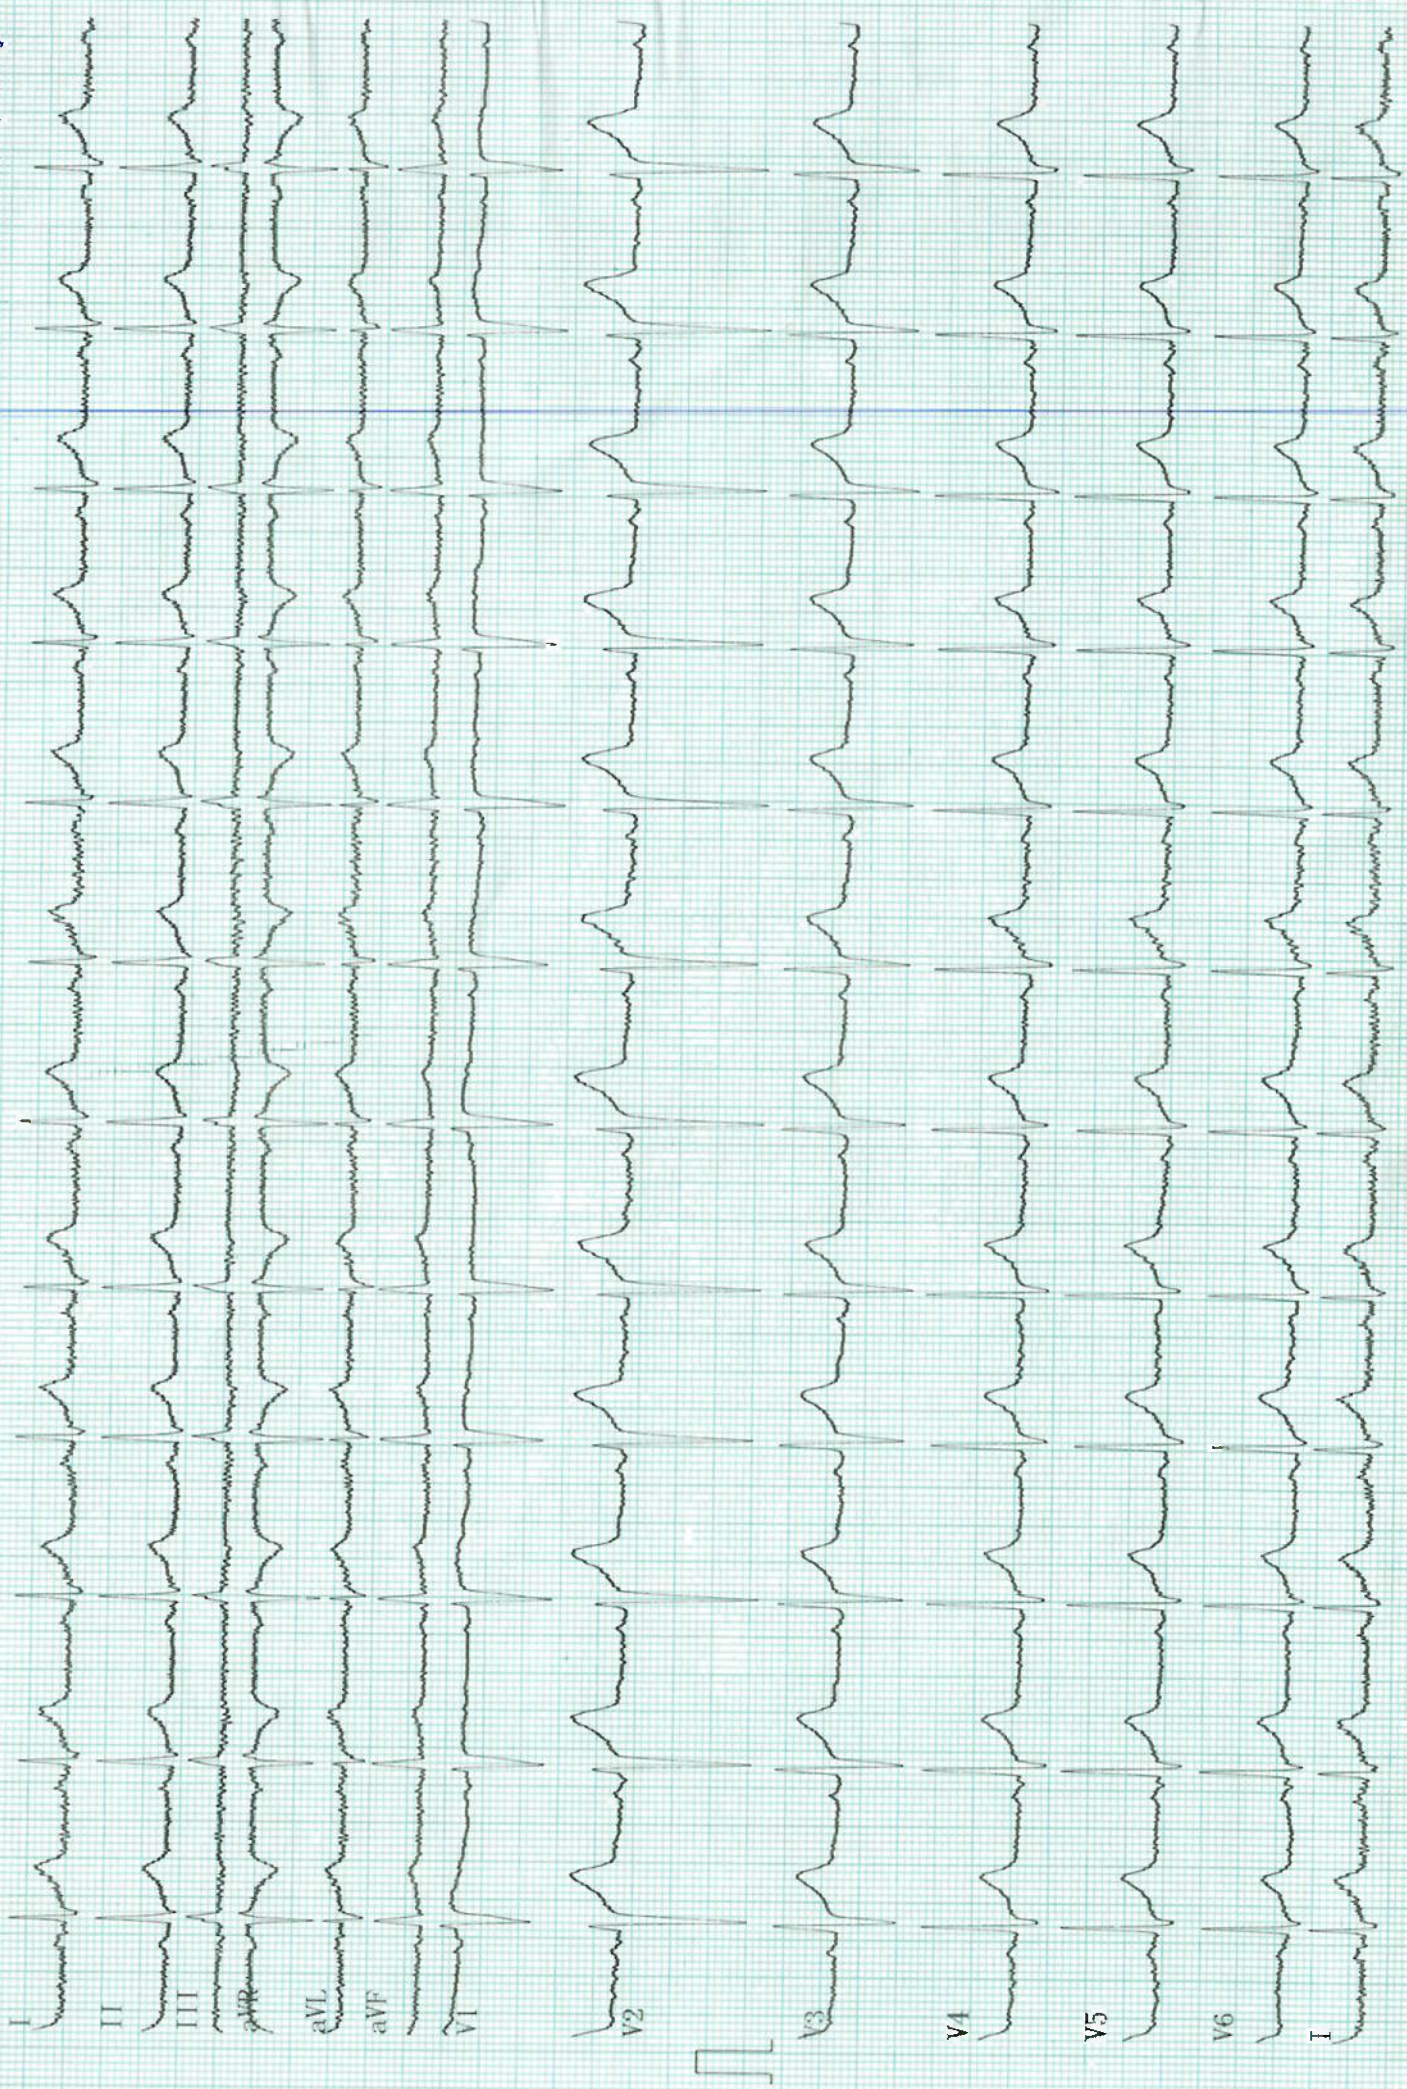

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIO CARE ECG 1200 V4.06.000