


2025-08-12, 08:24

Real Tempo Modo

10mm/mV

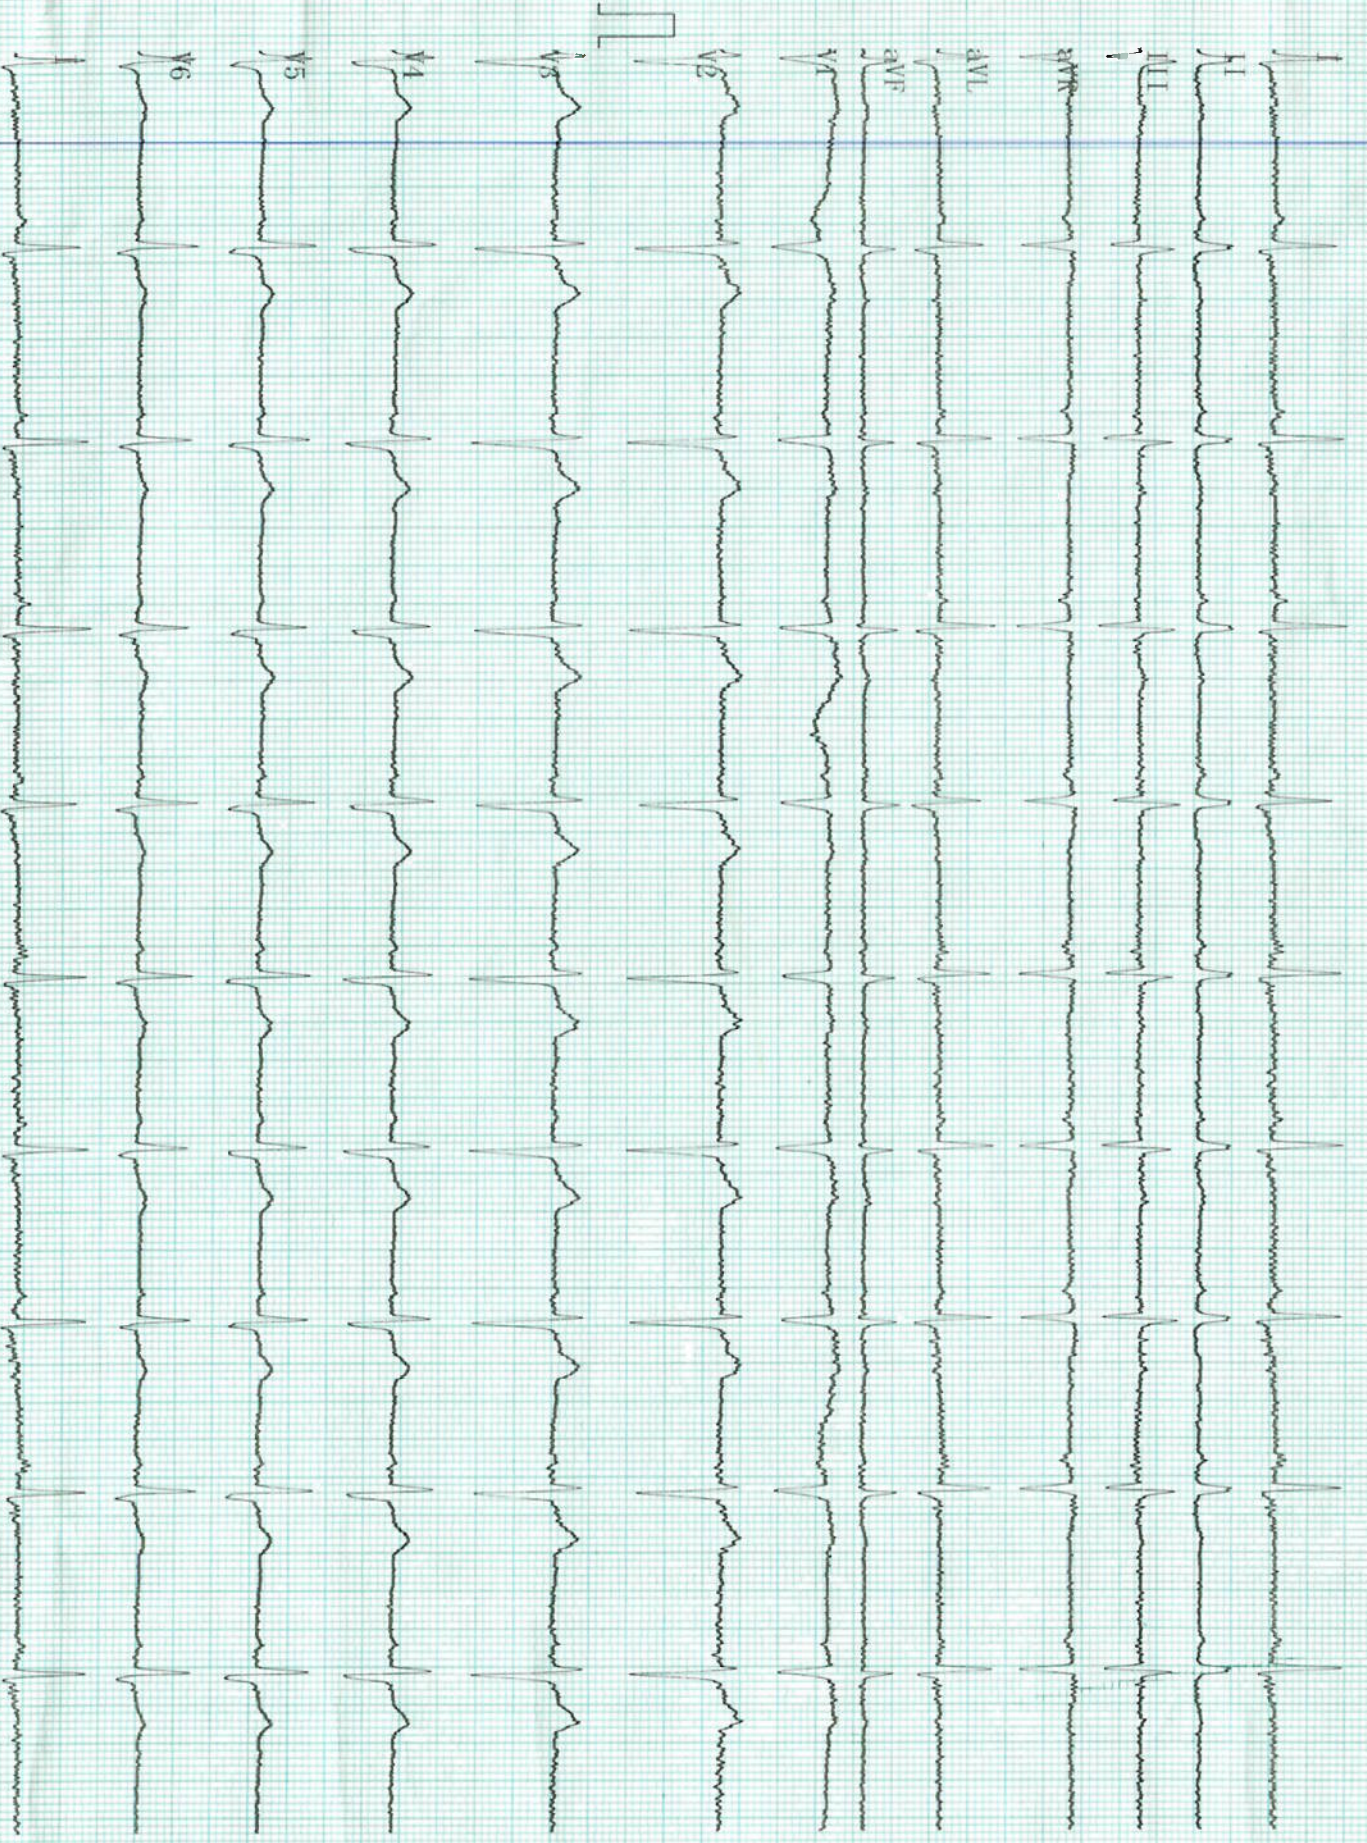

Fernando Vicente da Trindade

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARE ECG-1200 V4.06.000