


João Luiz de Silva 36 anos

2025-08-04, 09:49
1 Deriv./mV
Real-Time Modo

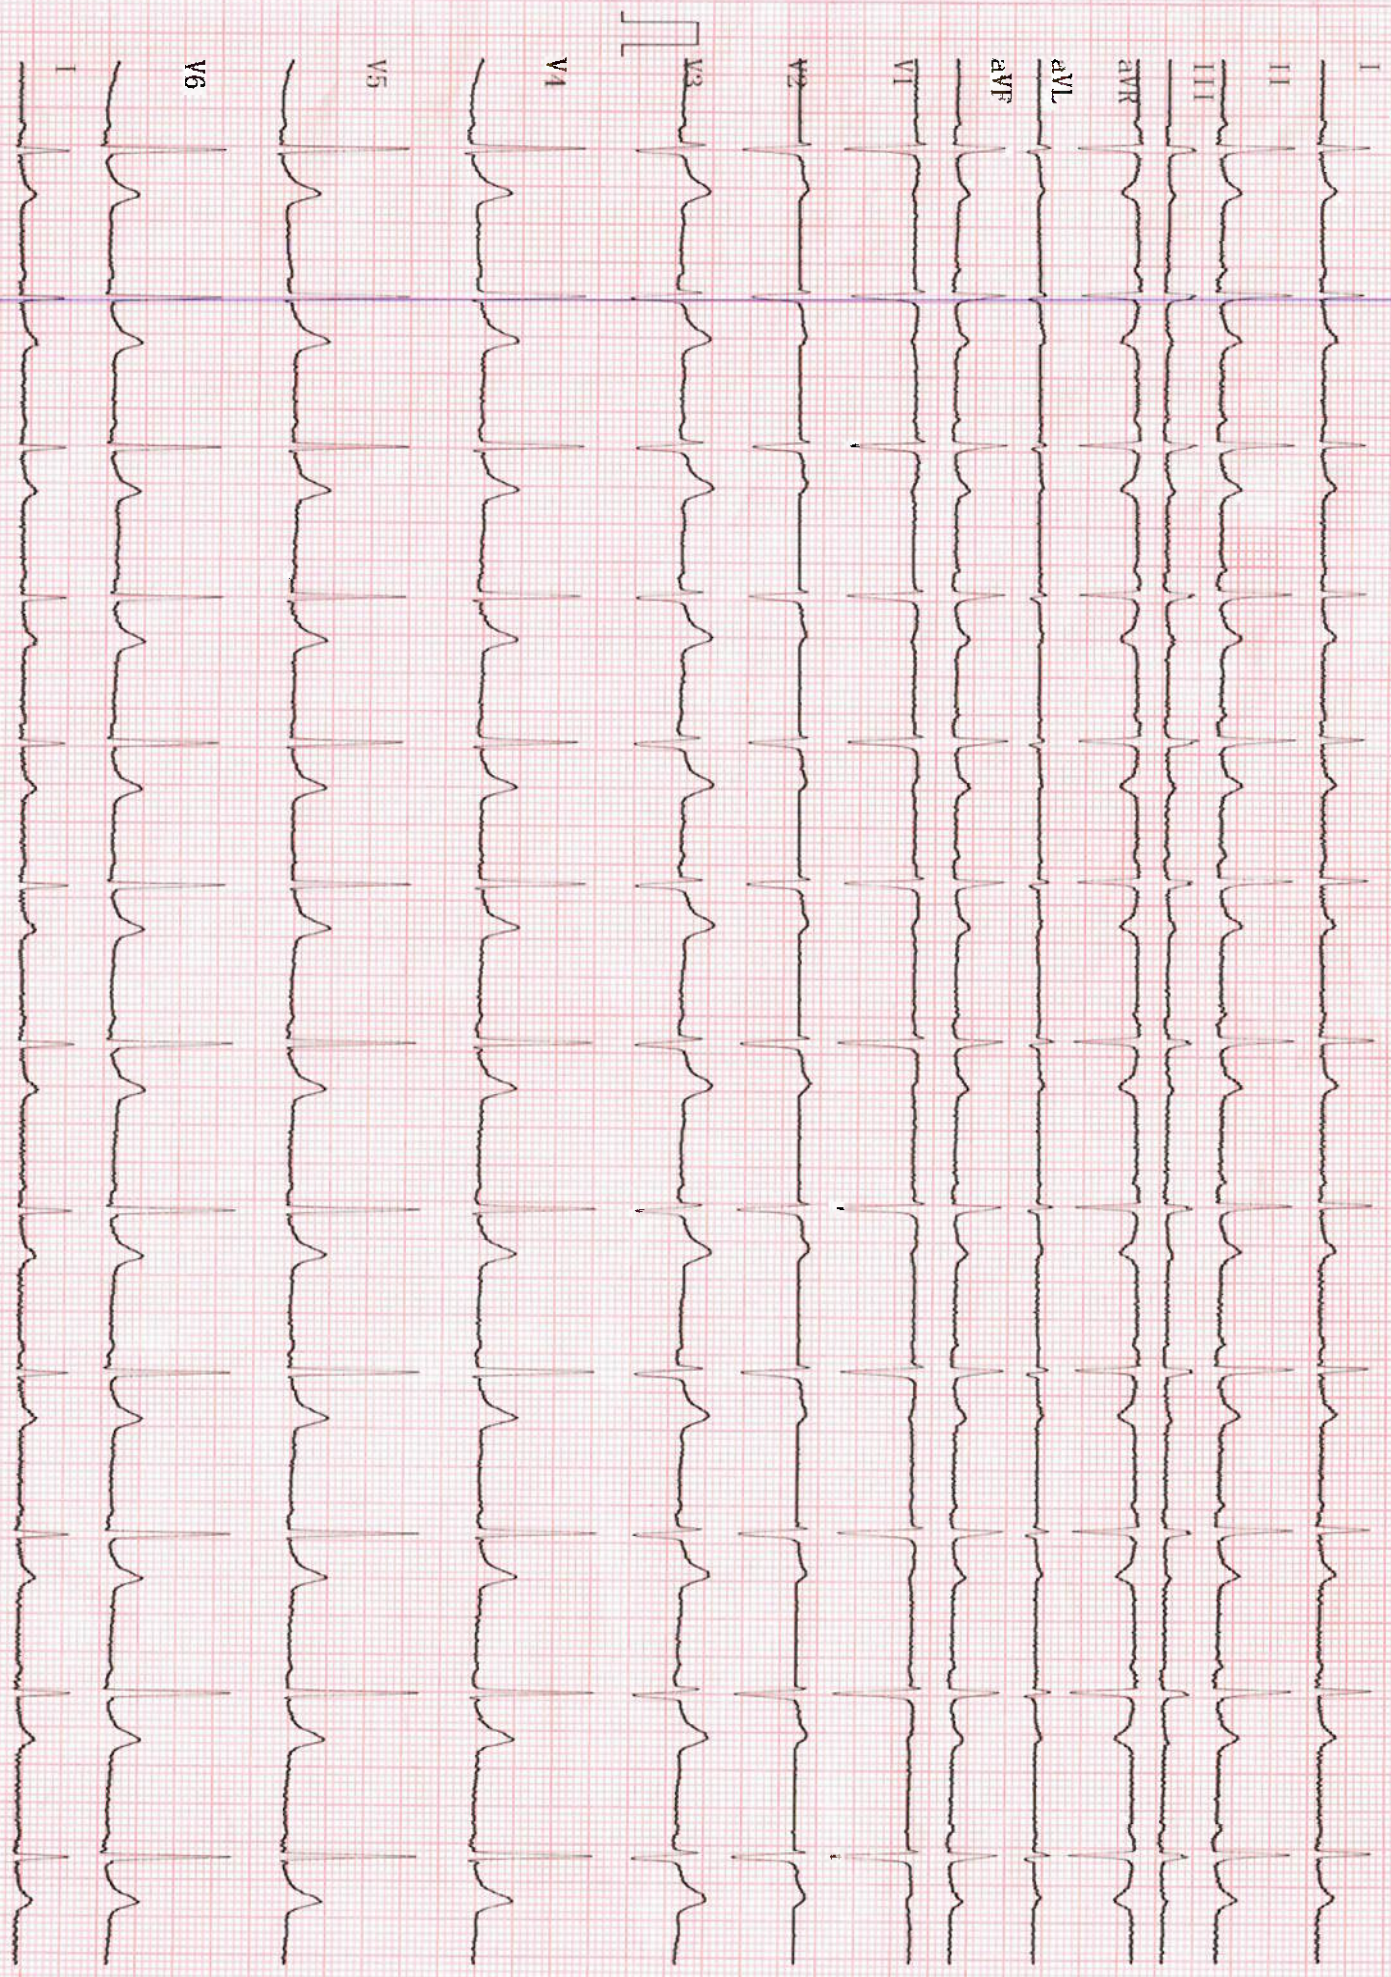

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIOCARD ECG-1200 V4.06.000