


Waldia Feijoa de Souto DN. 05/09/1998

ACQU. Tempo Modo

10mm/mV

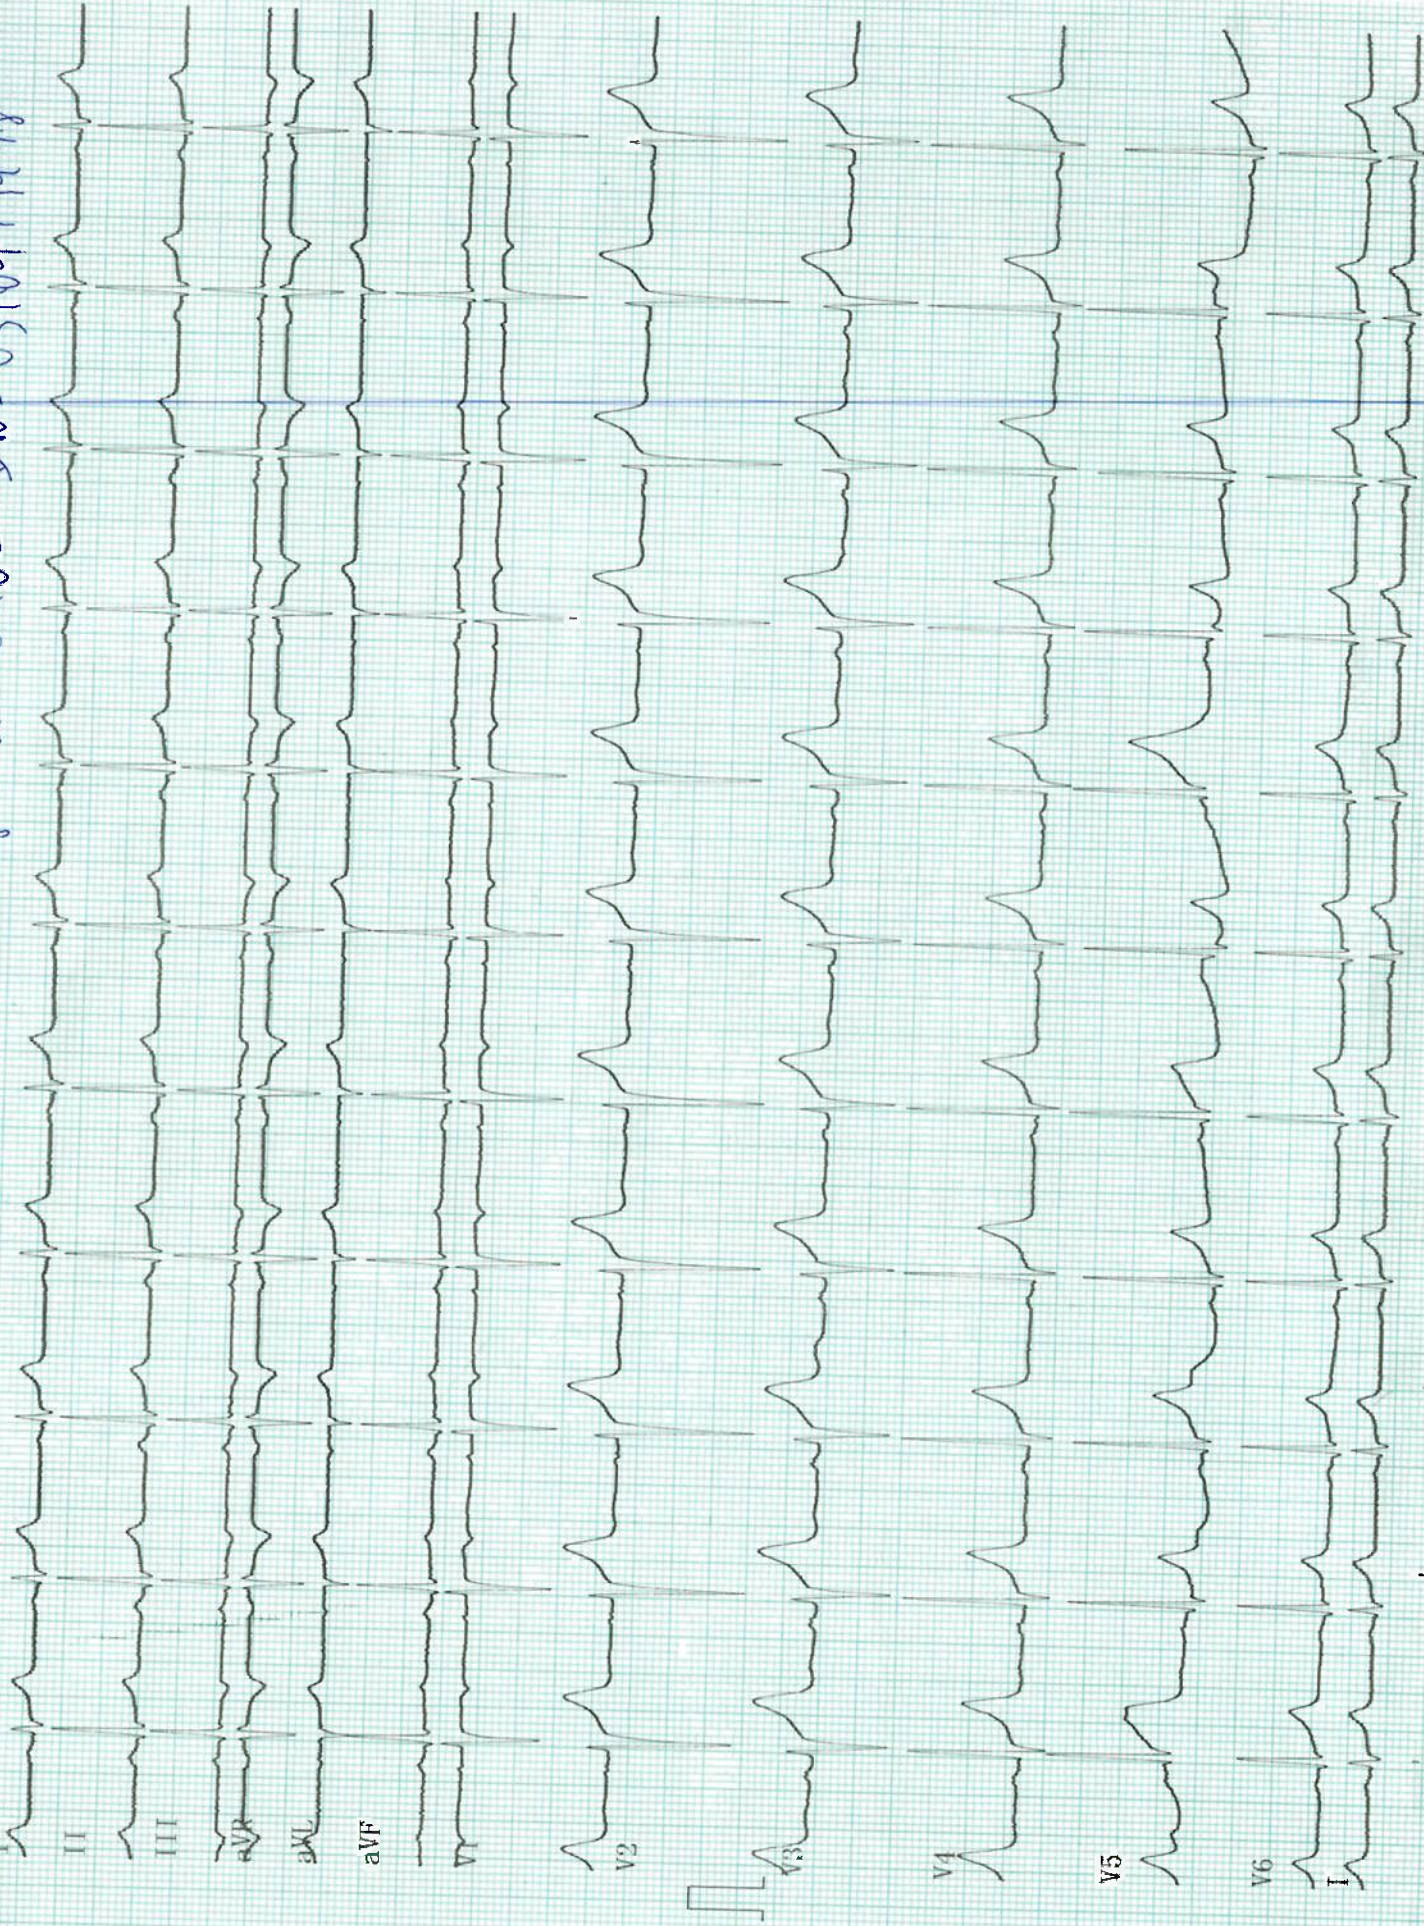

Velocidade: 25mm/s Filtro: H50 d 35Hz AC: 50 Hz BIO CARE ECG-1200 V4.06.000