


2025-07-19 01:22:13
ID:
Nome:

Impressão de 12 Canais

Hospit
Confir

Freq. Cardíaca: 57 bpm

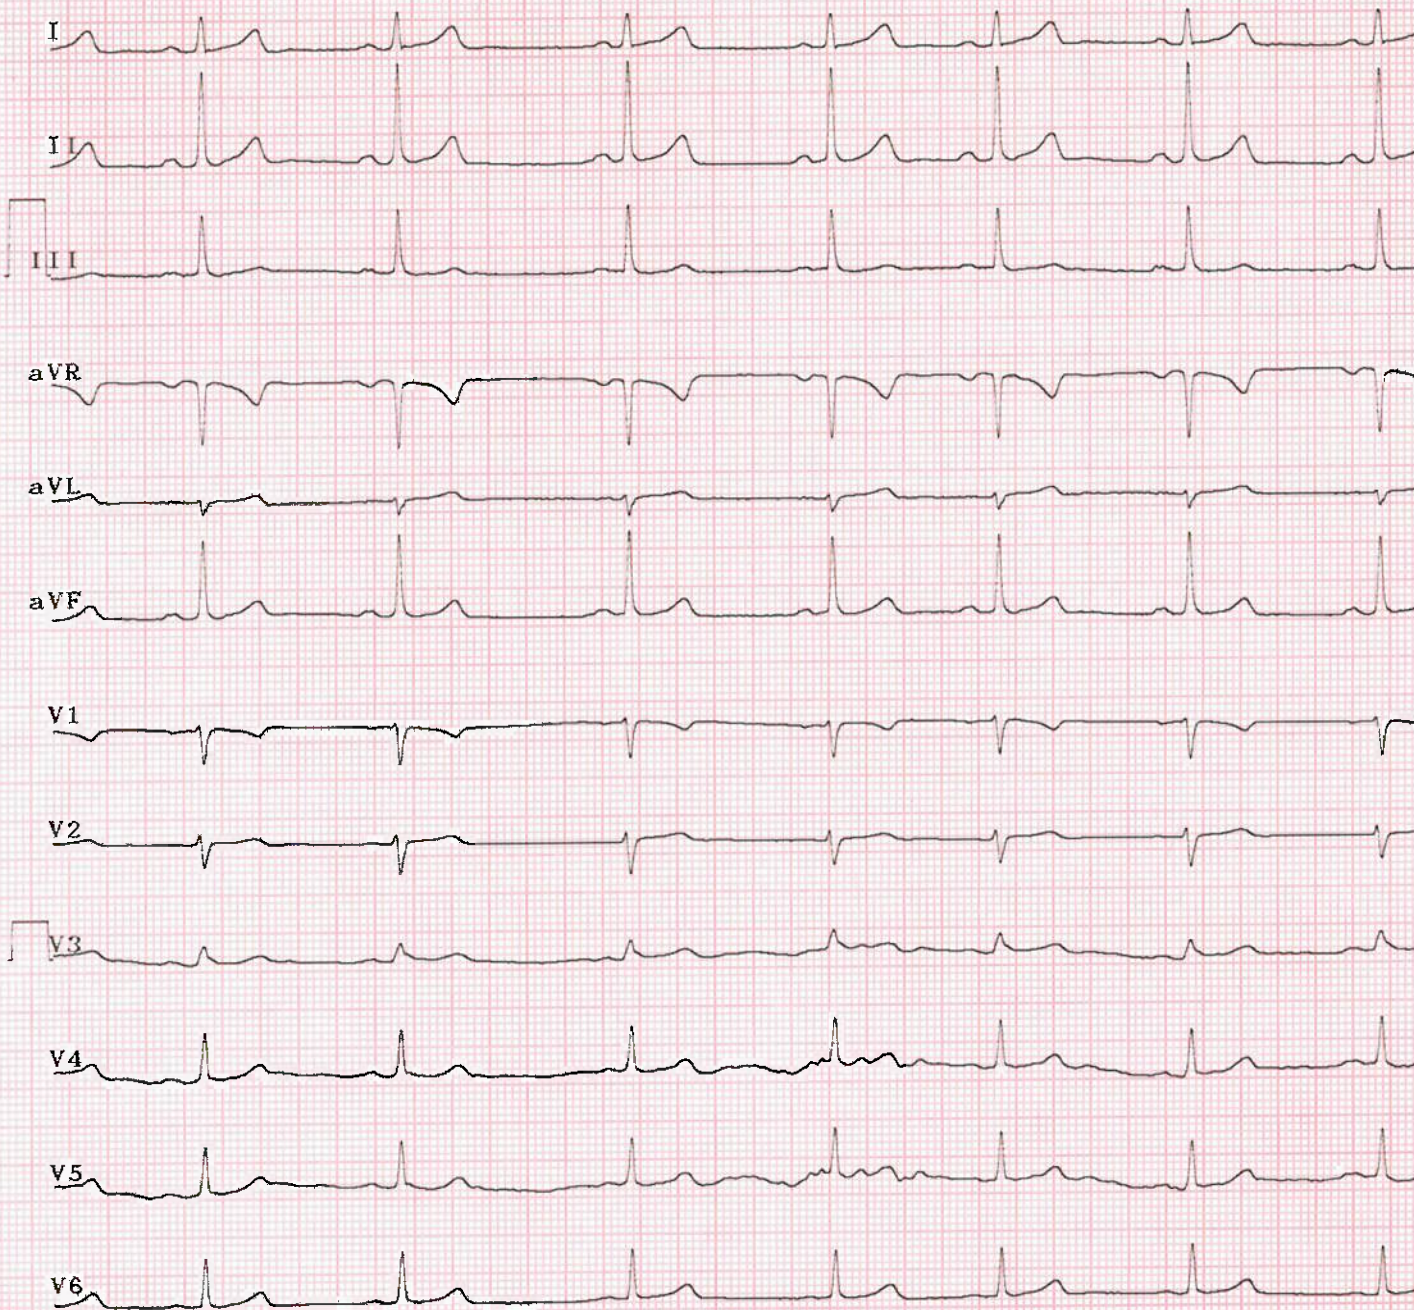

0.1Hz - 40Hz.

I-aVF: 10.0mm/mV, V1-V6: 5.0mm/mV. 25.0mm/seg.

Cardi

Minella J. S. R. Batista Anderson 24 anos