



**PREFEITURA DE
CAÇADOR**
Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso, Caçador - SC, 89503-079

Fone: (49) 3561-0904 / (49) 3561-0900

Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

1 - Dados do Exame

Nº do Exame: BL5-00817	Data de Instalação: 14/07/2025 13:52 Término: 15/07/2025 14:00 Protocolo de Medições: Padrão	Código: BL5-00817
----------------------------------	--	------------------------------------

2 - Paciente

Nome: JANDIRA APARECIDA FERNANDES Sexo: F Fumante: Não	Altura: 145 Tel:	Peso: 54 Nascimento: 13/03/1965 Fax:
Diagnóstico:		
Motivo do Exame:		

3 - Médico Solicitante

Nome: DANIEL CALHEIROS BATISTA Clínica:	Tel: Fax:
--	----------------------------

4 - Laudo Médico

5 - Data e Assinatura

15/07/2025	DANIEL CALHEIROS BATISTA C.R.M.: 26357
-------------------	--



Tabela das Medições

Nº do Exame: BL5-00817	Paciente: JANDIRA APARECIDA FERNANDES Data de Instalação: 14/07/2025 13:52:28	Código: BL5-00817
---	--	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	13:53	183	119	148	64	90	Medição manual	48	06:00	156	95	123	61	68	
2	15:00	162	105	131	57	90		49	06:30	144	92	116	52	72	
3	15:15	155	96	123	59	80		50	07:00	135	99	115	36	70	
4	15:30	166	94	127	72	76		51	07:15	140	98	117	42	65	
5	15:45	141	93	115	48	76		52	07:30	151	89	117	62	64	
6	16:00	152	113	131	39	82		53	07:45	138	90	112	48	65	
7	16:15	149	99	122	50	78		54	08:00	141	98	117	43	62	
8	16:30	140	100	119	40	82		55	08:15	133	96	113	37	66	
9	16:45	147	102	123	45	81		56	08:30	136	92	112	44	68	
10	17:03	148	106	125	42	79		57	08:45	142	95	116	47	69	
11	17:15	143	84	111	59	74		58	09:00	143	99	119	44	68	
12	17:30	144	91	116	53	73		59	09:15	149	103	124	46	65	
13	17:45	131	91	110	40	73		60	09:30	147	98	121	49	63	
14	18:00	106	85	95	21	77		61	09:45	164	95	127	69	63	
15	18:18	177	95	133	82	78		62	10:00	151	98	122	53	65	
16	18:30	146	99	121	47	72		63	10:15	143	90	114	53	67	
17	18:45	149	104	125	45	81		64	10:30	149	90	117	59	76	
18	19:00	152	110	129	42	75		65	10:45	150	105	125	45	73	
19	19:15	142	95	117	47	68		66	11:03	178	100	136	78	75	
20	19:30	145	95	118	50	75		67	11:18	163	112	135	51	74	
21	19:45	138	103	119	35	77		68	11:30	159	103	129	56	78	
22	20:00	147	113	128	34	87		69	12:00	125	54	86	71	104	
23	20:15	153	110	130	43	83		70	12:15	166	105	133	61	100	
24	20:30	168	103	133	65	75		71	12:30	164	115	138	49	90	
25	20:45	162	107	132	55	74		72	12:45	162	105	131	57	92	
26	21:00	154	107	129	47	75		73	13:00	157	94	123	63	95	
27	21:15	153	105	127	48	83		74	13:15	168	37	97	131	94	
28	21:30	193	117	151	76	88		75	13:30	167	93	127	74	97	
29	21:45	158	114	134	44	80		76	13:45	168	112	137	56	86	
30	22:00	156	98	124	58	79		77	14:00						Aparelho desligado manualmente
31	22:15	154	95	122	59	78									
32	22:30	158	102	128	56	78									
33	22:48	175	107	138	68	90									
34	23:00	170	107	136	63	78									
35	23:30	165	105	133	60	75									
36	00:00	153	110	130	43	75									
37	00:30	154	104	127	50	72									
38	01:00	159	105	130	54	70									
39	01:30	156	109	131	47	70									
40	02:00	154	110	130	44	68									
41	02:30	145	94	117	51	69									
42	03:00	144	85	112	59	67									
43	03:30	159	104	129	55	65									
44	04:00	142	95	117	47	70									
45	04:30	154	94	121	60	74									
46	05:00	155	100	125	55	68									
47	05:30	139	81	107	58	68									



Análise Estatística

Nº do Exame: BL5-00817	Paciente: JANDIRA APARECIDA FERNANDES Data de Instalação: 14/07/2025 13:52:28	Código: BL5-00817
---	--	------------------------------------

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	81	
Medições Válidas:	76 = 94%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	152 / 99 mmHg	menor que 125 / 75 mmHg
Período da Vigília:	152 / 99 mmHg	menor que 130 / 85 mmHg
Período do Sono:	153 / 99 mmHg	menor que 110 / 70 mmHg
Descenso Noturno:	-1% / -1%	entre 10% e 20% / 10% e 20%
3 - Valores Máximos		Comentários
Período da Vigília:		Medição manual
PAS:	193 mmHg às 21:30 h	
PAD:	119 mmHg às 13:53 h	
PAM:	151 mmHg às 21:30 h	
PP:	131 mmHg às 13:15 h	
Período do Sono:		
PAS:	170 mmHg às 23:00 h	
PAD:	110 mmHg às 00:00 h	
PAM:	136 mmHg às 23:00 h	
PP:	63 mmHg às 23:00 h	
4 - Valores Mínimos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	106 mmHg às 18:00 h	
PAD:	37 mmHg às 13:15 h	
PAM:	86 mmHg às 12:00 h	
PP:	21 mmHg às 18:00 h	
Período do Sono:		
PAS:	139 mmHg às 05:30 h	
PAD:	81 mmHg às 05:30 h	
PAM:	107 mmHg às 05:30 h	
PP:	43 mmHg às 00:00 h	




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso, Caçador - SC, 89503-079
Fone: (49) 3561-0904 / (49) 3561-0900

Gráfico das Pressões

Nº do Exame: BL5-00817	Paciente: JANDIRA APARECIDA FERNANDES Data de Instalação: 14/07/2025 13:52:28	Código: BL5-00817
---	--	------------------------------------

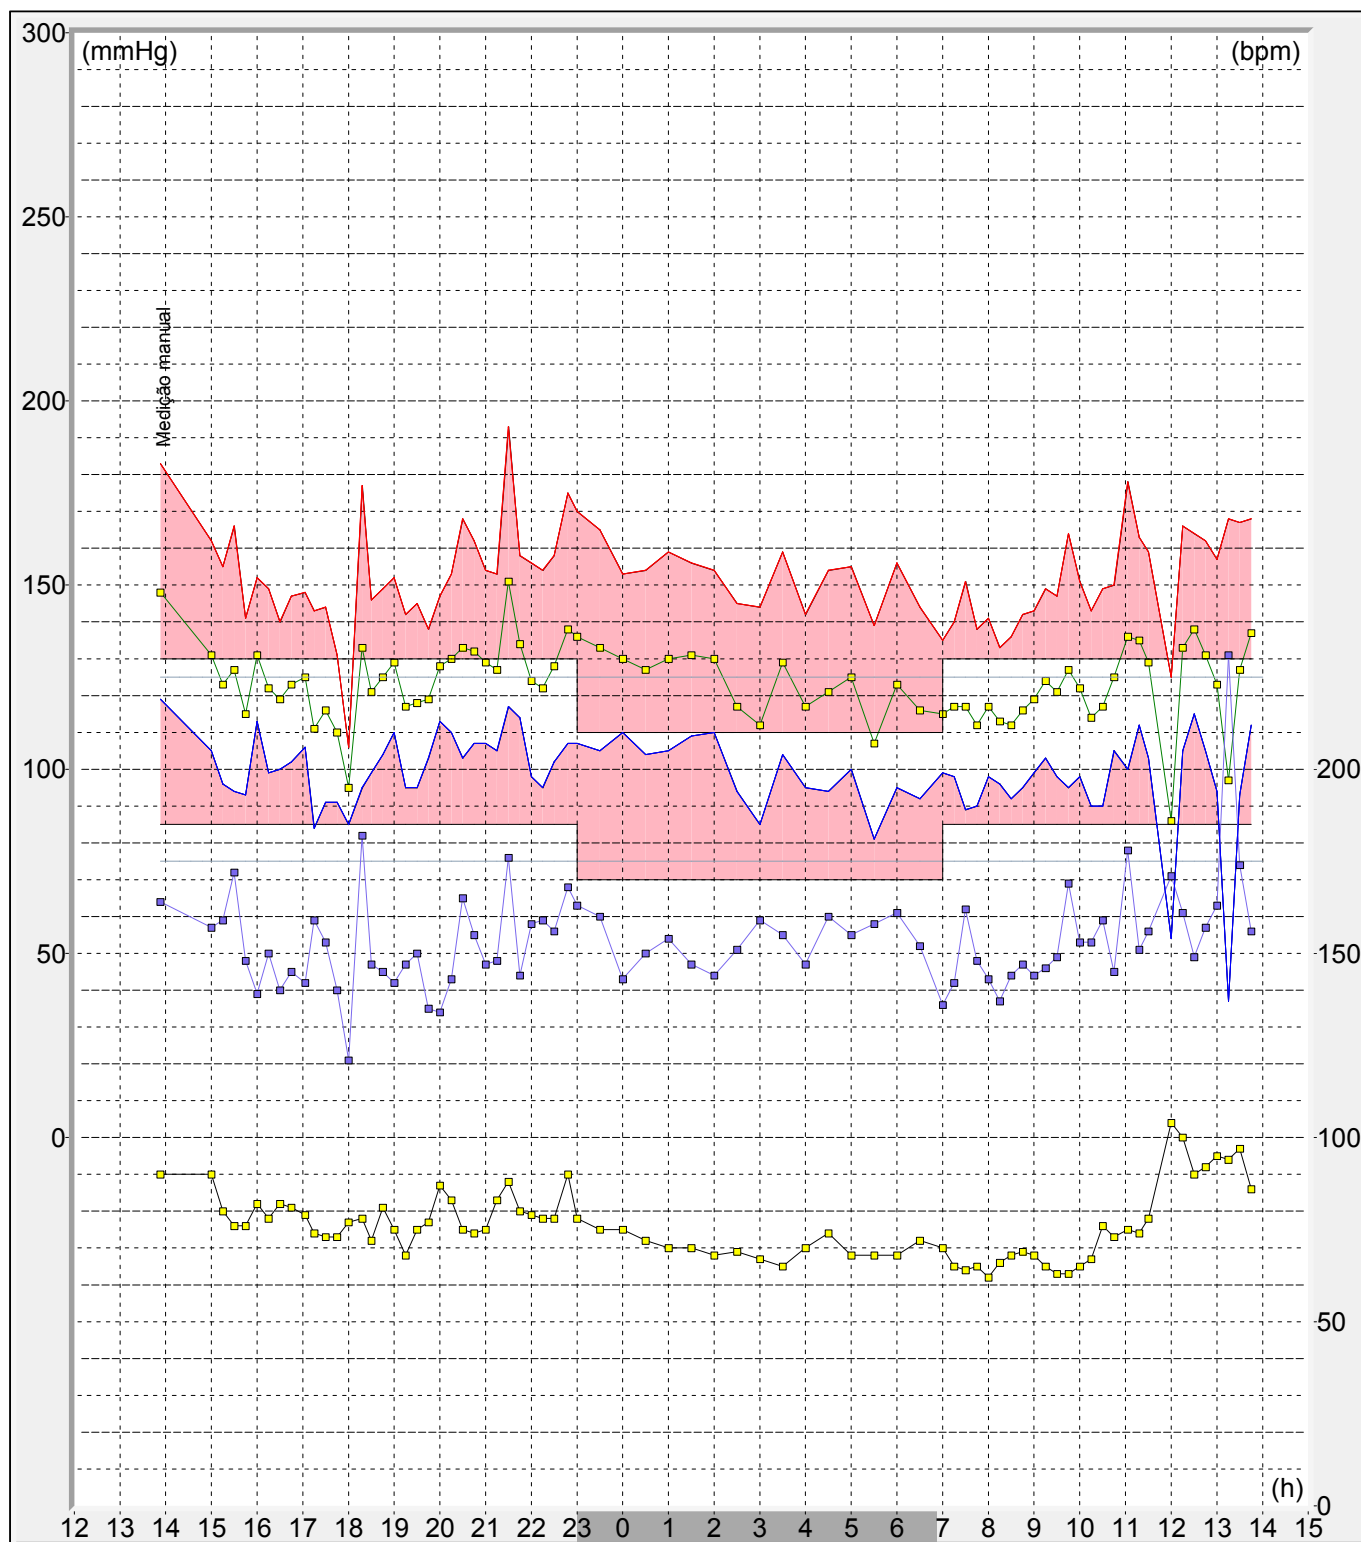



**PREFEITURA DE
CAÇADOR**
Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso, Caçador - SC, 89503-079

Fone: (49) 3561-0904 / (49) 3561-0900

Gráfico de Tendências

Nº do Exame: BL5-00817	Paciente: JANDIRA APARECIDA FERNANDES Data de Instalação: 14/07/2025 13:52:28	Código: BL5-00817
---	--	------------------------------------

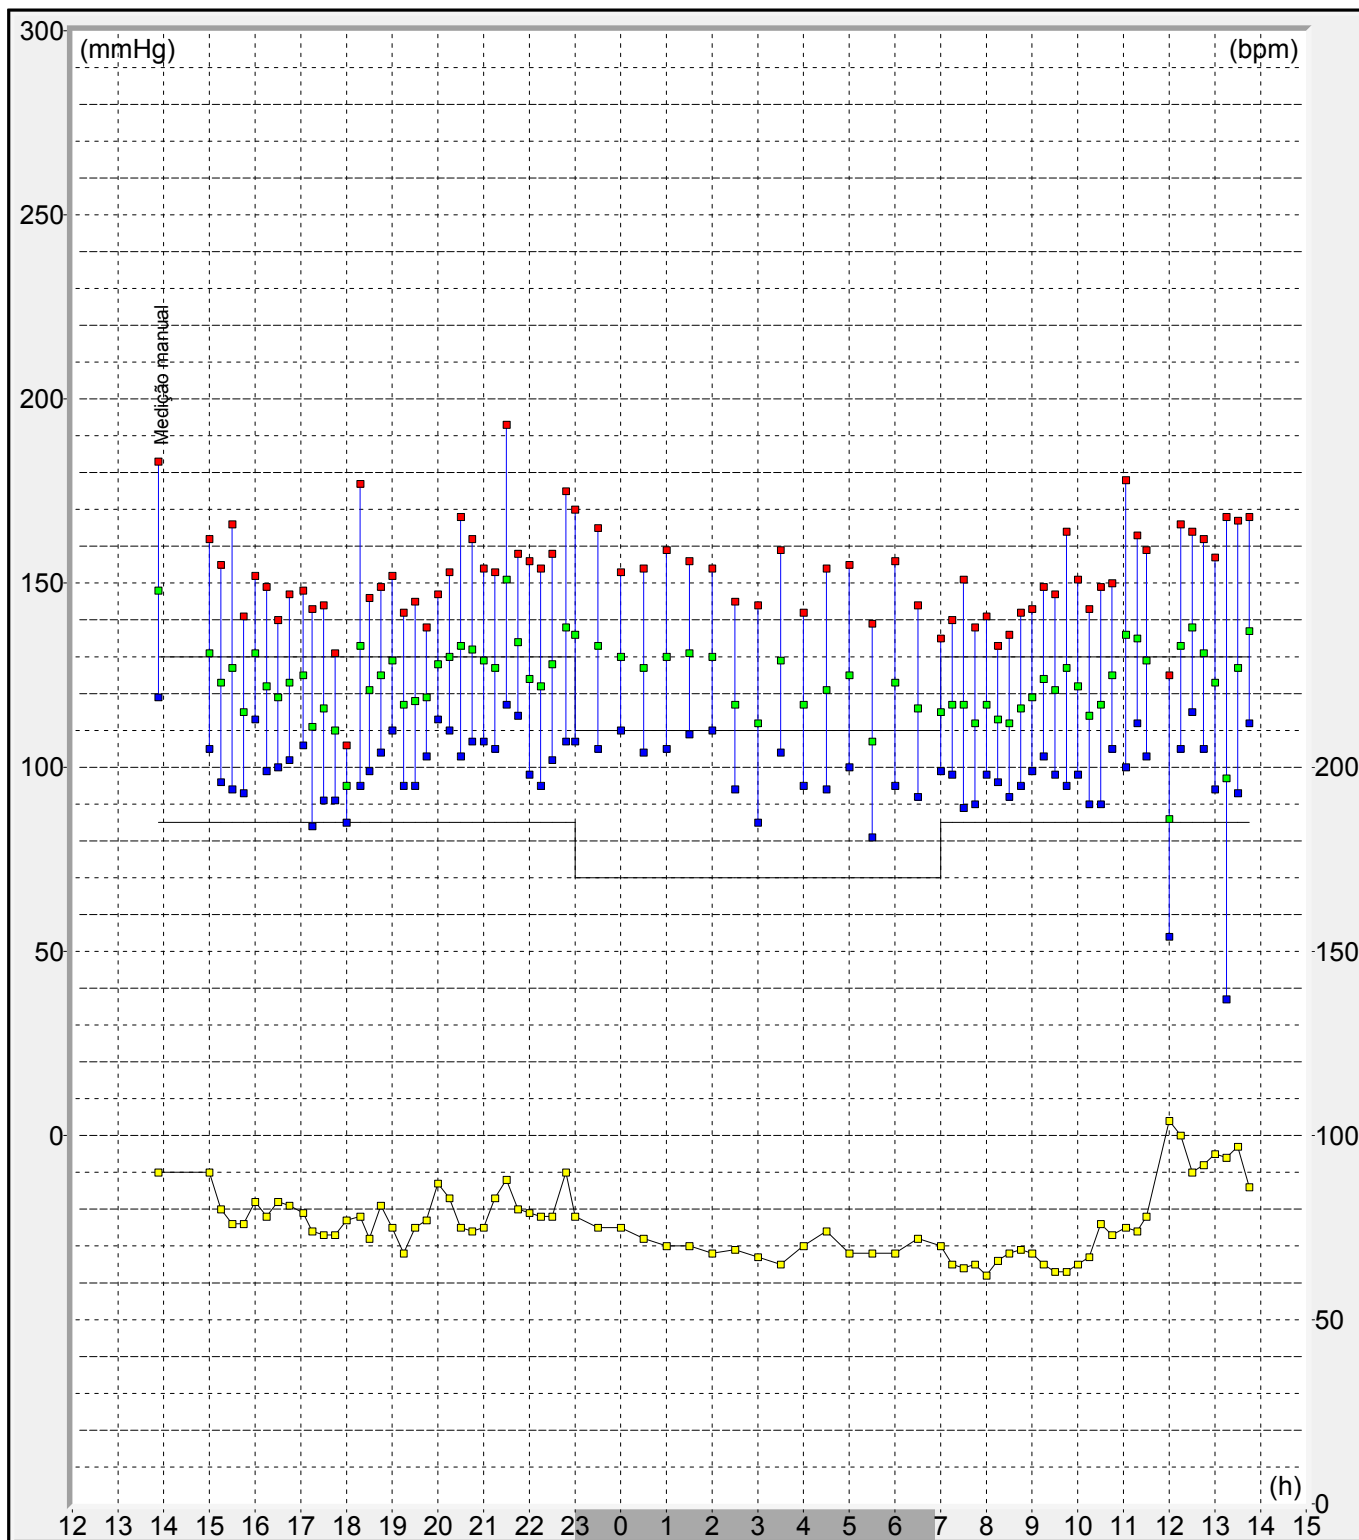



**PREFEITURA DE
CAÇADOR**
Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso, Caçador - SC, 89503-079

Fone: (49) 3561-0904 / (49) 3561-0900

Gráfico de Correlação

Nº do Exame: BL5-00817	Paciente: JANDIRA APARECIDA FERNANDES Data de Instalação: 14/07/2025 13:52:28	Código: BL5-00817
---	--	------------------------------------

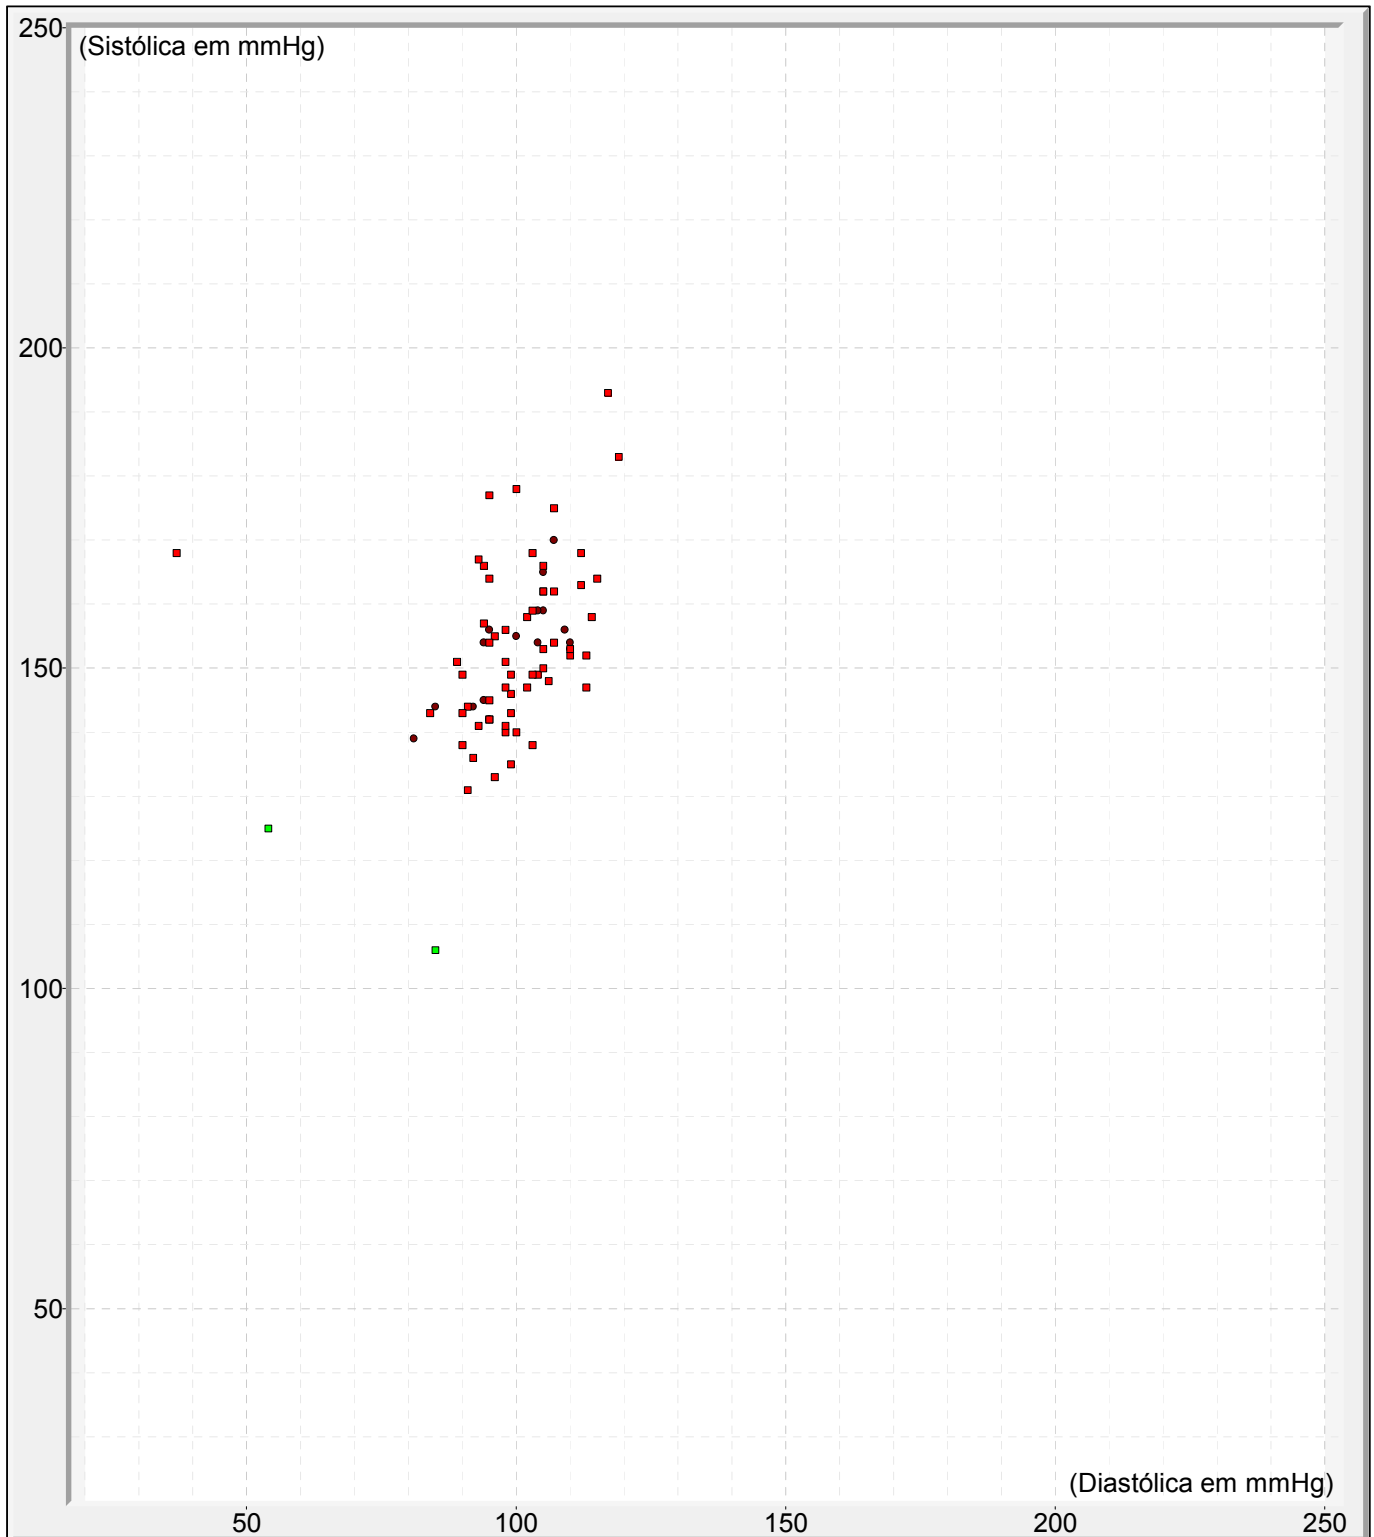

Histogramas

Nº do Exame: BL5-00817	Paciente: JANDIRA APARECIDA FERNANDES Data de Instalação: 14/07/2025 13:52:28	Código: BL5-00817
---	--	------------------------------------

