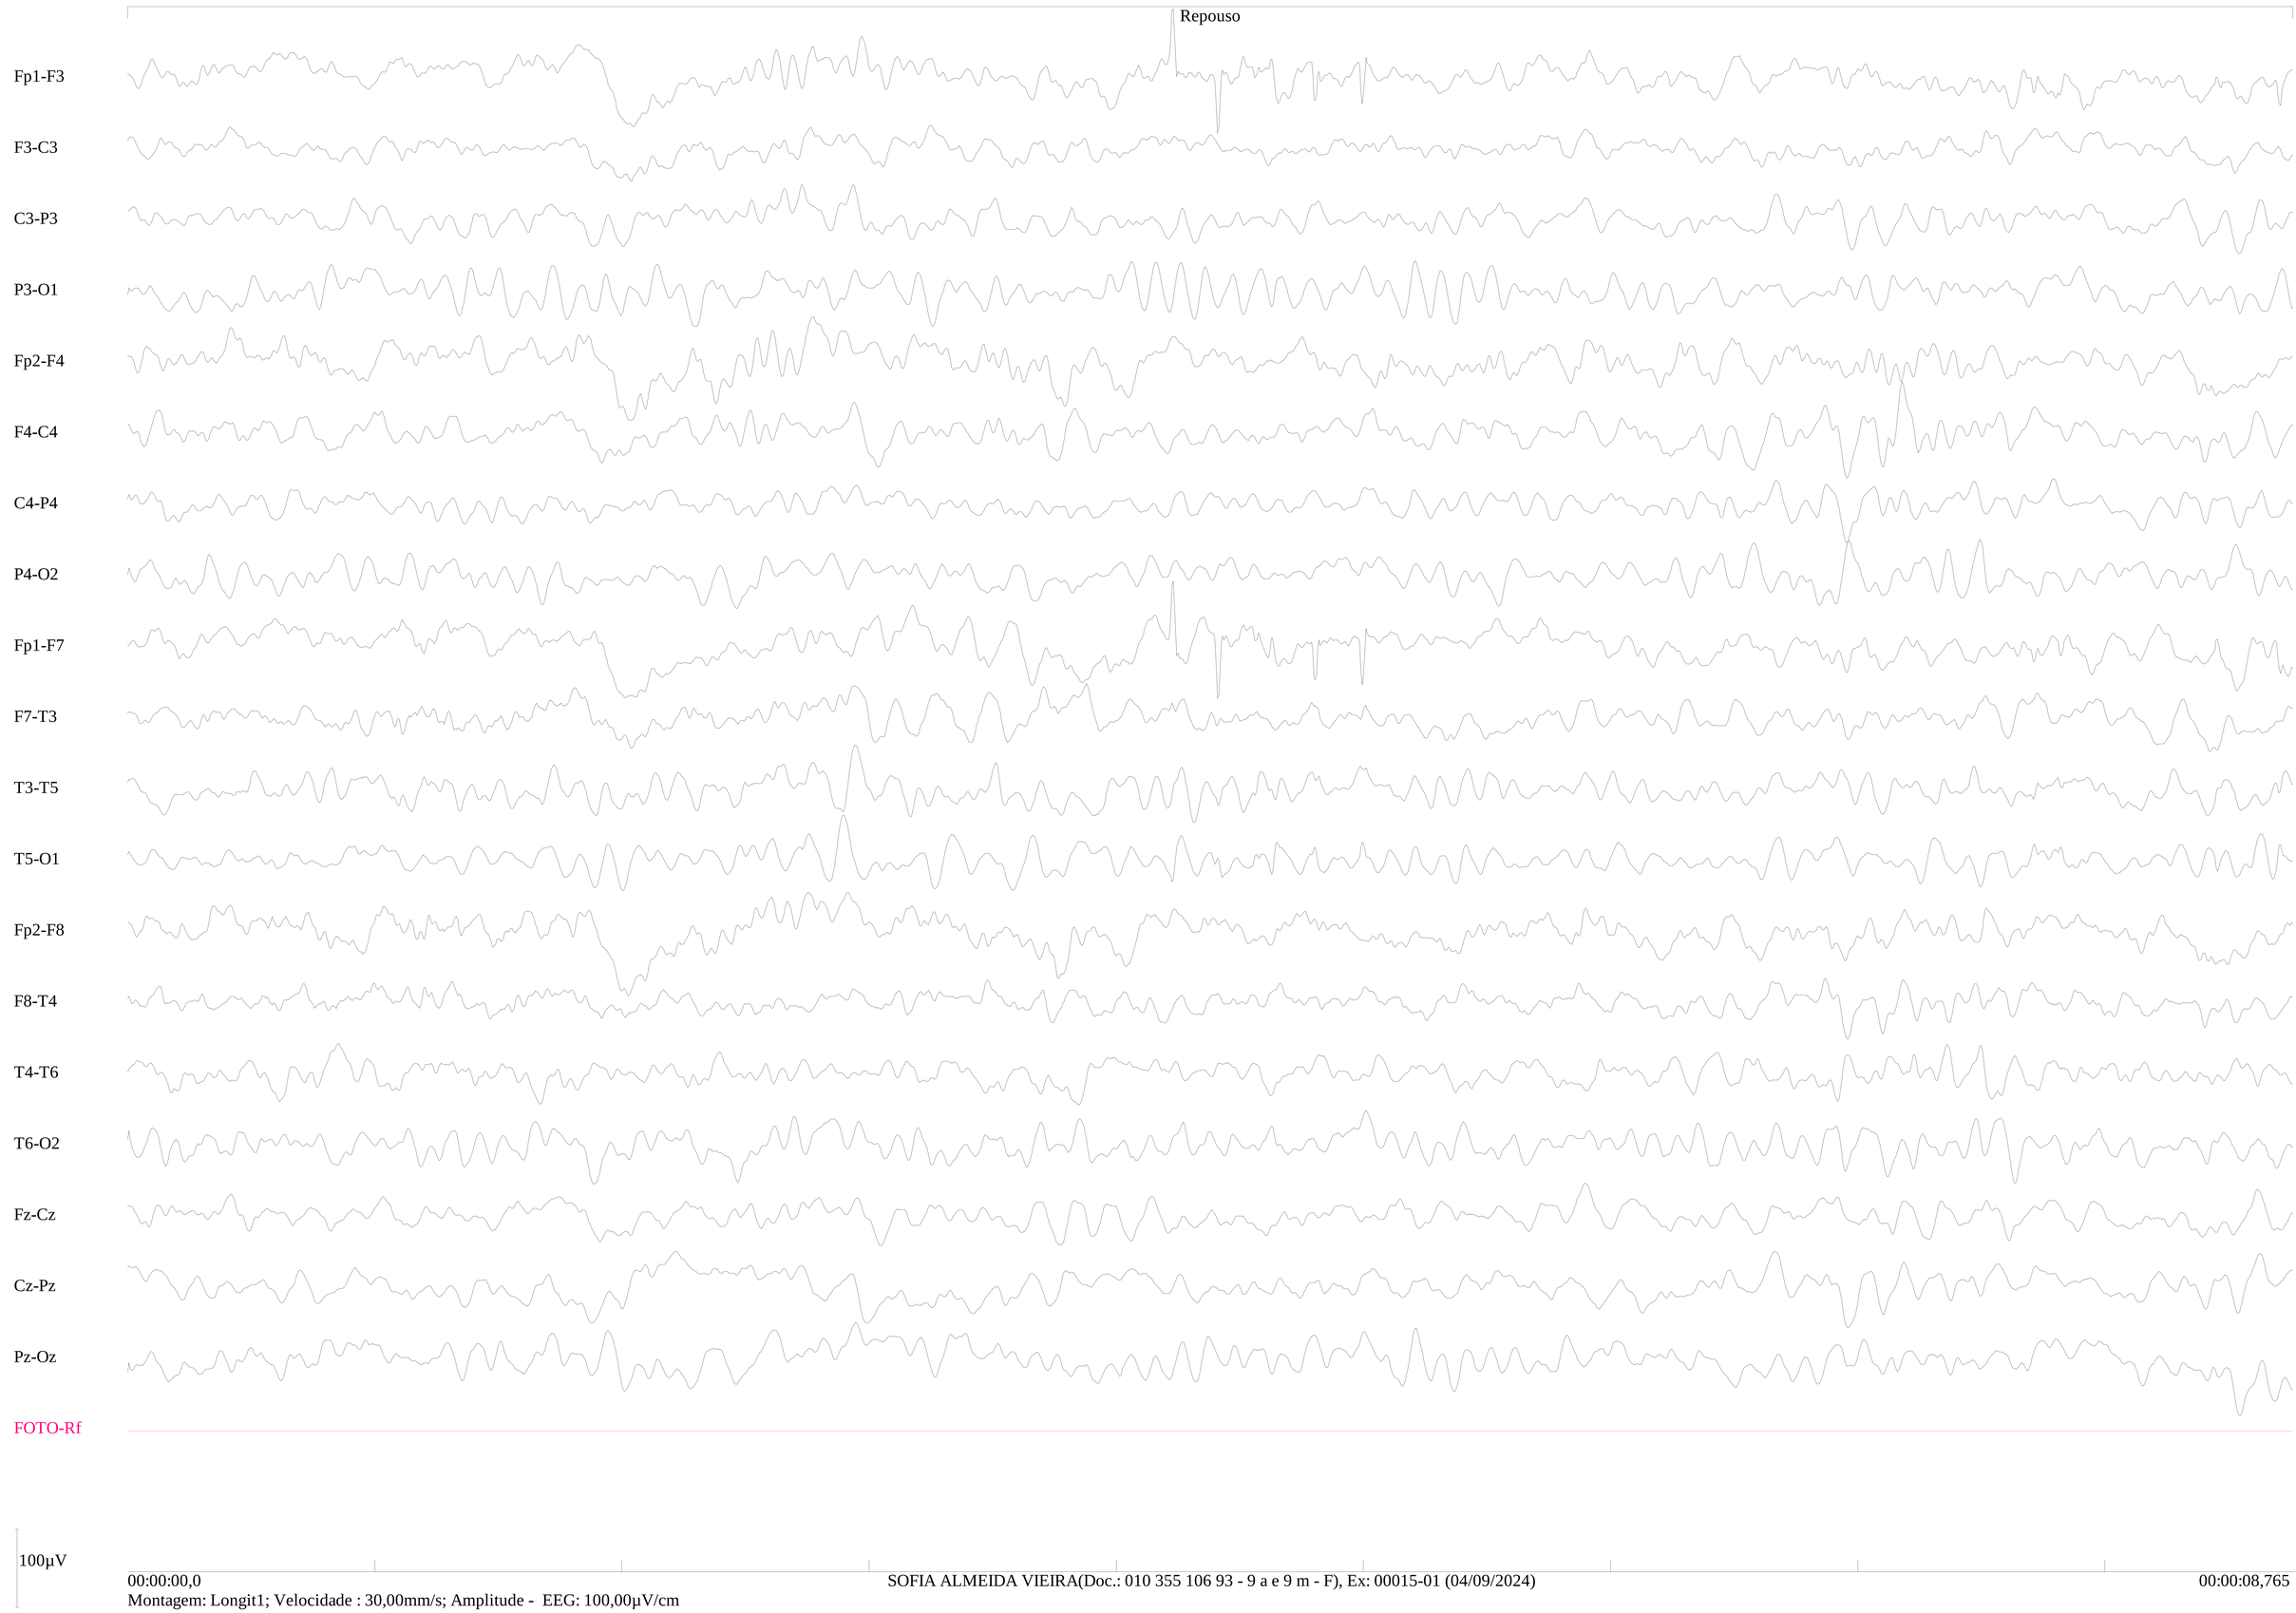
Repouso
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fz-Cz
Cz-Pz
Pz-Oz
FOTO-Rf
100µV
00:00:00,0
SOFIA ALMEIDA VIEIRA(Doc.: 010 355 106 93 - 9 a e 9 m - F), Ex: 00015-01 (04/09/2024)
00:00:08,765
Montagem: Longit1; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

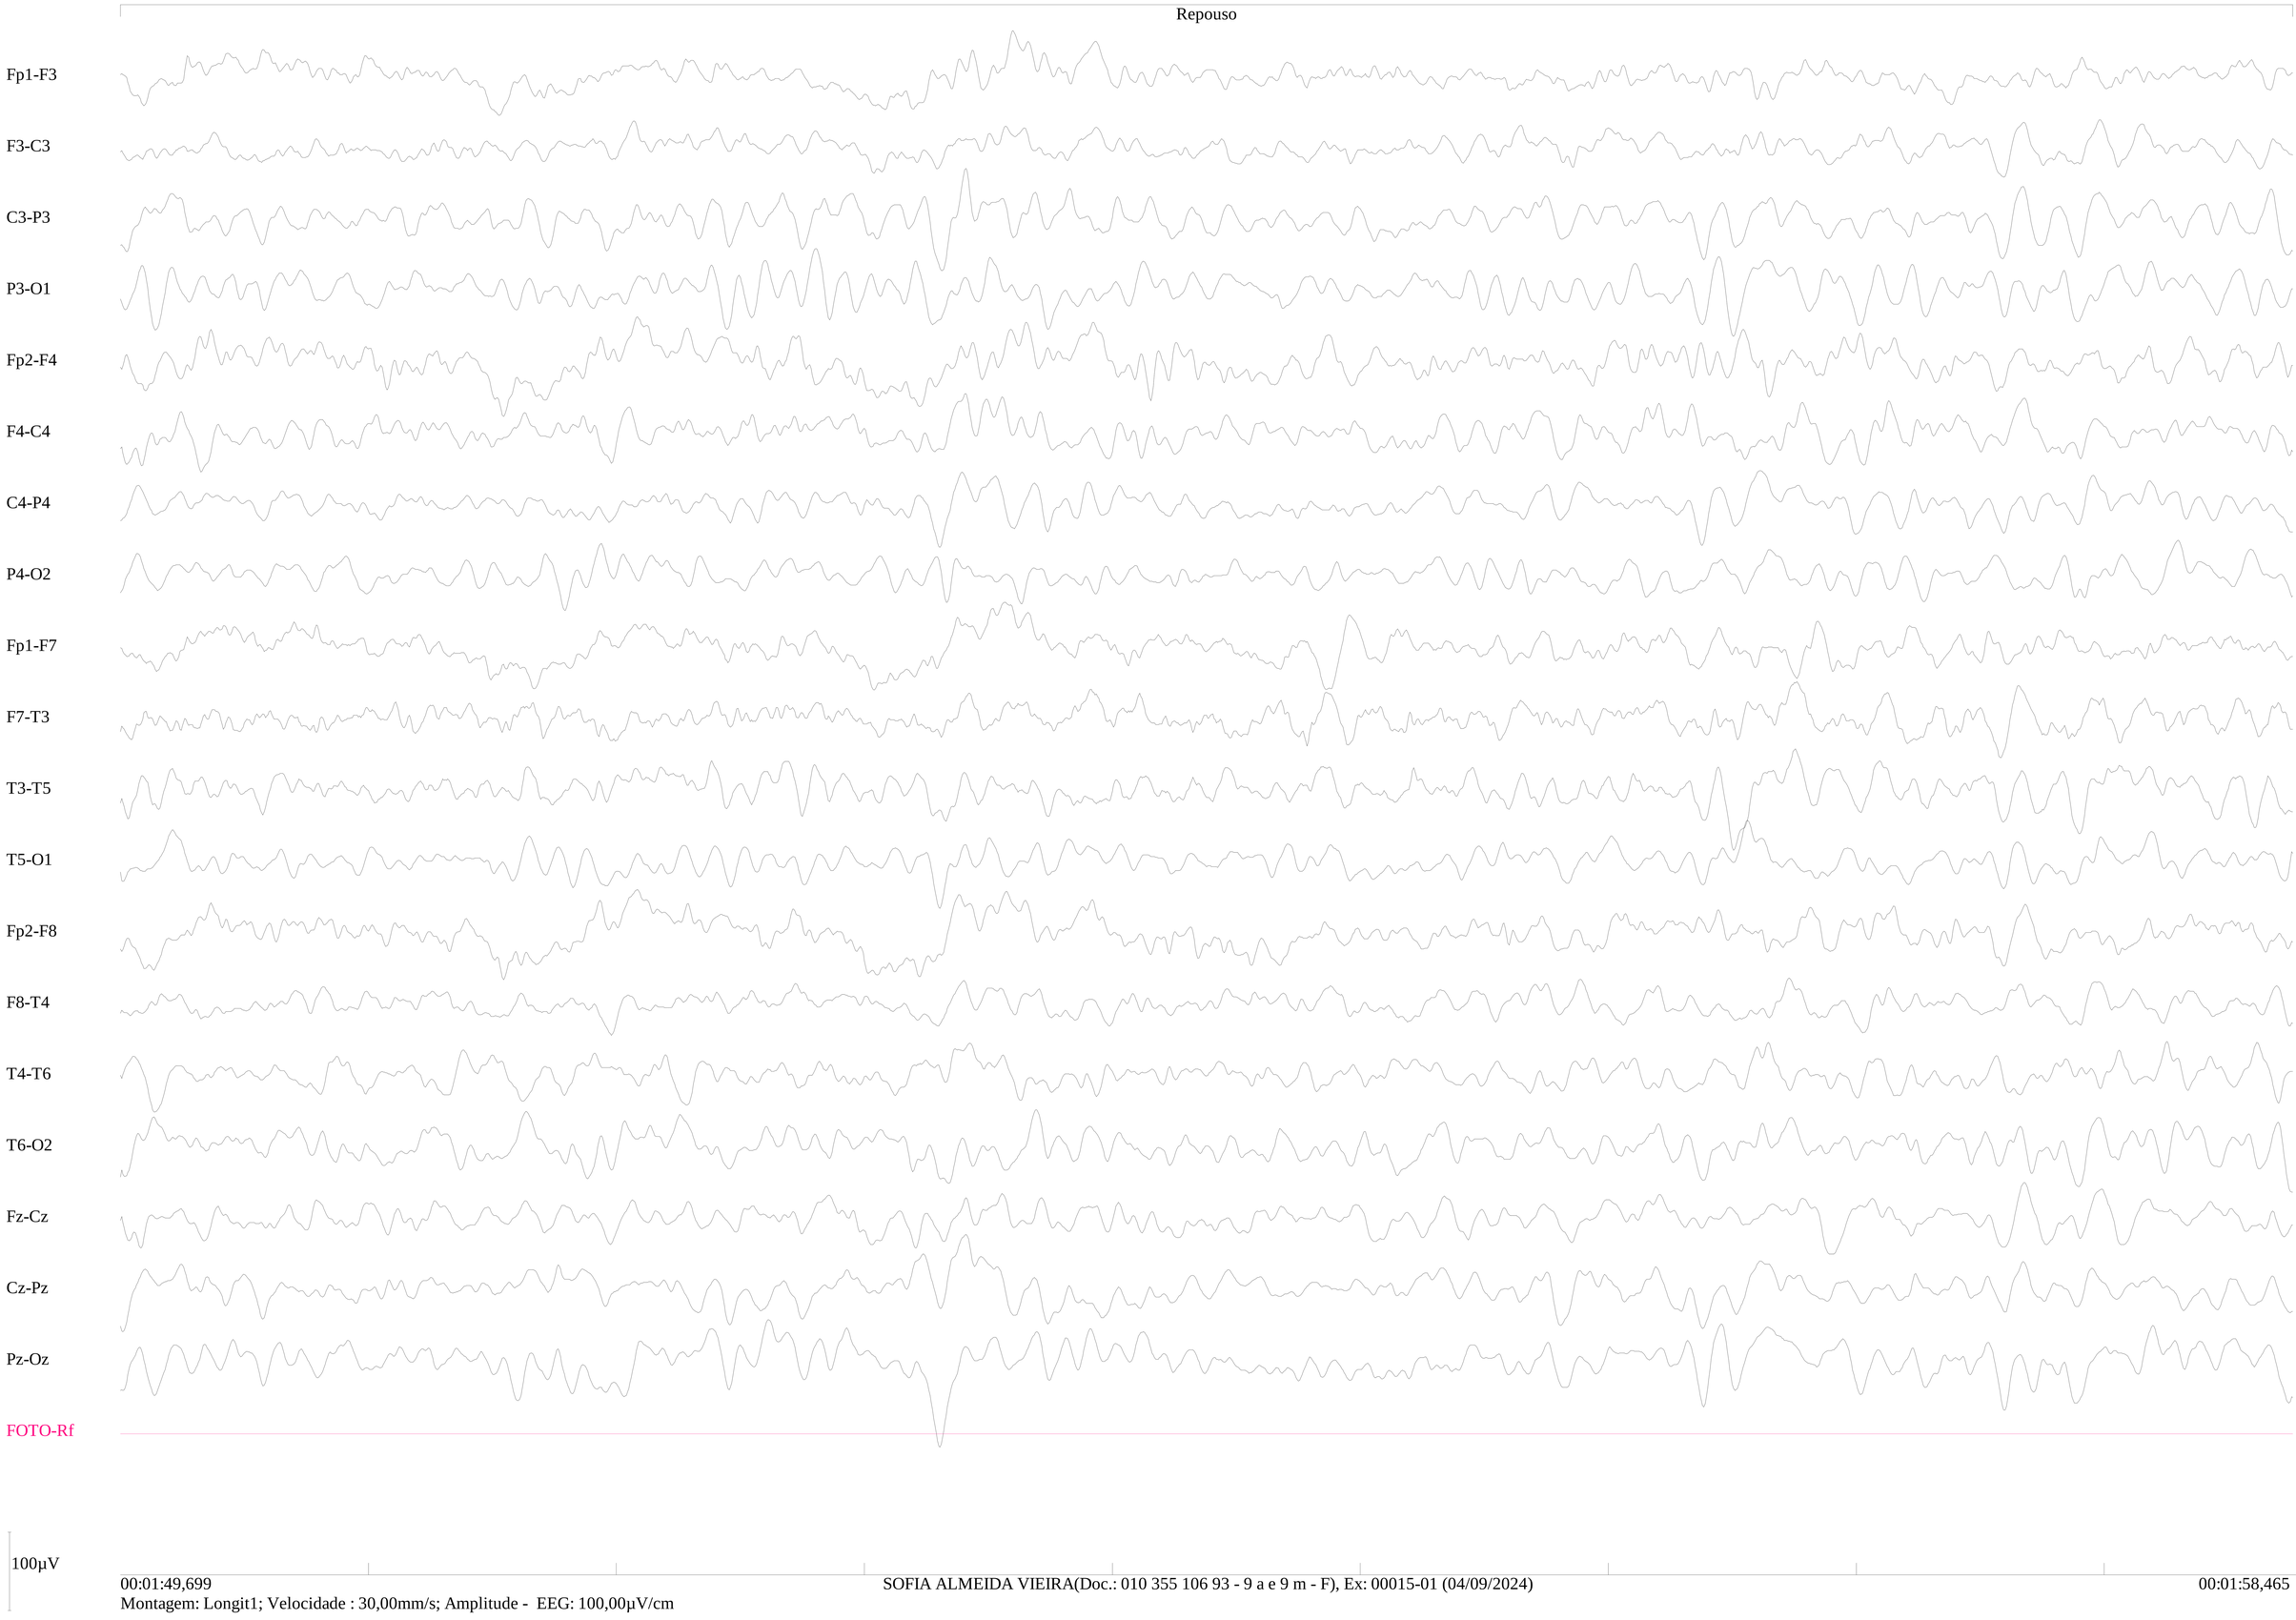
Repouso
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fz-Cz
Cz-Pz
Pz-Oz
FOTO-Rf
100µV
00:01:49,699
SOFIA ALMEIDA VIEIRA(Doc.: 010 355 106 93 - 9 a e 9 m - F), Ex: 00015-01 (04/09/2024)
00:01:58,465
Montagem: Longit1; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

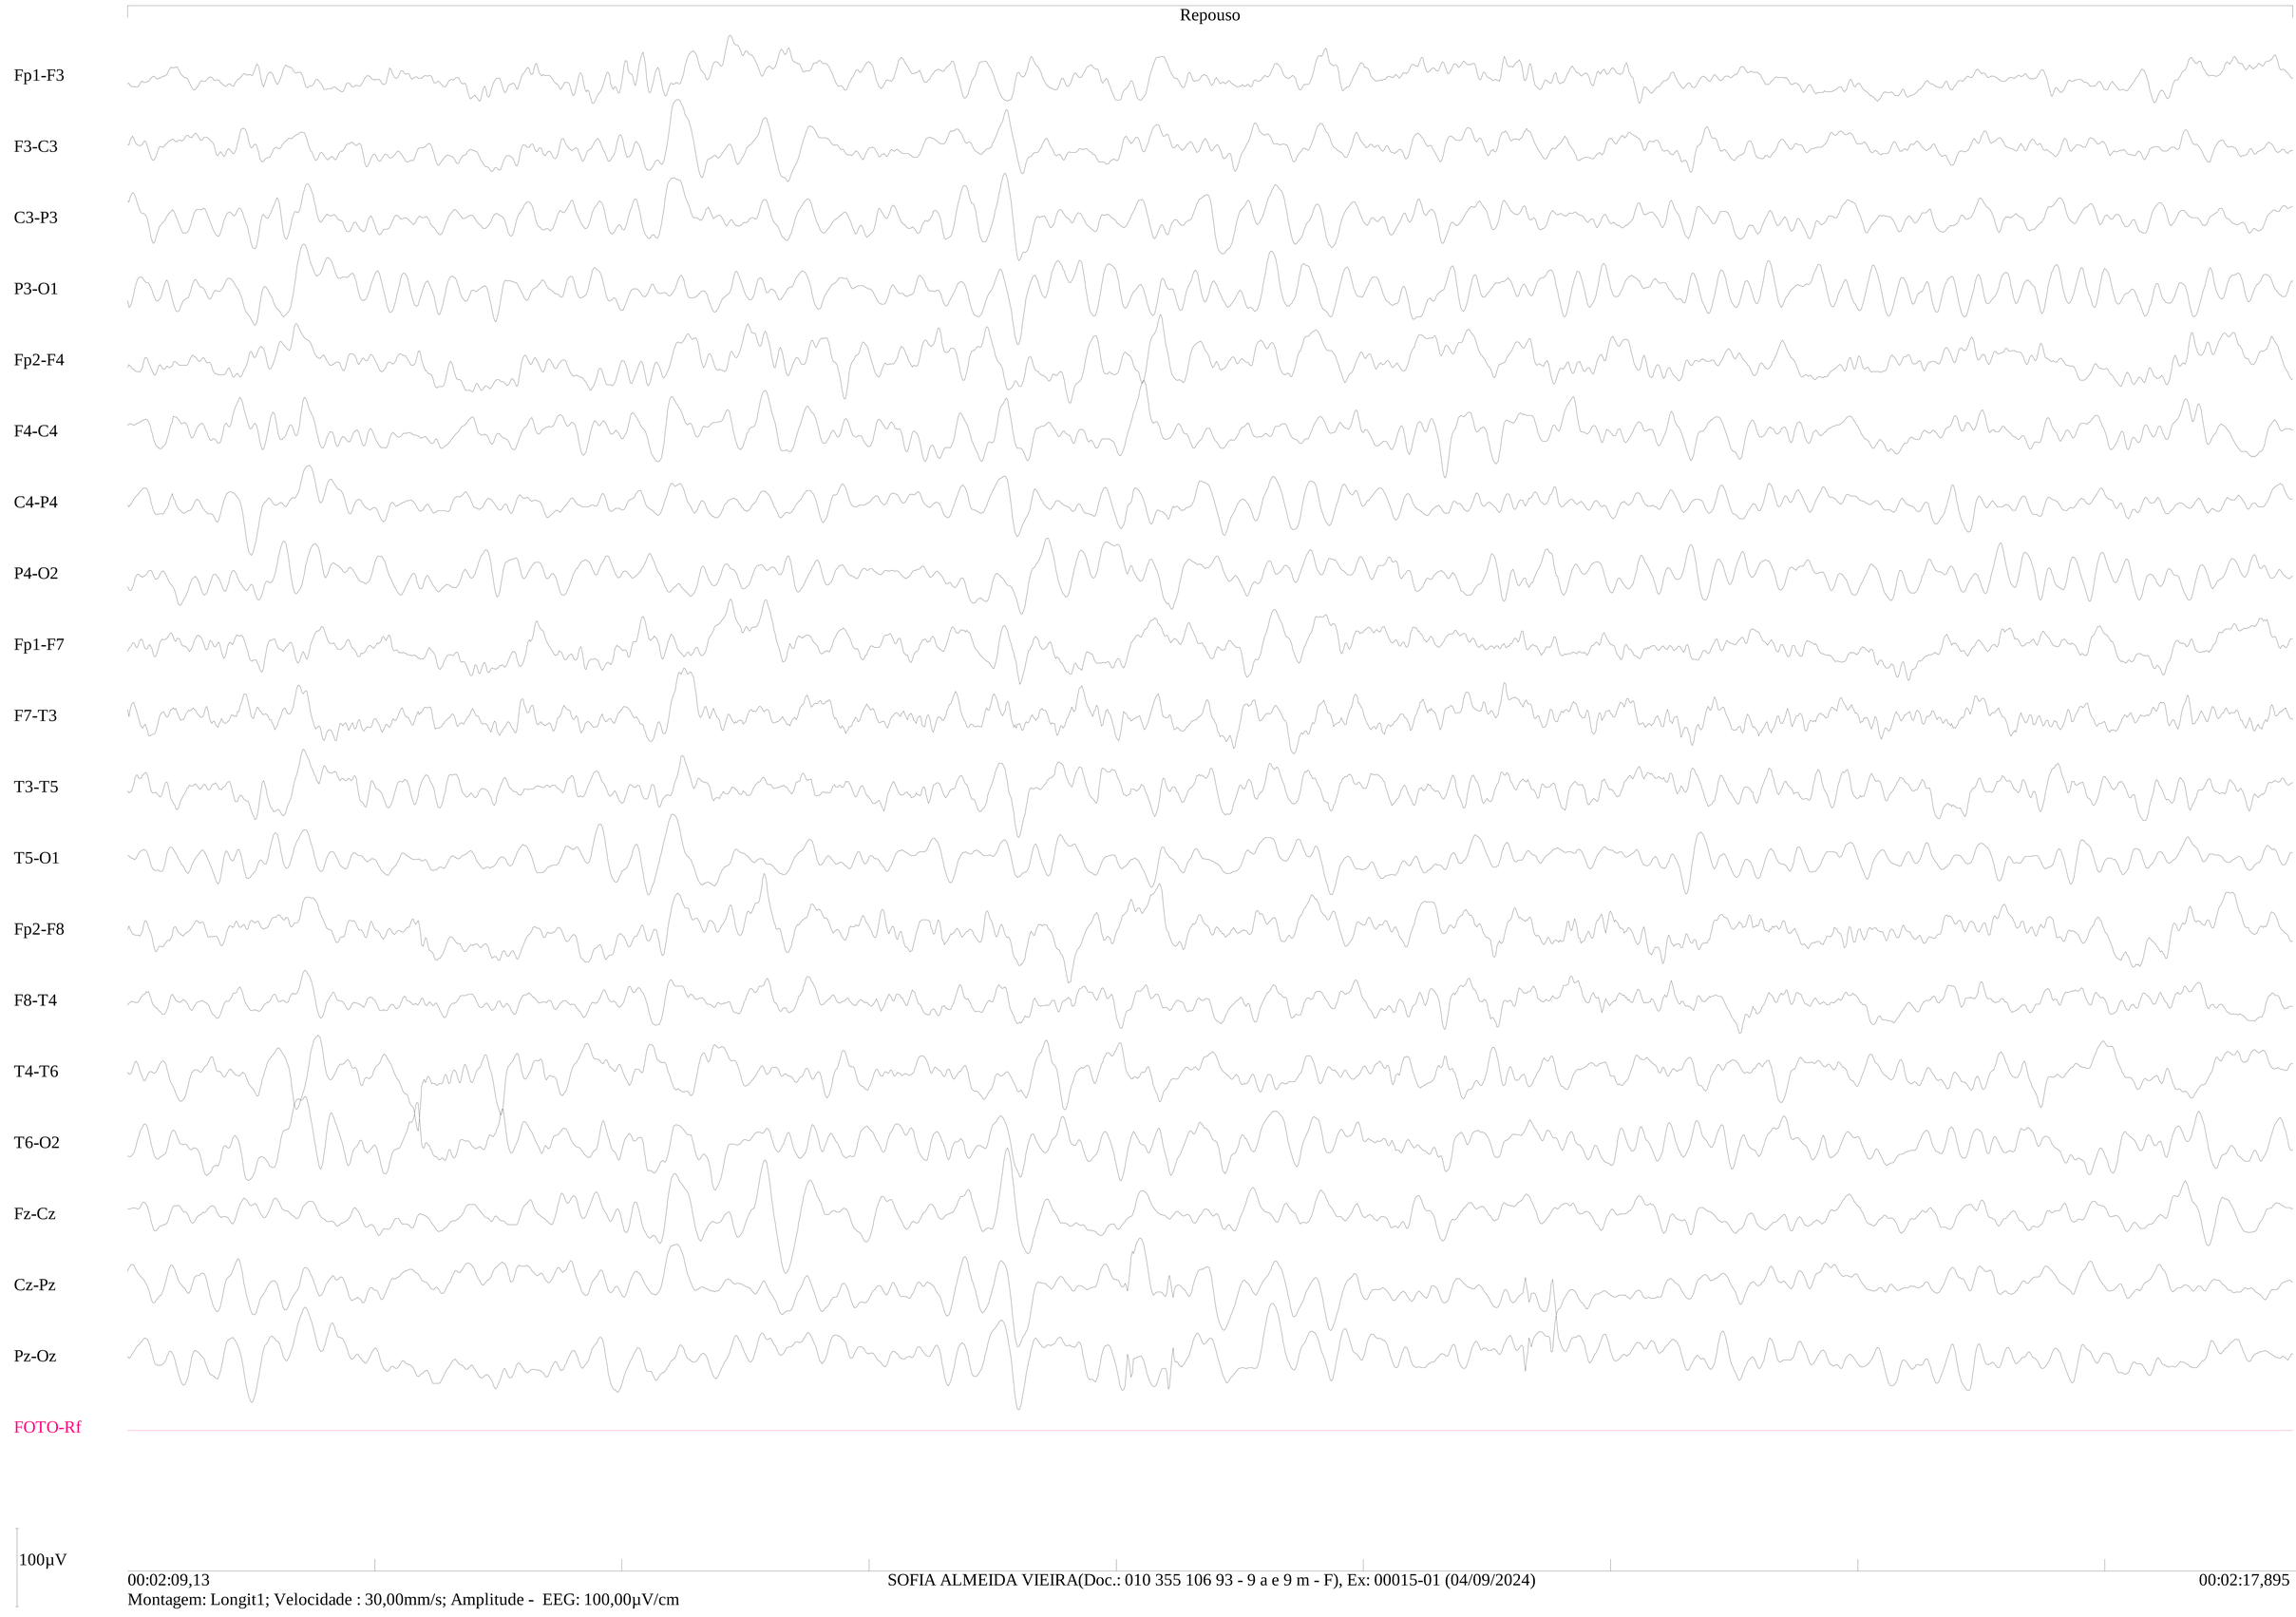
Repouso
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fz-Cz
Cz-Pz
Pz-Oz
FOTO-Rf
100µV
00:02:09,13
SOFIA ALMEIDA VIEIRA(Doc.: 010 355 106 93 - 9 a e 9 m - F), Ex: 00015-01 (04/09/2024)
00:02:17,895
Montagem: Longit1; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

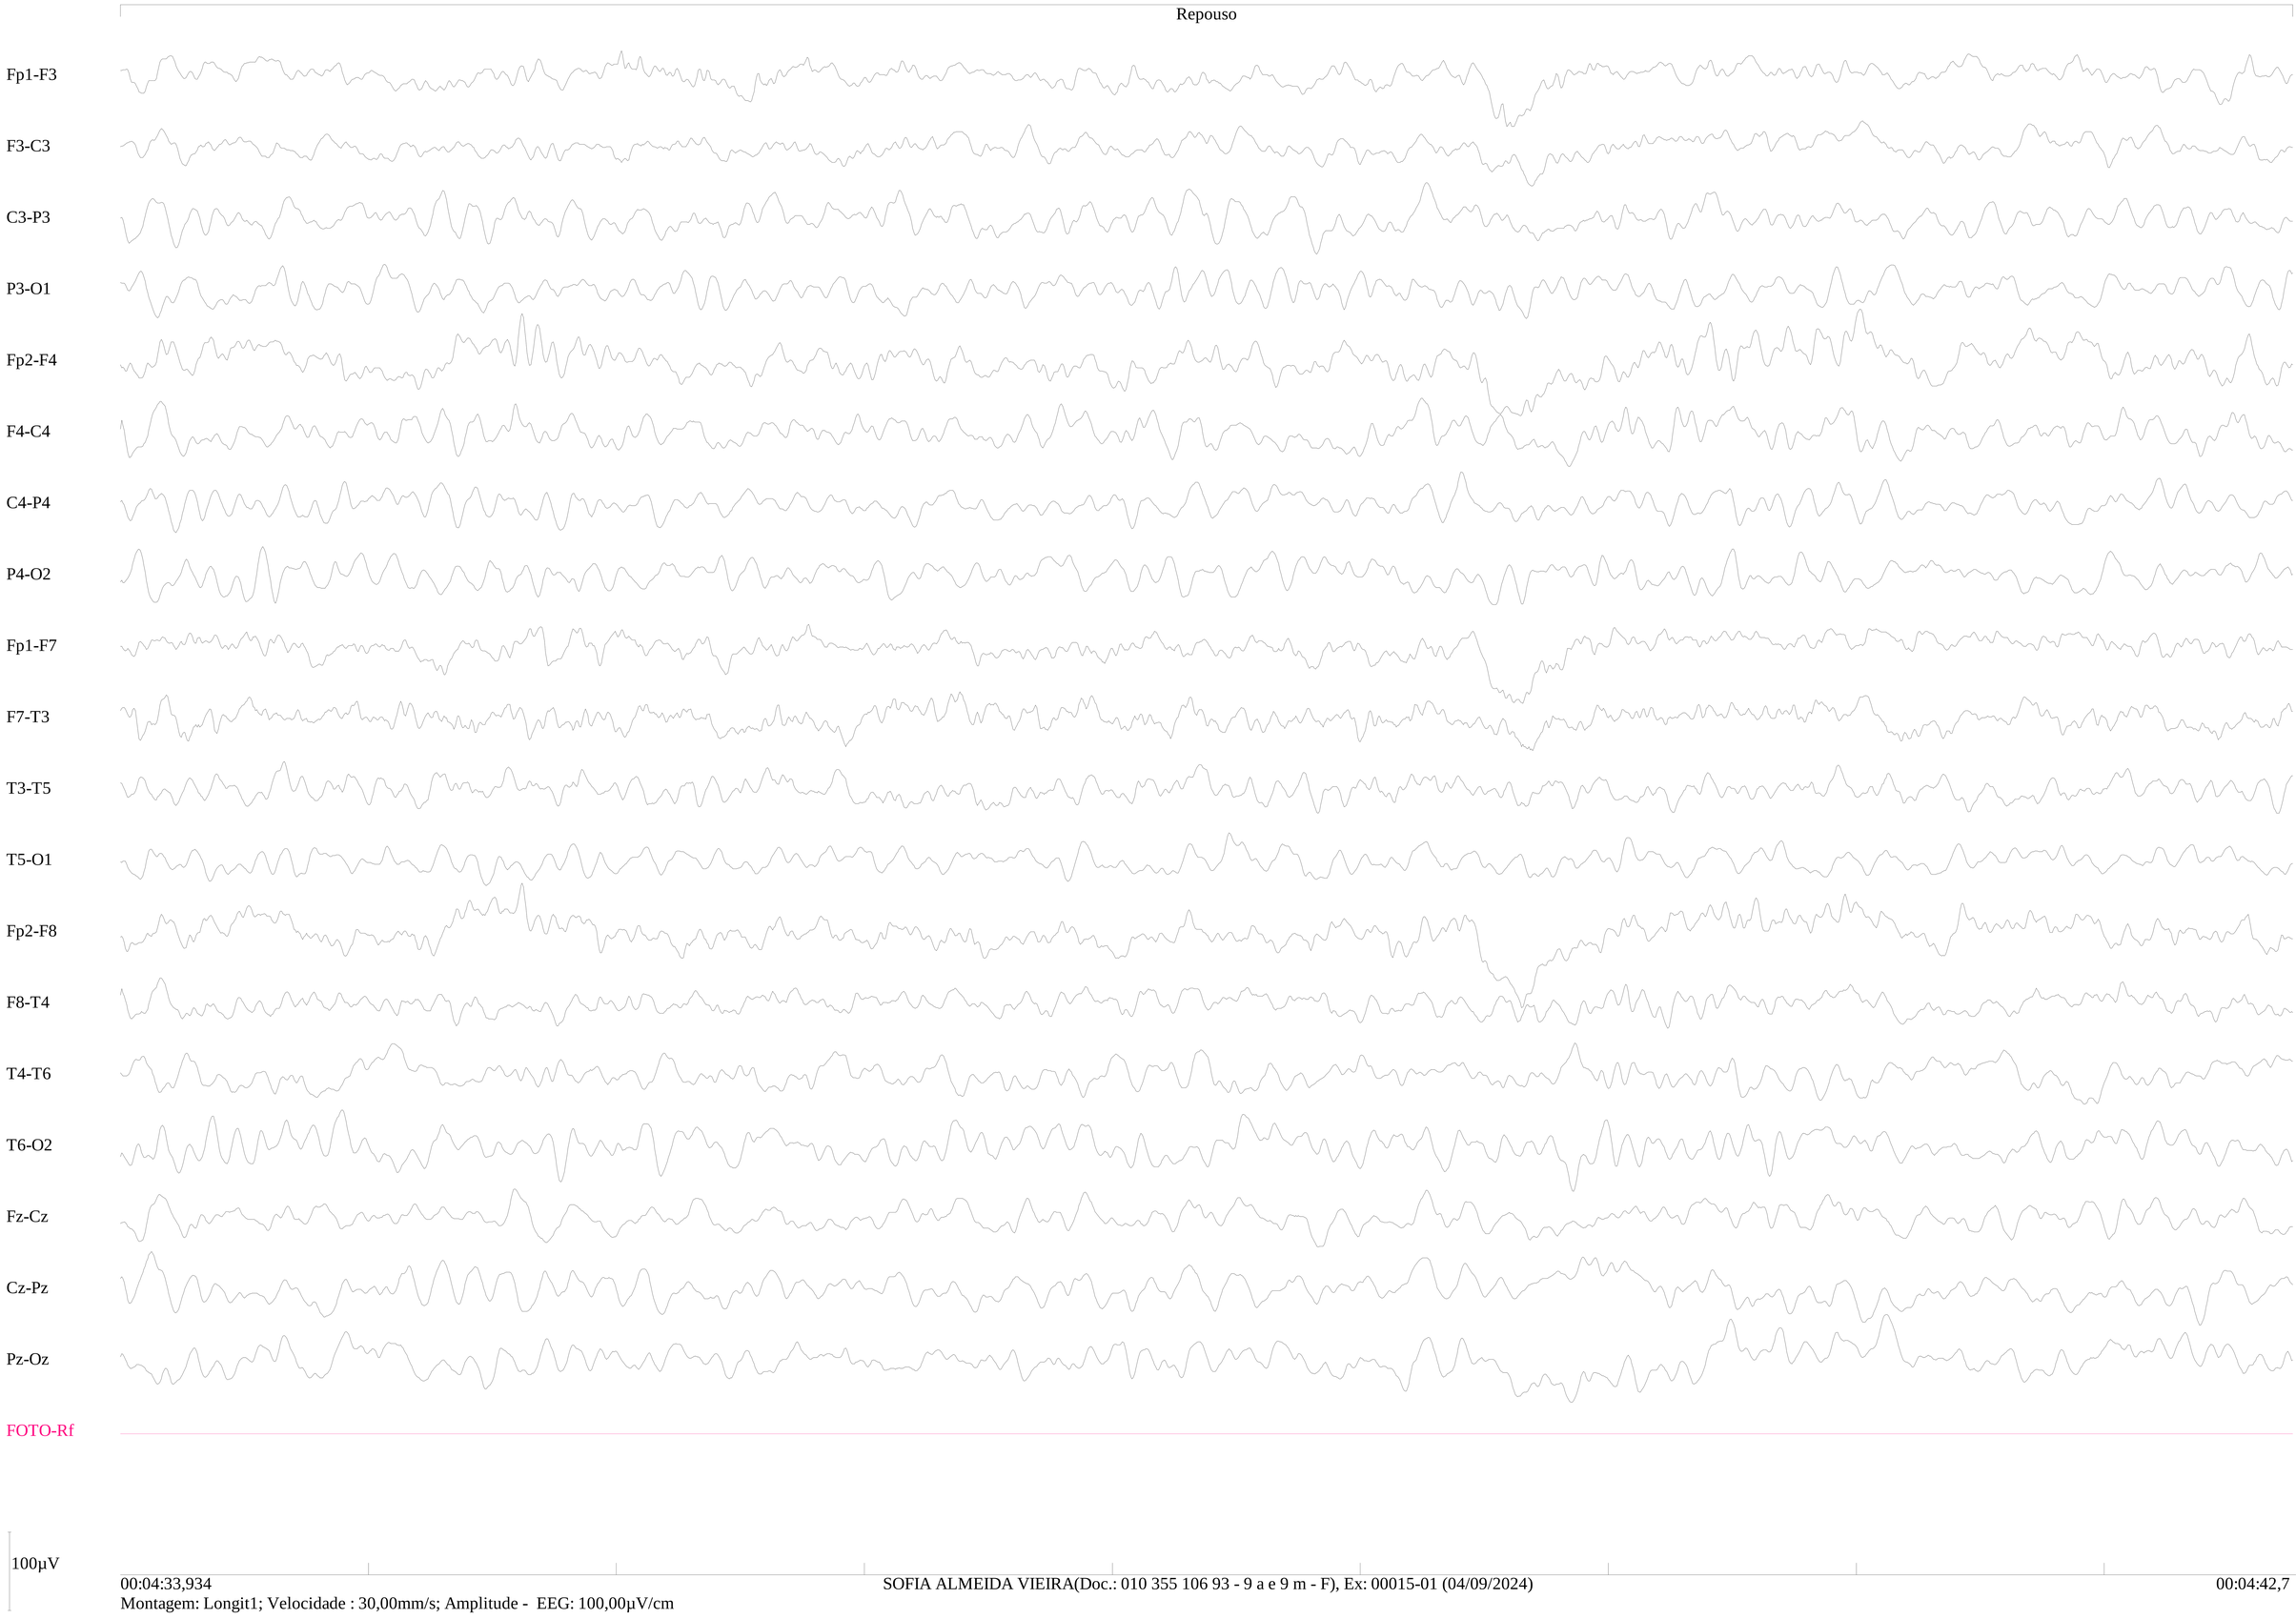
Repouso
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fz-Cz
Cz-Pz
Pz-Oz
FOTO-Rf
100µV
00:04:33,934
SOFIA ALMEIDA VIEIRA(Doc.: 010 355 106 93 - 9 a e 9 m - F), Ex: 00015-01 (04/09/2024)
00:04:42,7
Montagem: Longit1; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

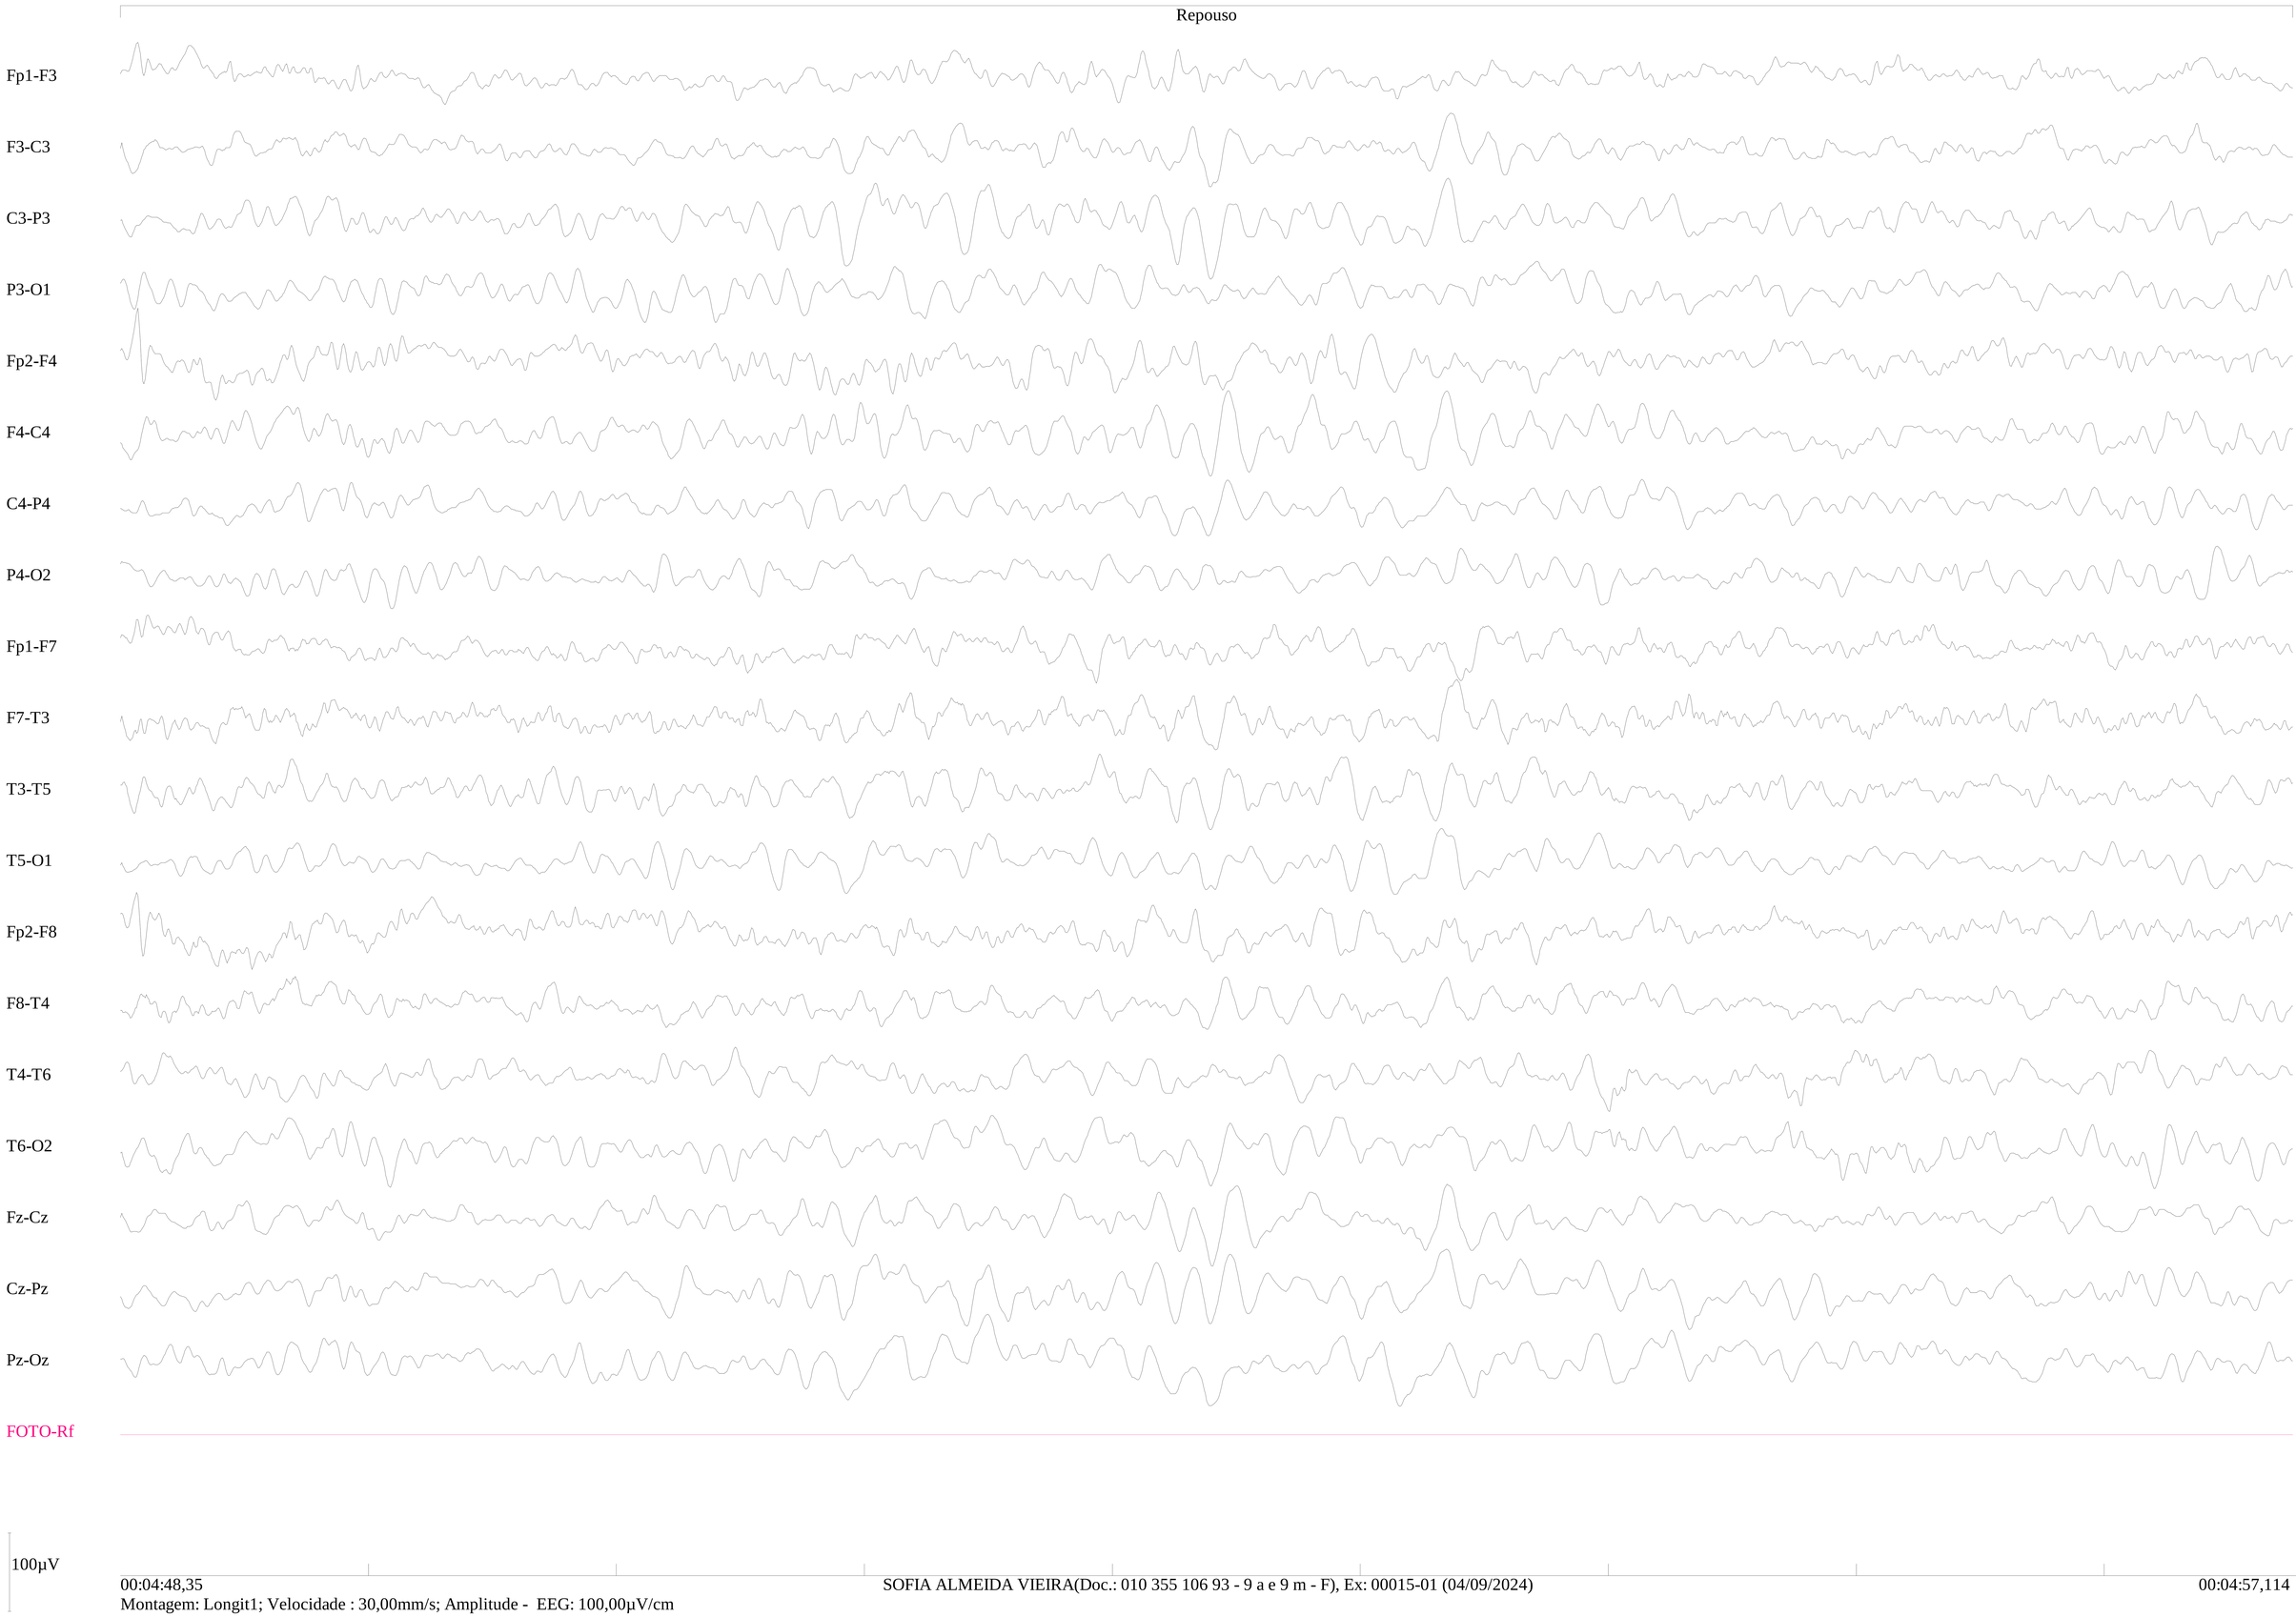
Repouso
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fz-Cz
Cz-Pz
Pz-Oz
FOTO-Rf
100µV
00:04:48,35
SOFIA ALMEIDA VIEIRA(Doc.: 010 355 106 93 - 9 a e 9 m - F), Ex: 00015-01 (04/09/2024)
00:04:57,114
Montagem: Longit1; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

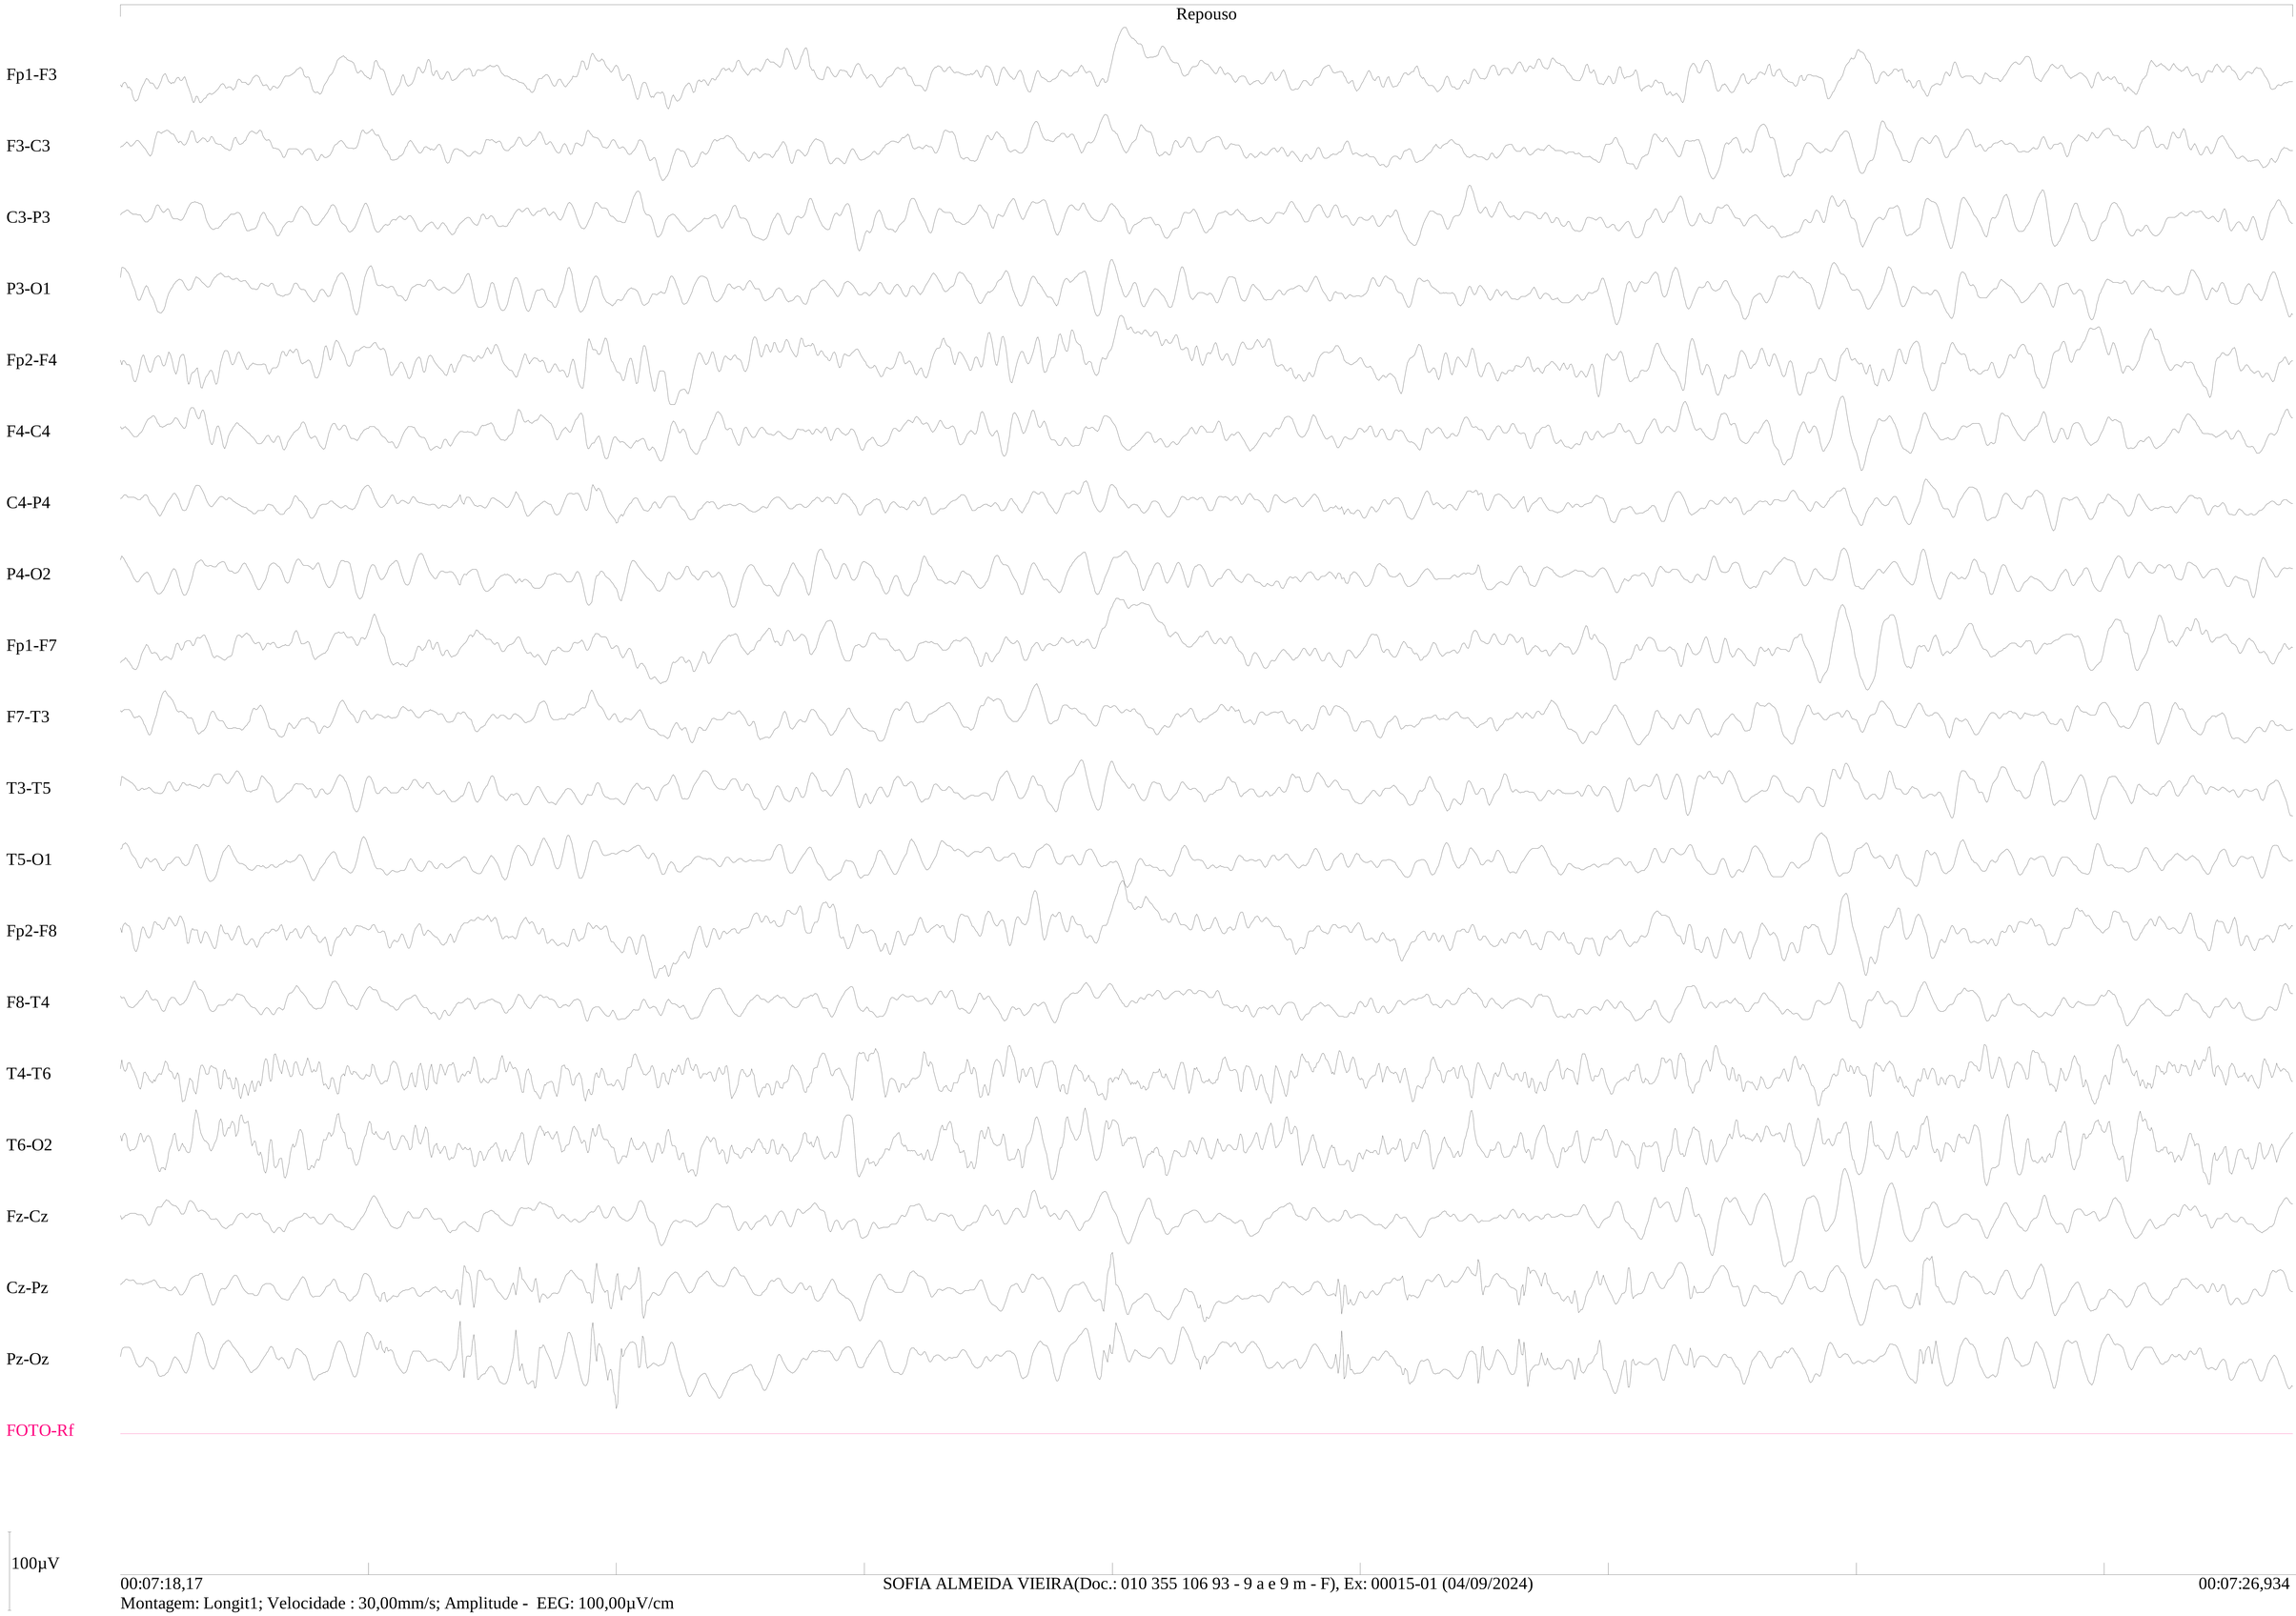
Repouso
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fz-Cz
Cz-Pz
Pz-Oz
FOTO-Rf
100µV
00:07:18,17
SOFIA ALMEIDA VIEIRA(Doc.: 010 355 106 93 - 9 a e 9 m - F), Ex: 00015-01 (04/09/2024)
00:07:26,934
Montagem: Longit1; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

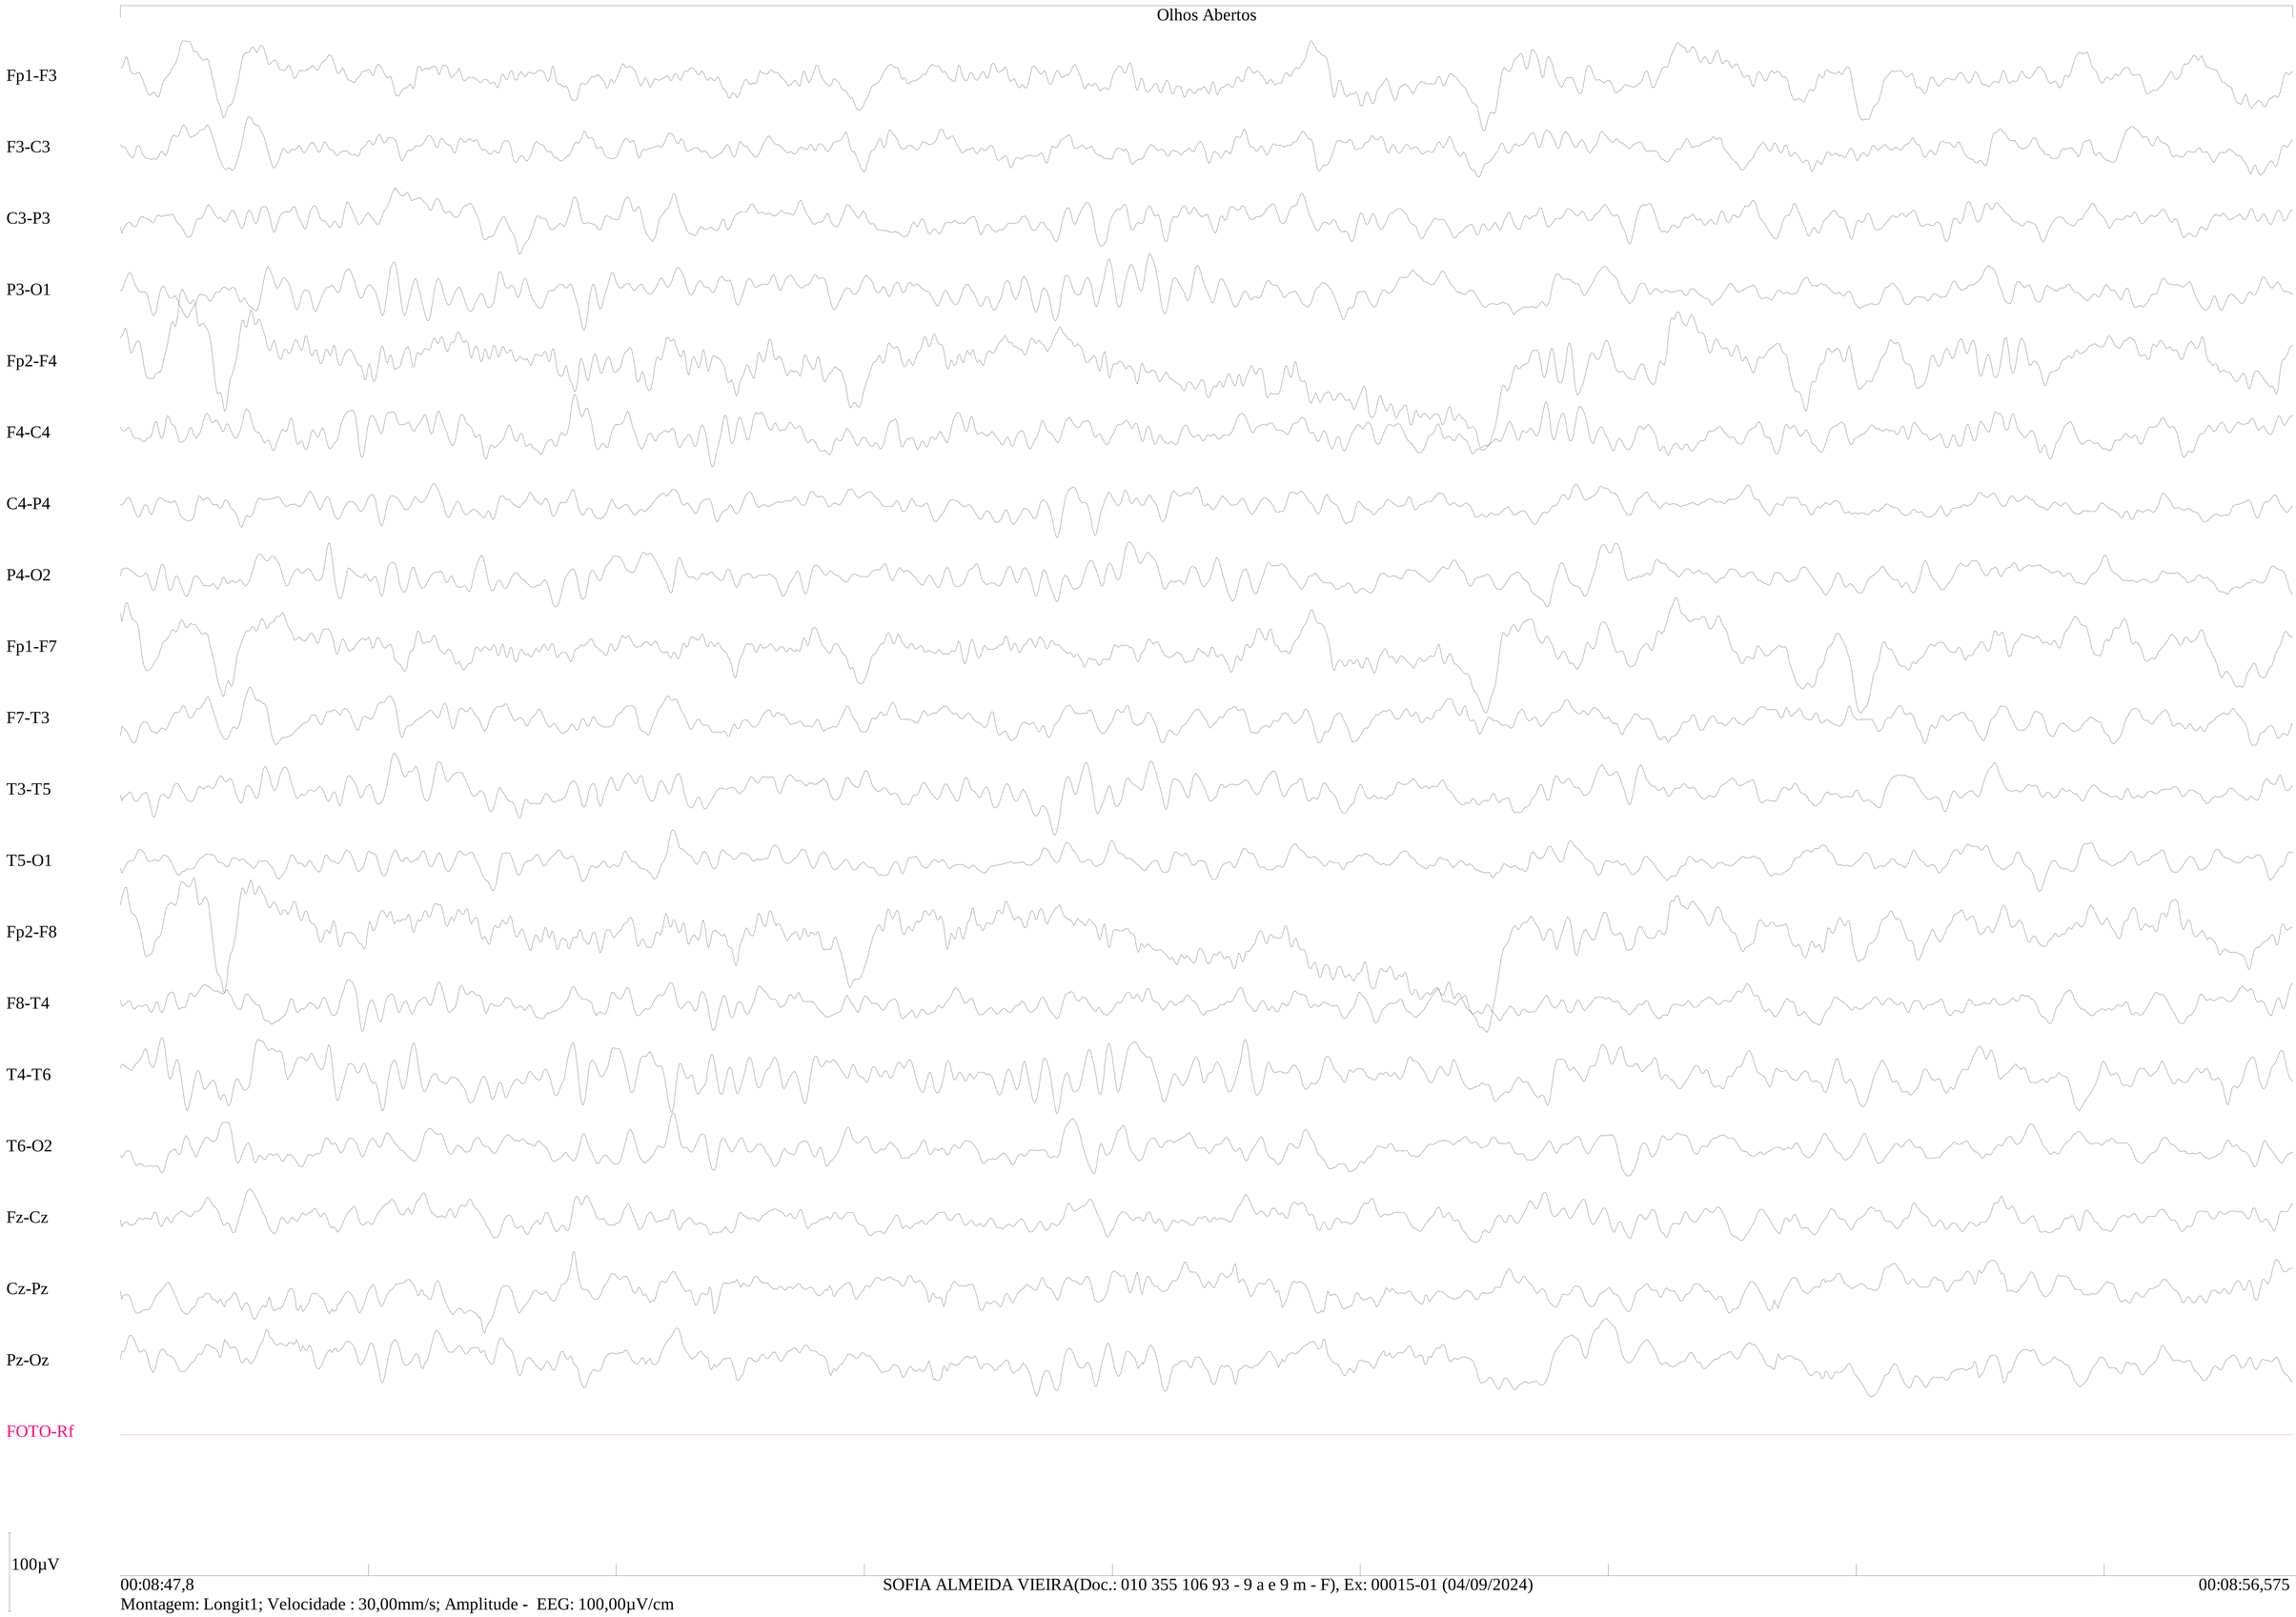
Olhos Abertos
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fz-Cz
Cz-Pz
Pz-Oz
FOTO-Rf
100µV
00:08:47,8
SOFIA ALMEIDA VIEIRA(Doc.: 010 355 106 93 - 9 a e 9 m - F), Ex: 00015-01 (04/09/2024)
00:08:56,575
Montagem: Longit1; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

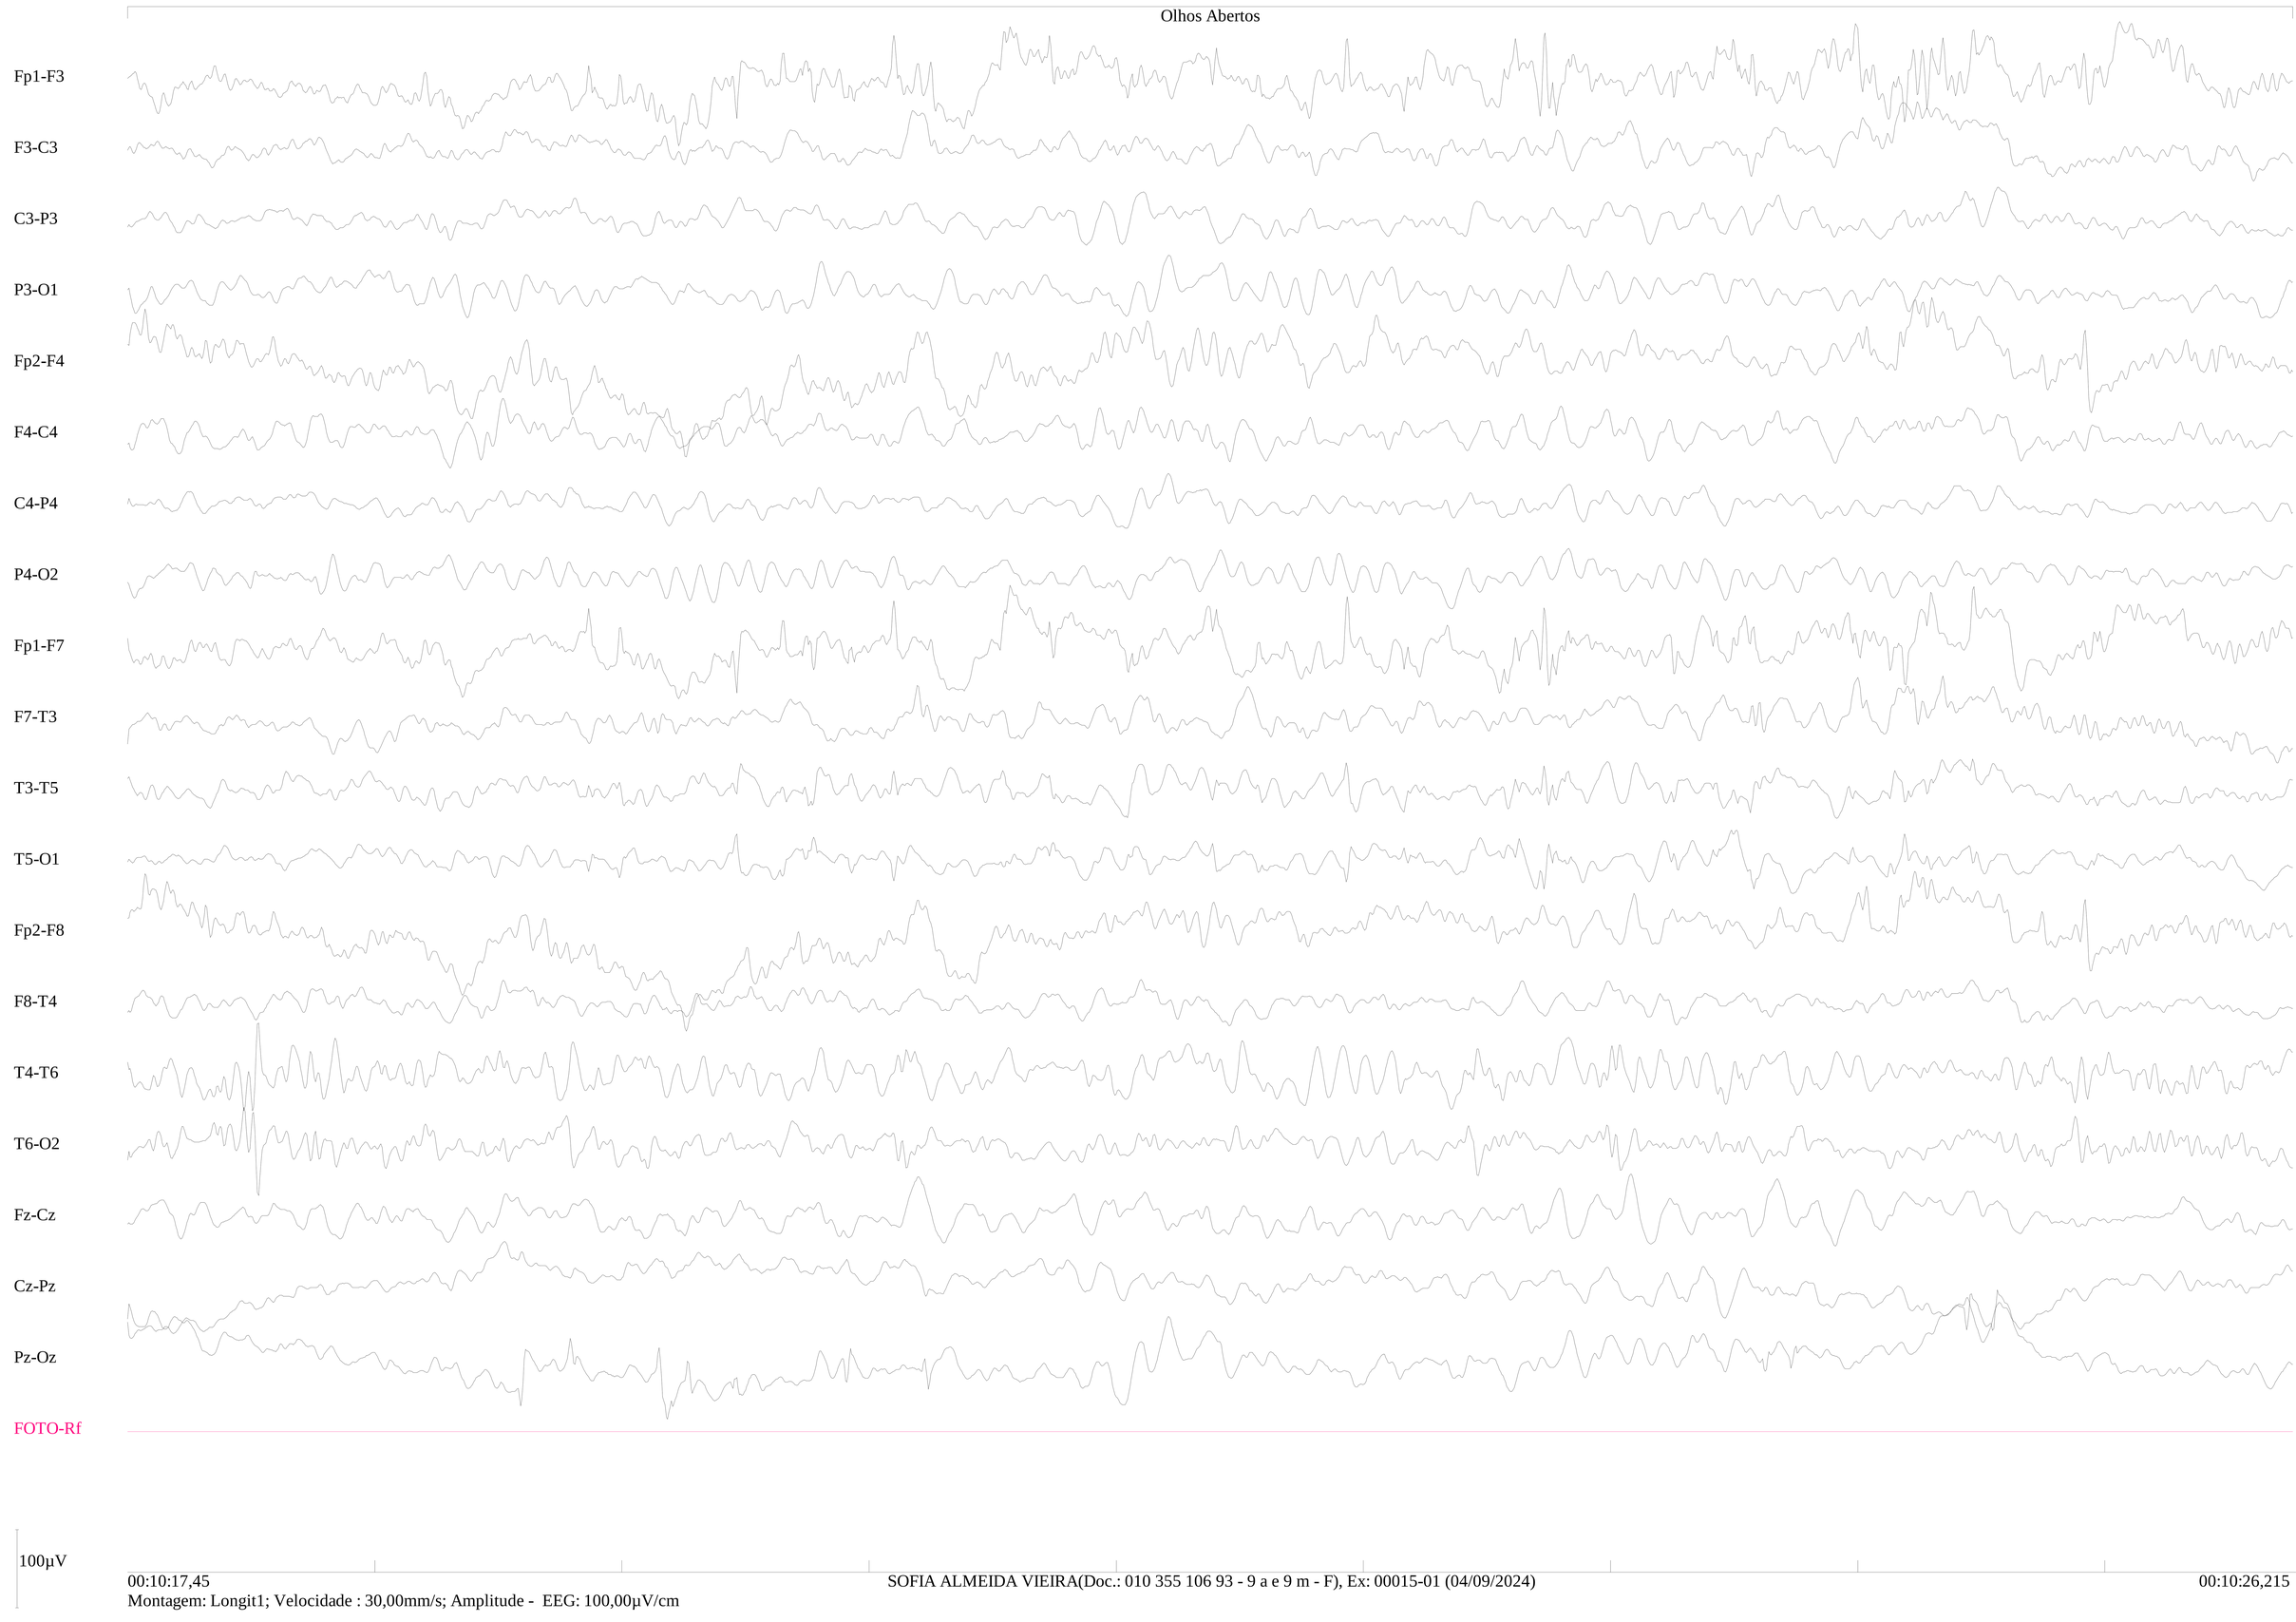
Olhos Abertos
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fz-Cz
Cz-Pz
Pz-Oz
FOTO-Rf
100µV
00:10:17,45
SOFIA ALMEIDA VIEIRA(Doc.: 010 355 106 93 - 9 a e 9 m - F), Ex: 00015-01 (04/09/2024)
00:10:26,215
Montagem: Longit1; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

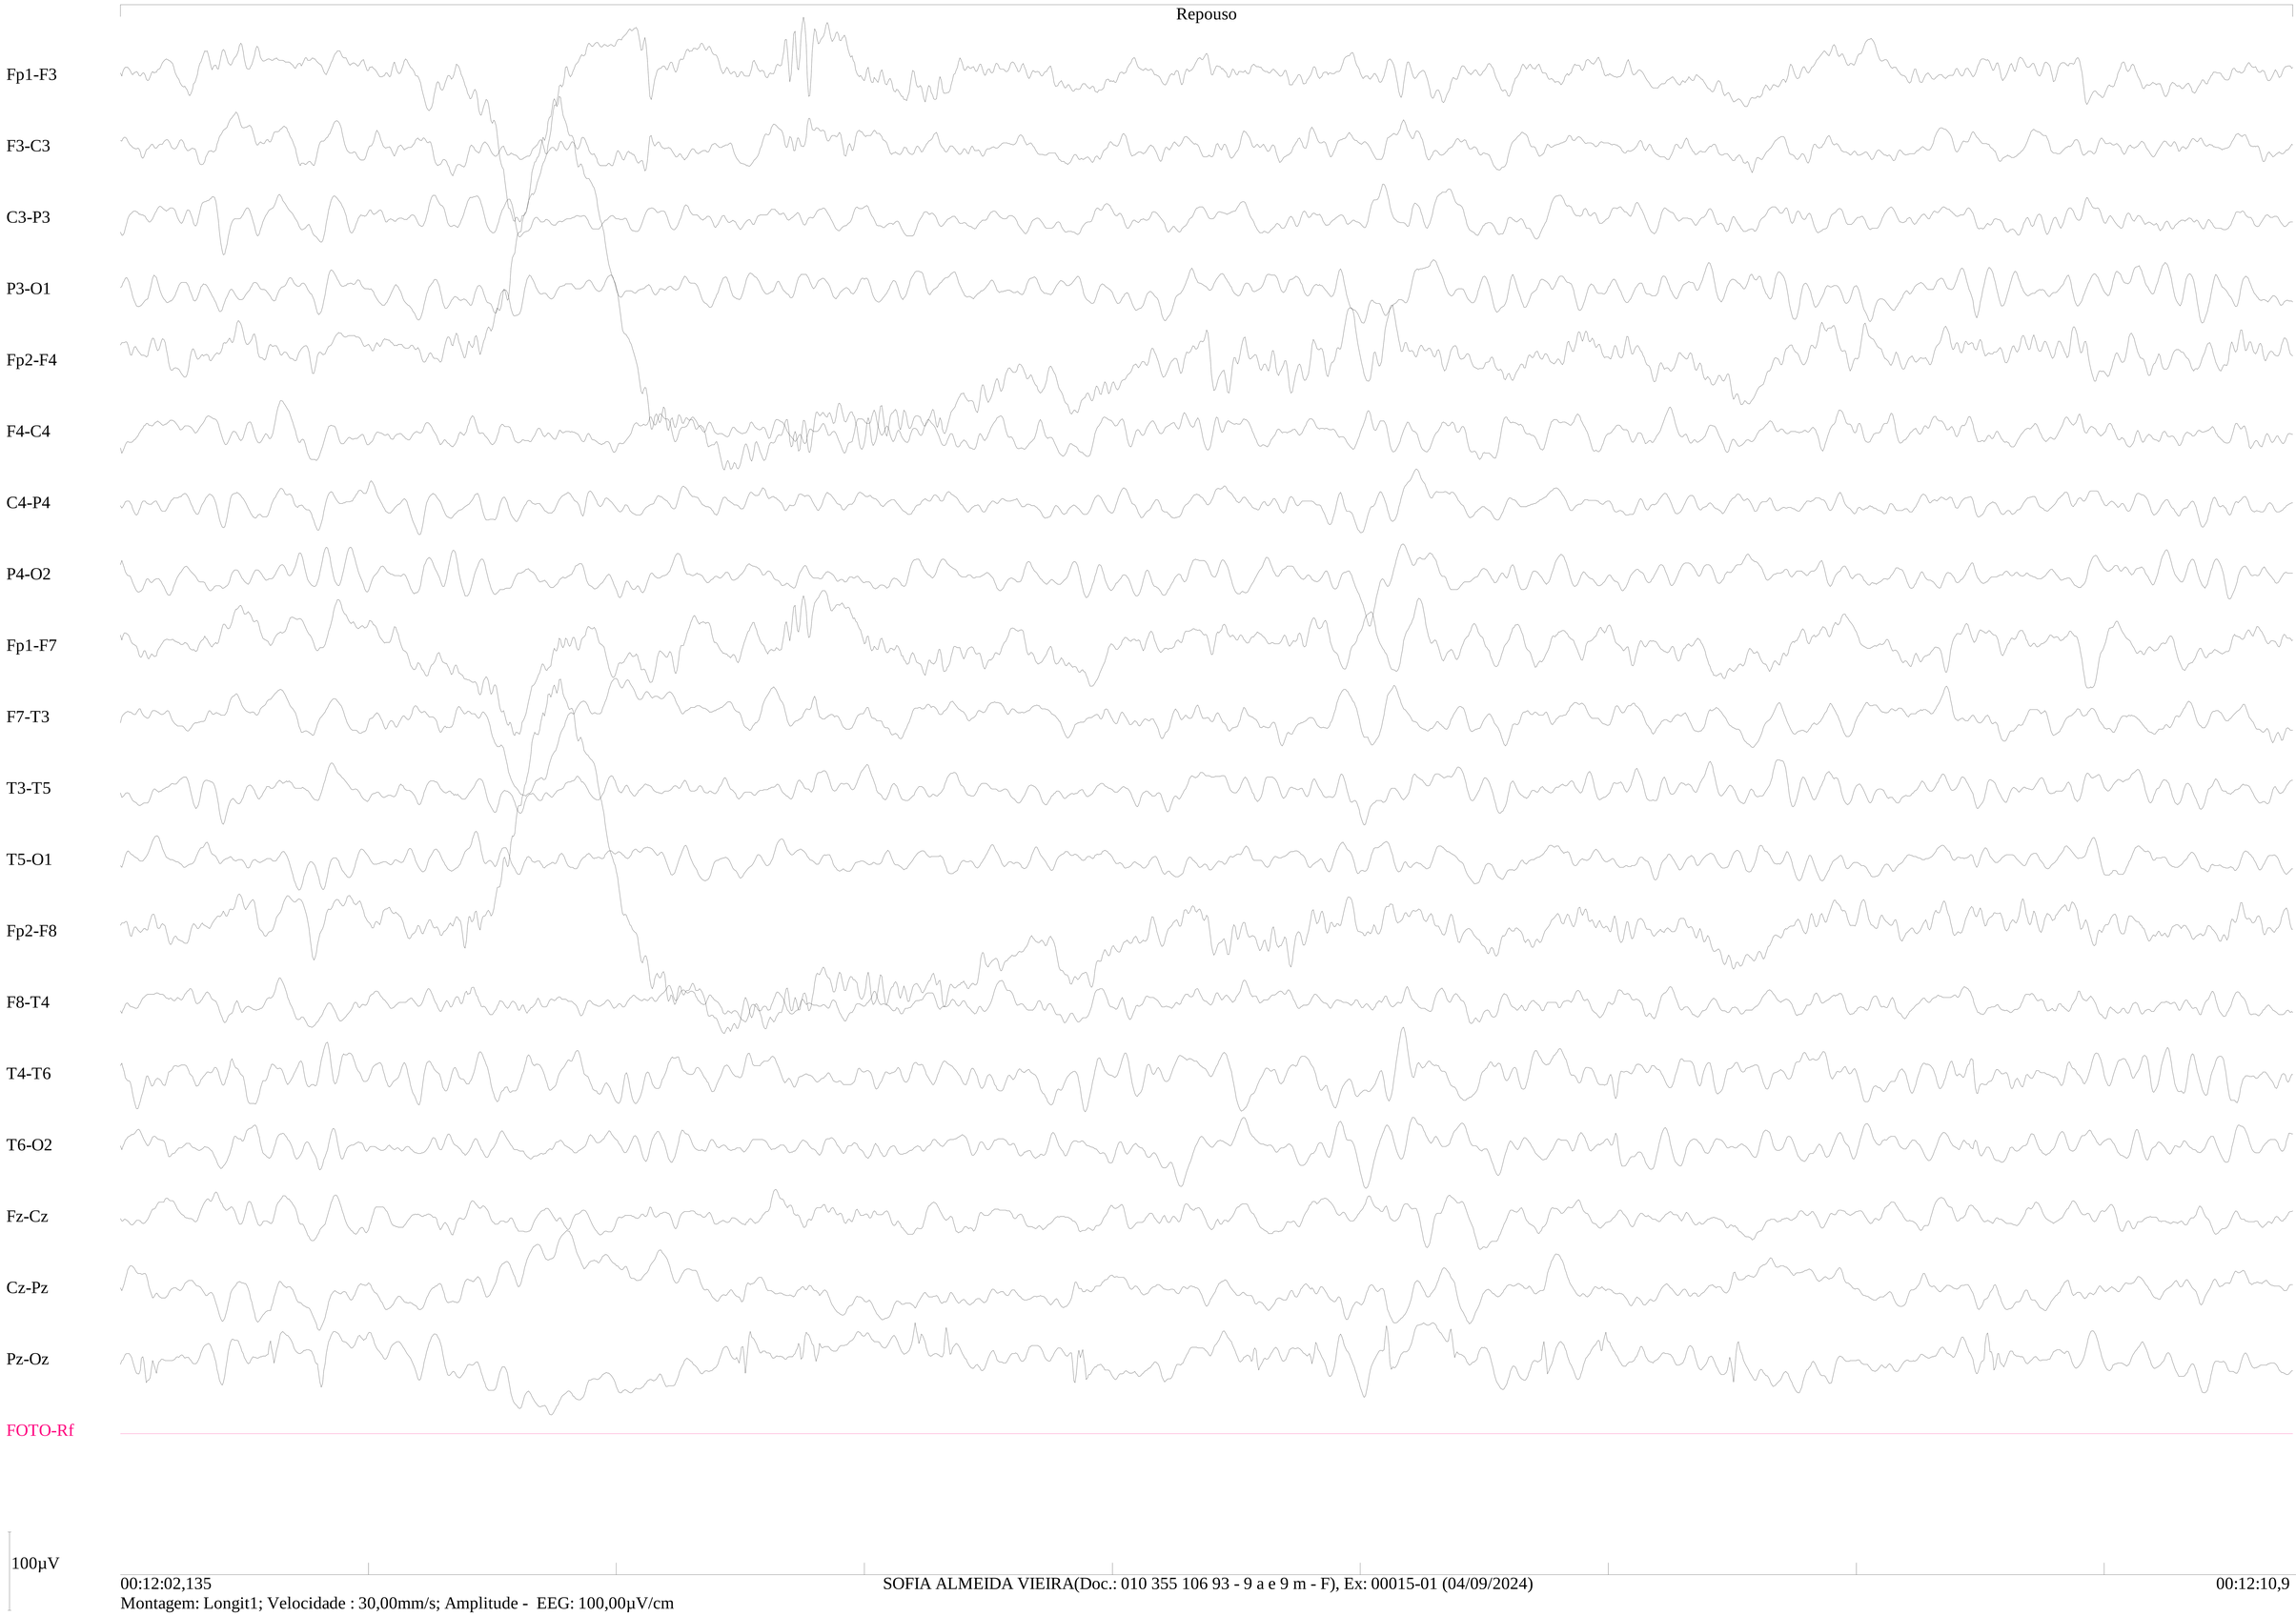
Repouso
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fz-Cz
Cz-Pz
Pz-Oz
FOTO-Rf
100µV
00:12:02,135
SOFIA ALMEIDA VIEIRA(Doc.: 010 355 106 93 - 9 a e 9 m - F), Ex: 00015-01 (04/09/2024)
00:12:10,9
Montagem: Longit1; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

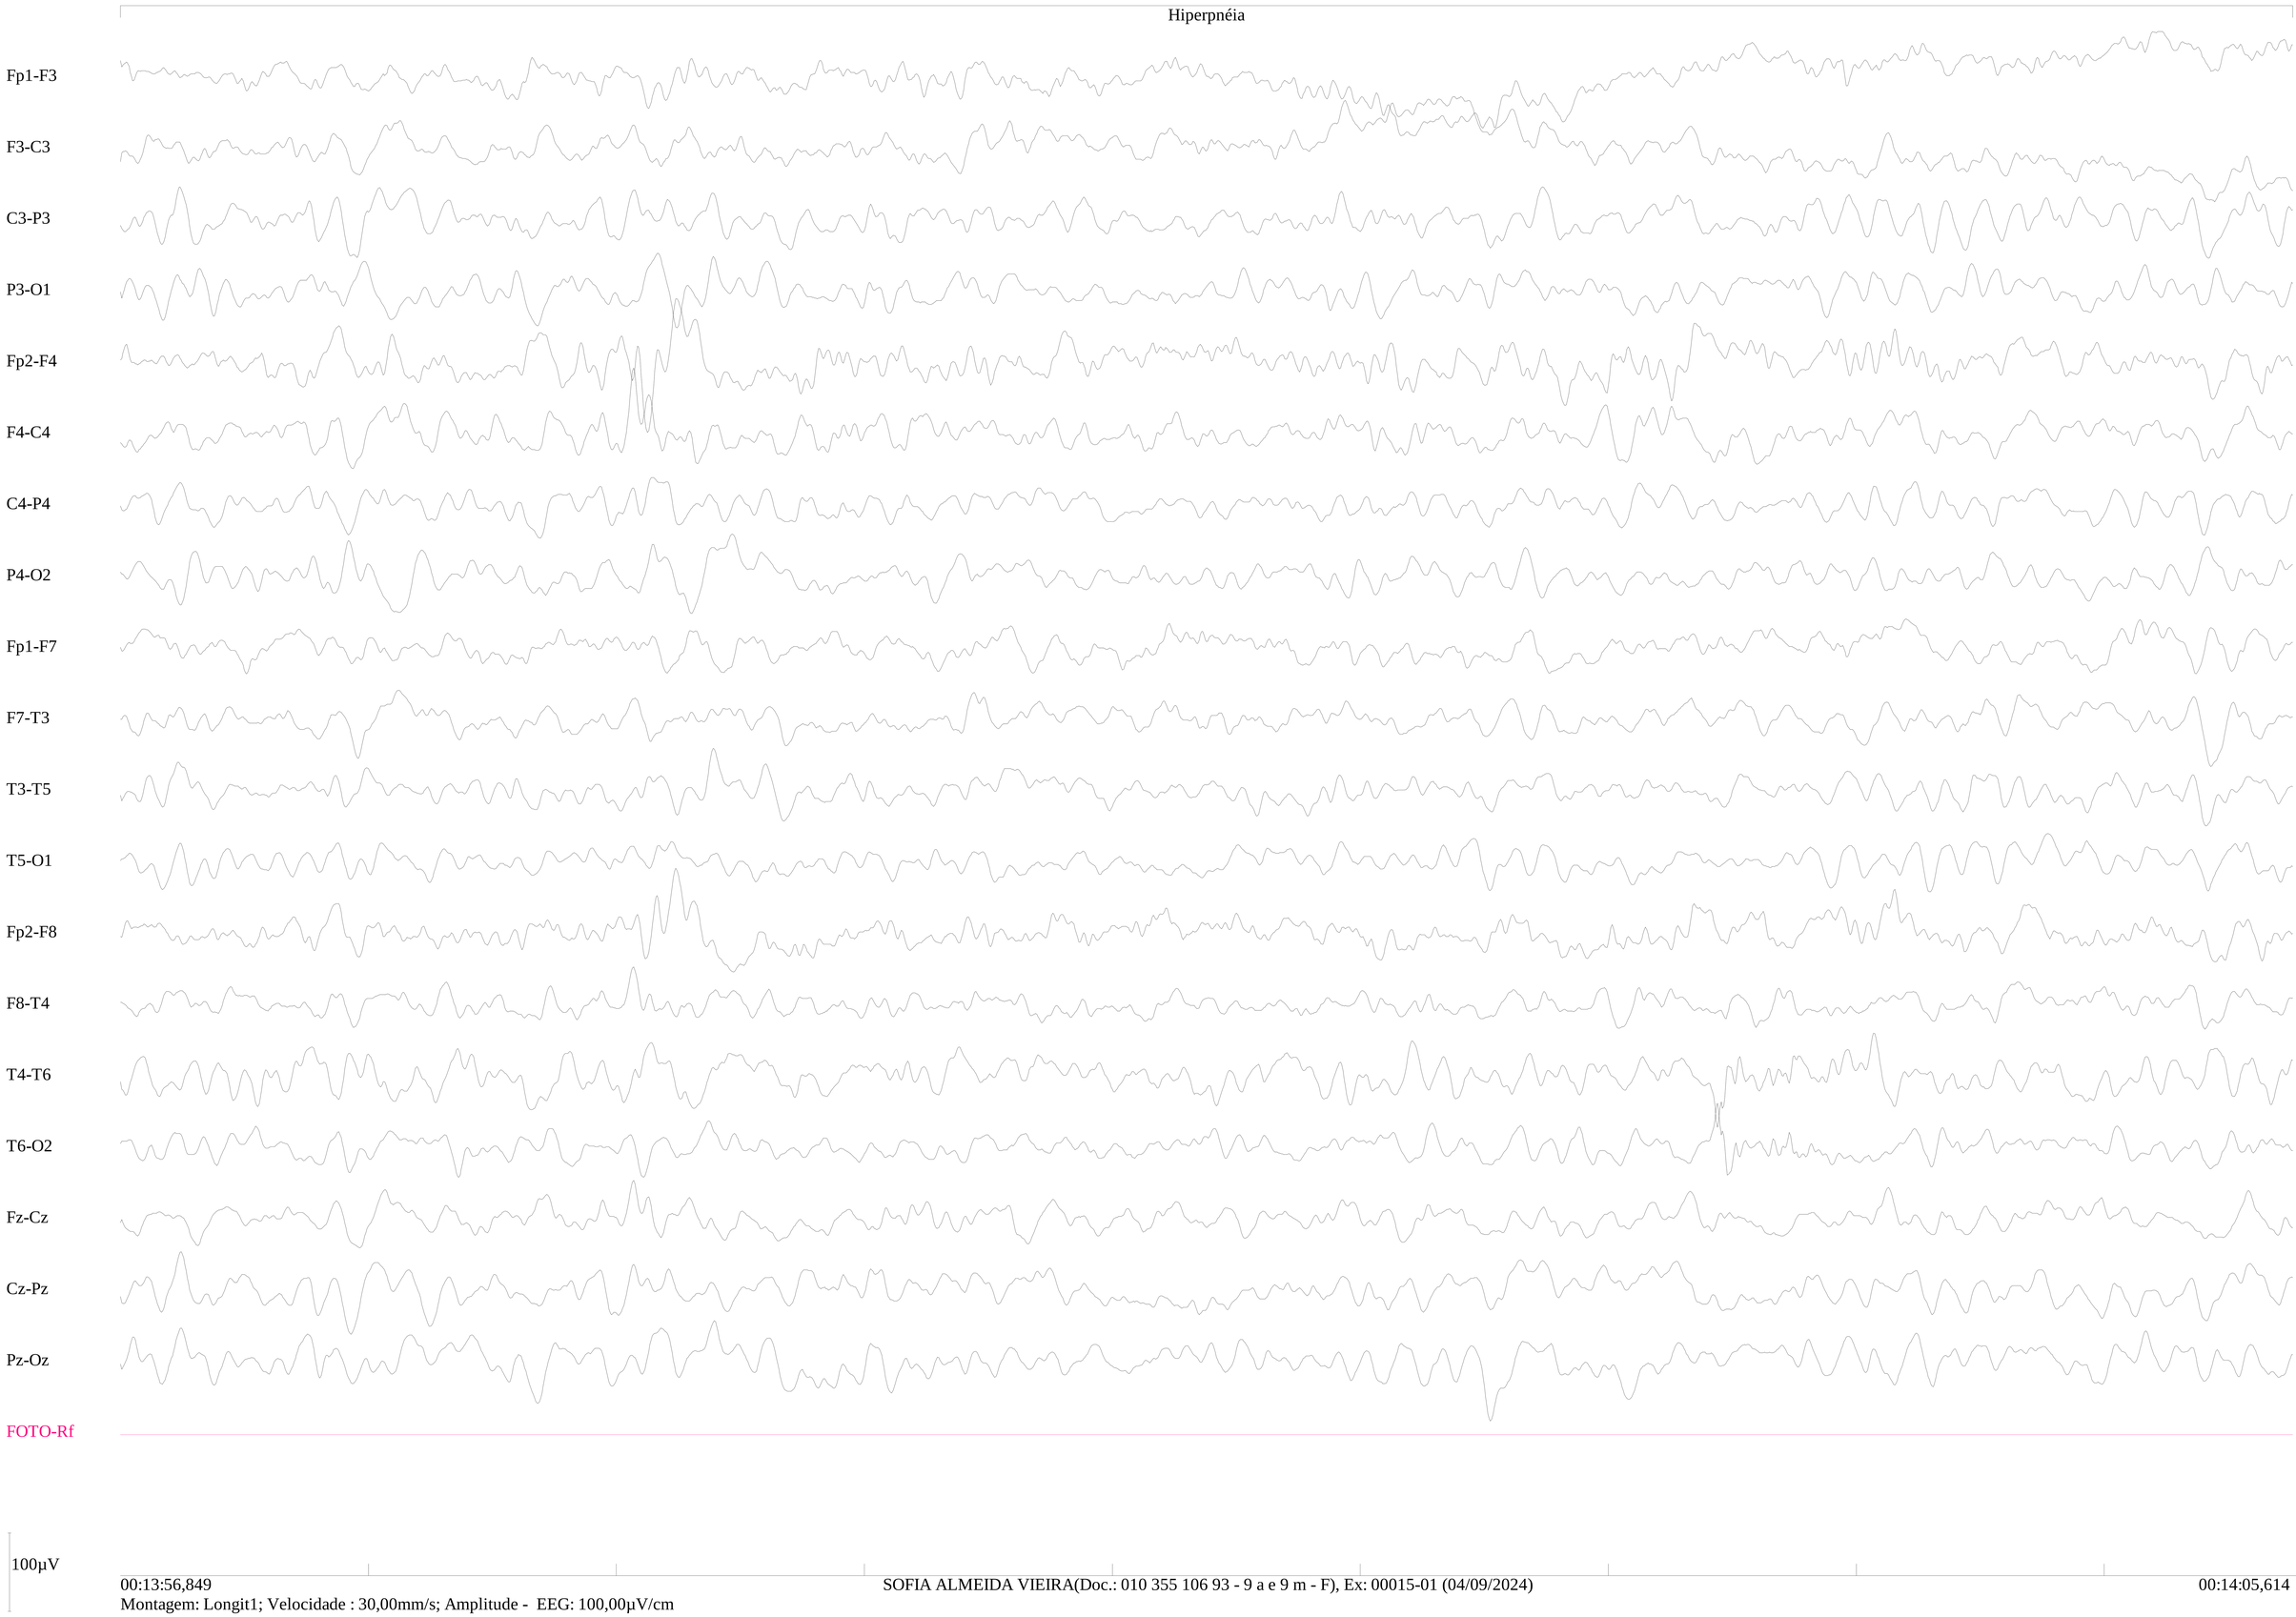
Hiperpnéia
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fz-Cz
Cz-Pz
Pz-Oz
FOTO-Rf
100µV
00:13:56,849
SOFIA ALMEIDA VIEIRA(Doc.: 010 355 106 93 - 9 a e 9 m - F), Ex: 00015-01 (04/09/2024)
00:14:05,614
Montagem: Longit1; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

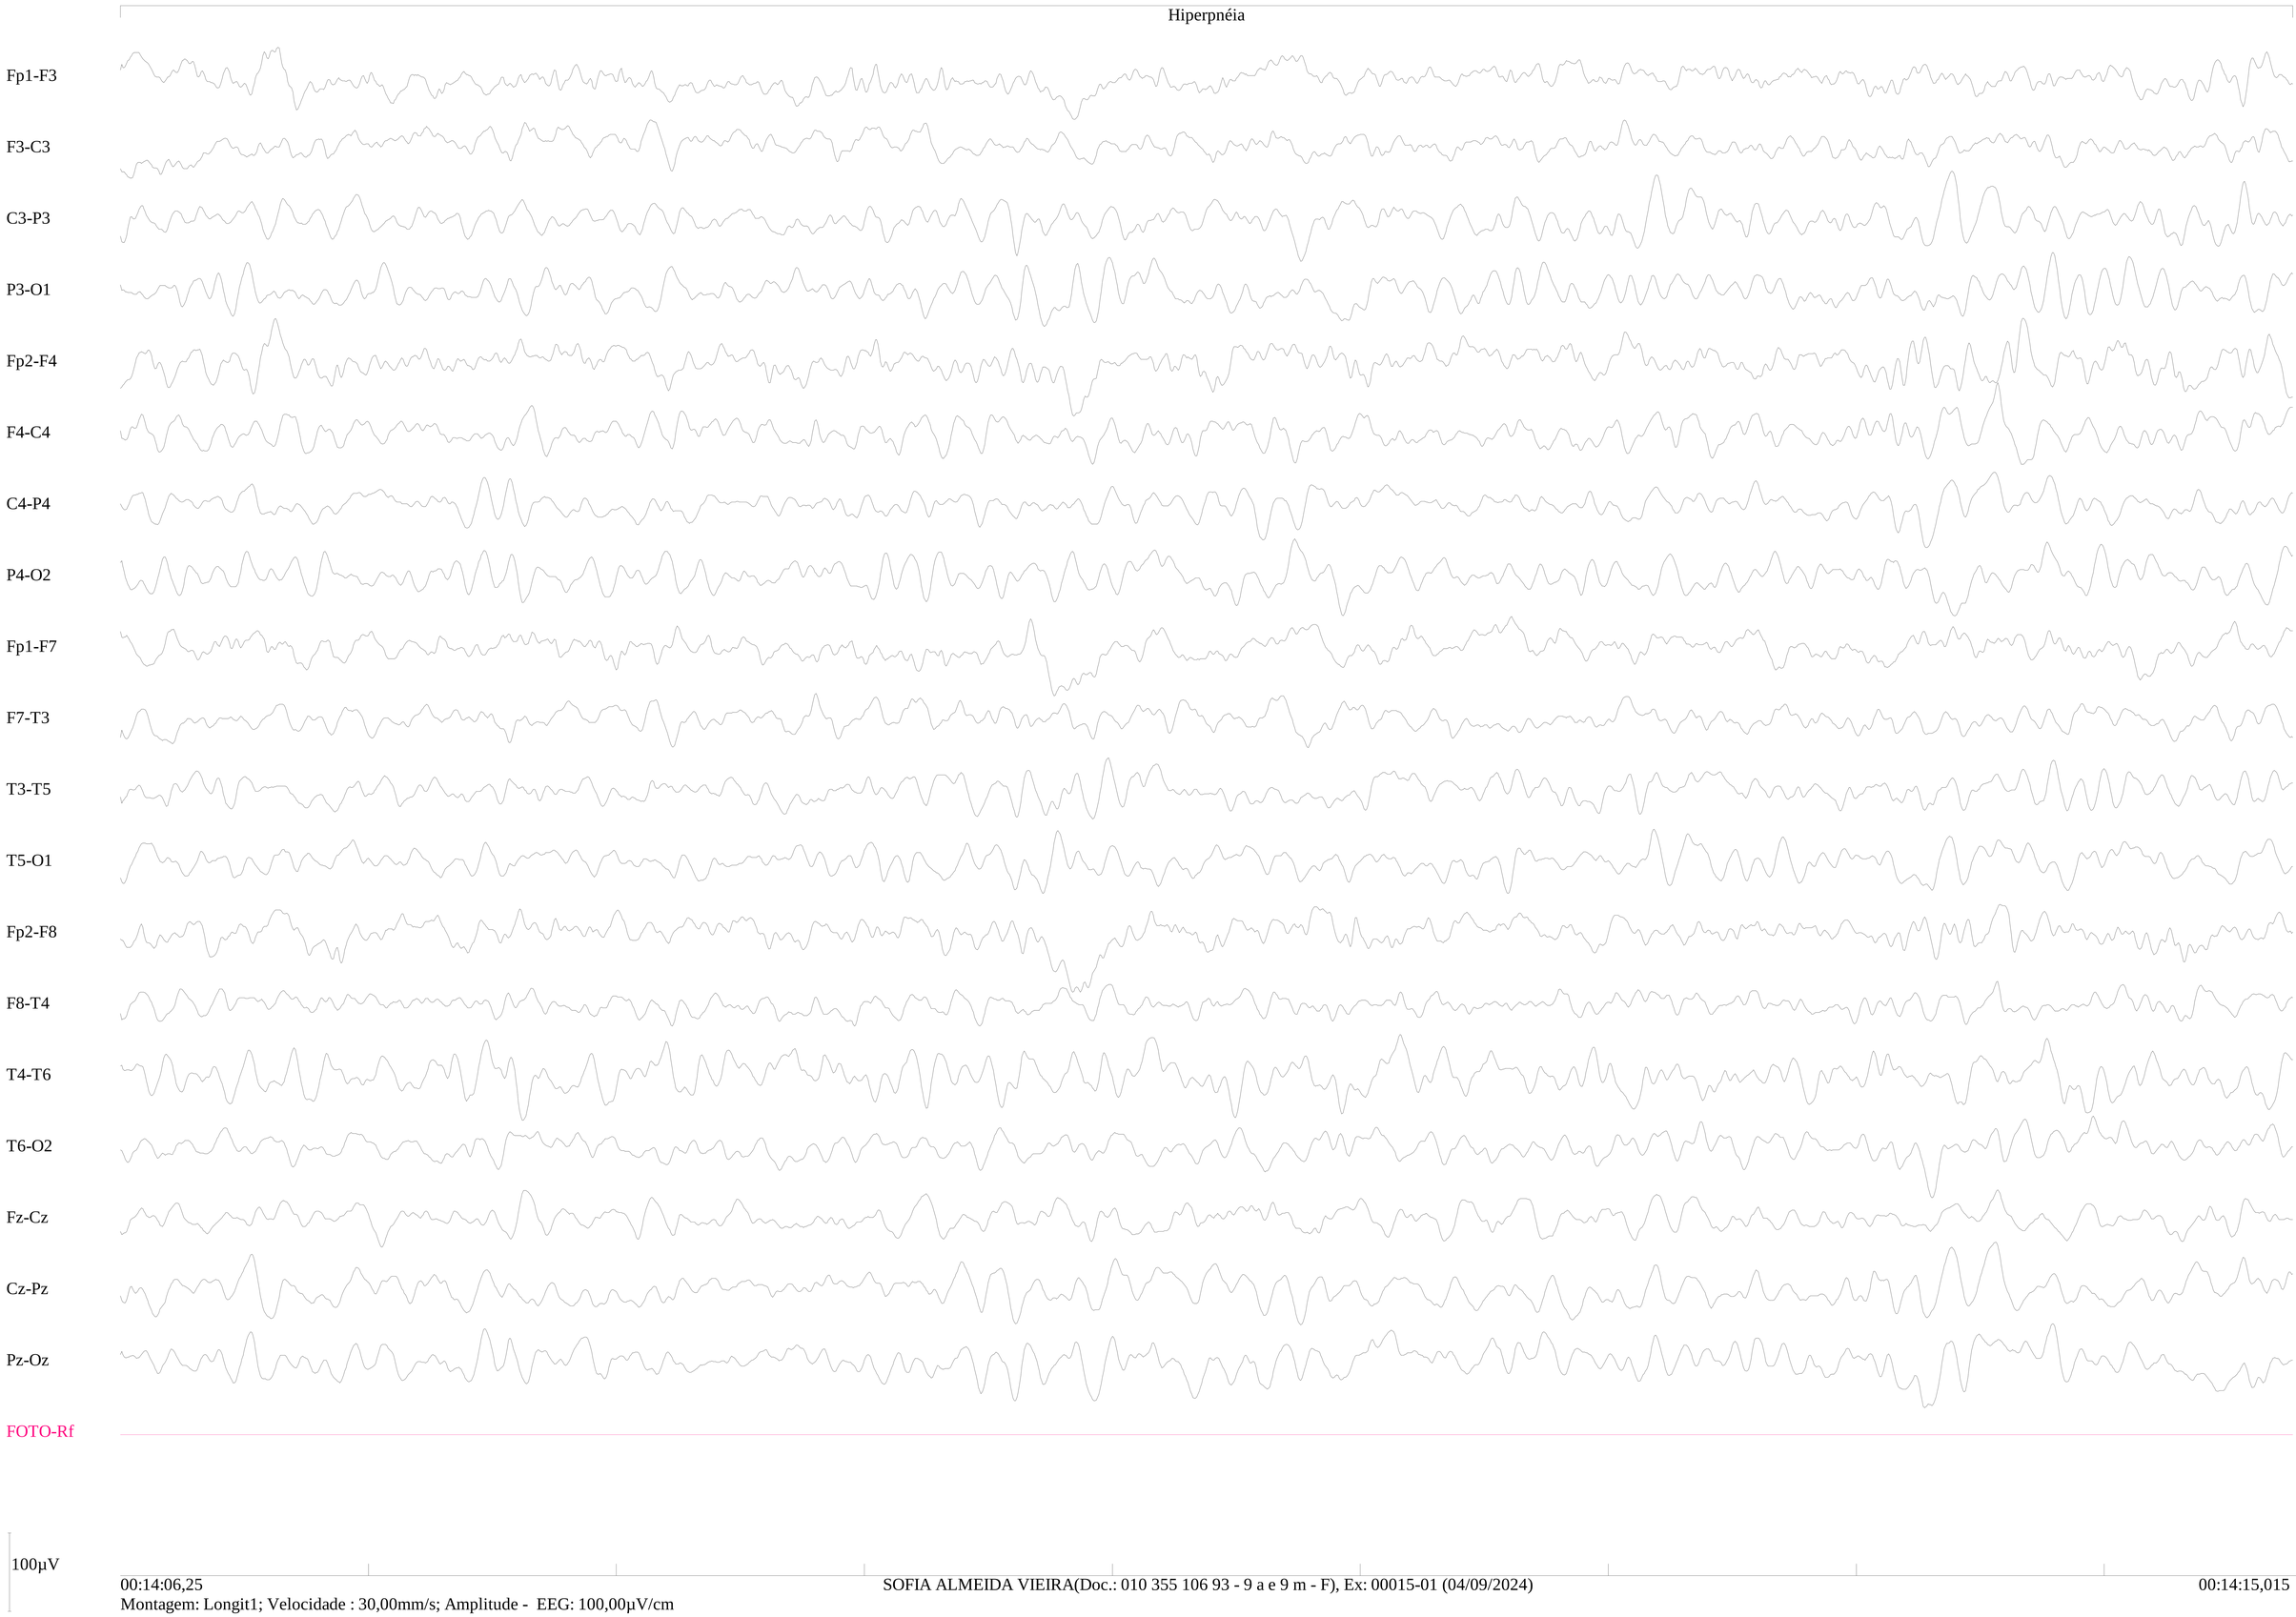
Hiperpnéia
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fz-Cz
Cz-Pz
Pz-Oz
FOTO-Rf
100µV
00:14:06,25
SOFIA ALMEIDA VIEIRA(Doc.: 010 355 106 93 - 9 a e 9 m - F), Ex: 00015-01 (04/09/2024)
00:14:15,015
Montagem: Longit1; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

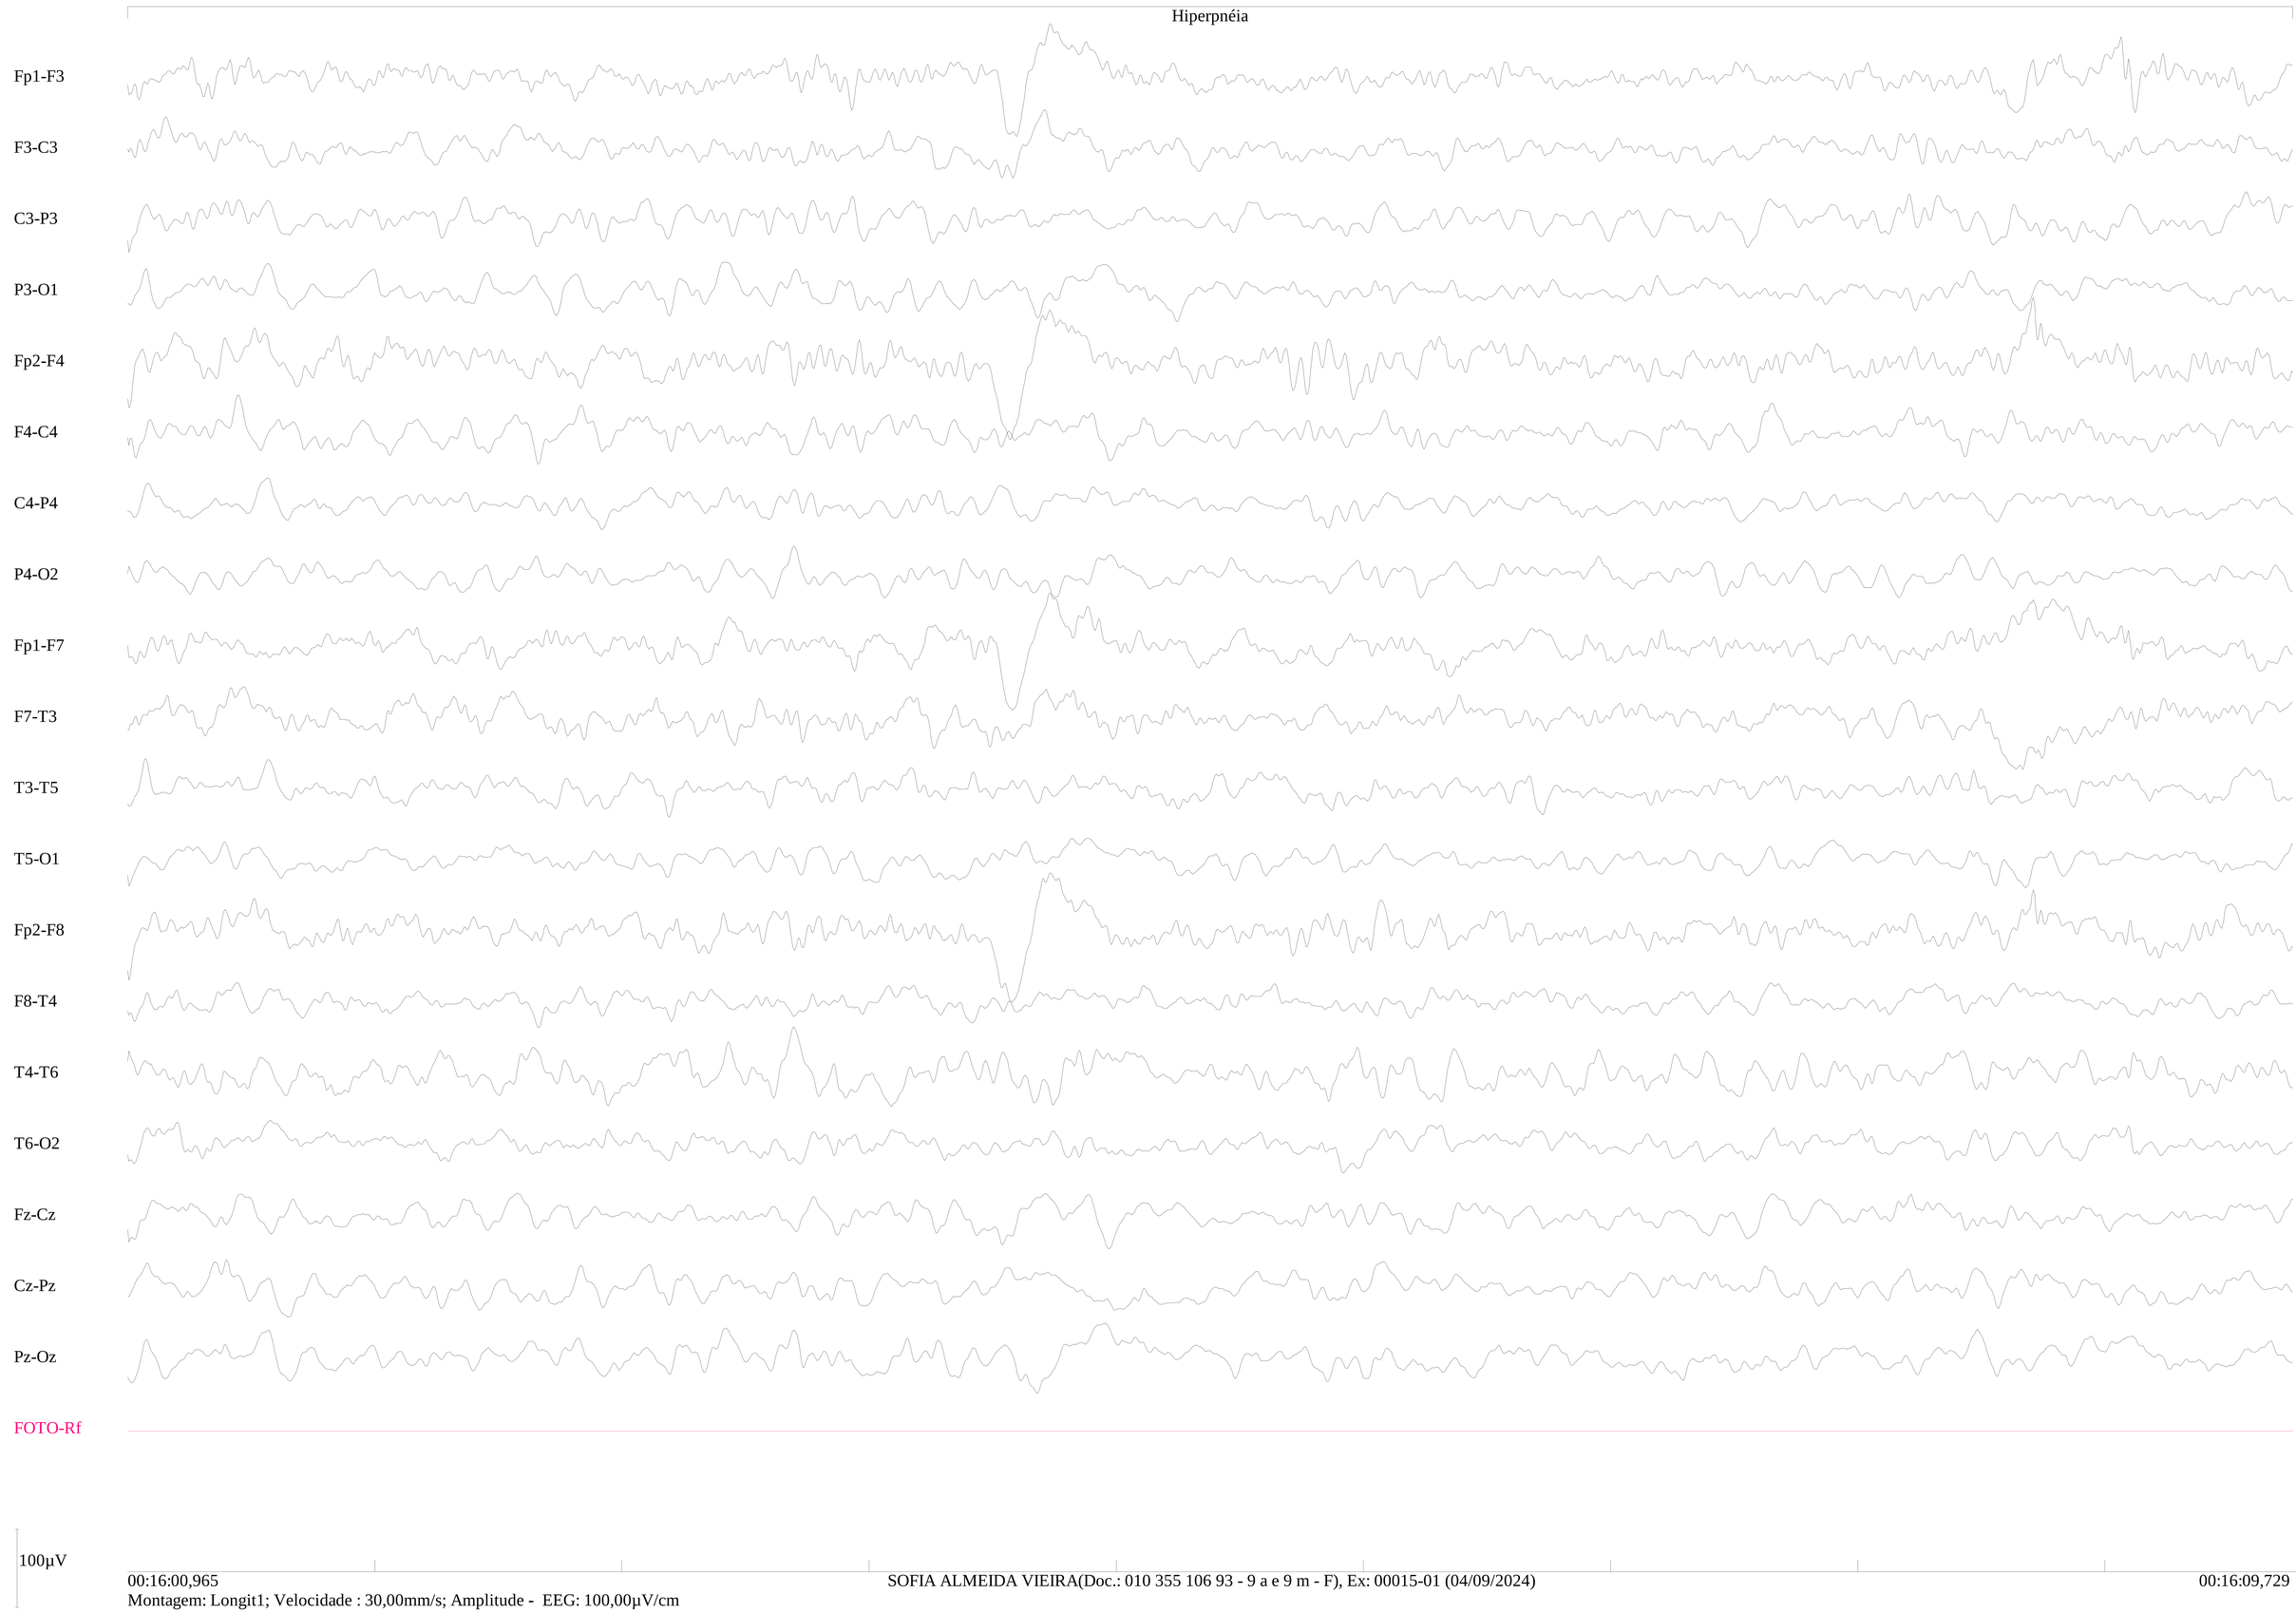
Hiperpnéia
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fz-Cz
Cz-Pz
Pz-Oz
FOTO-Rf
100µV
00:16:00,965
SOFIA ALMEIDA VIEIRA(Doc.: 010 355 106 93 - 9 a e 9 m - F), Ex: 00015-01 (04/09/2024)
00:16:09,729
Montagem: Longit1; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

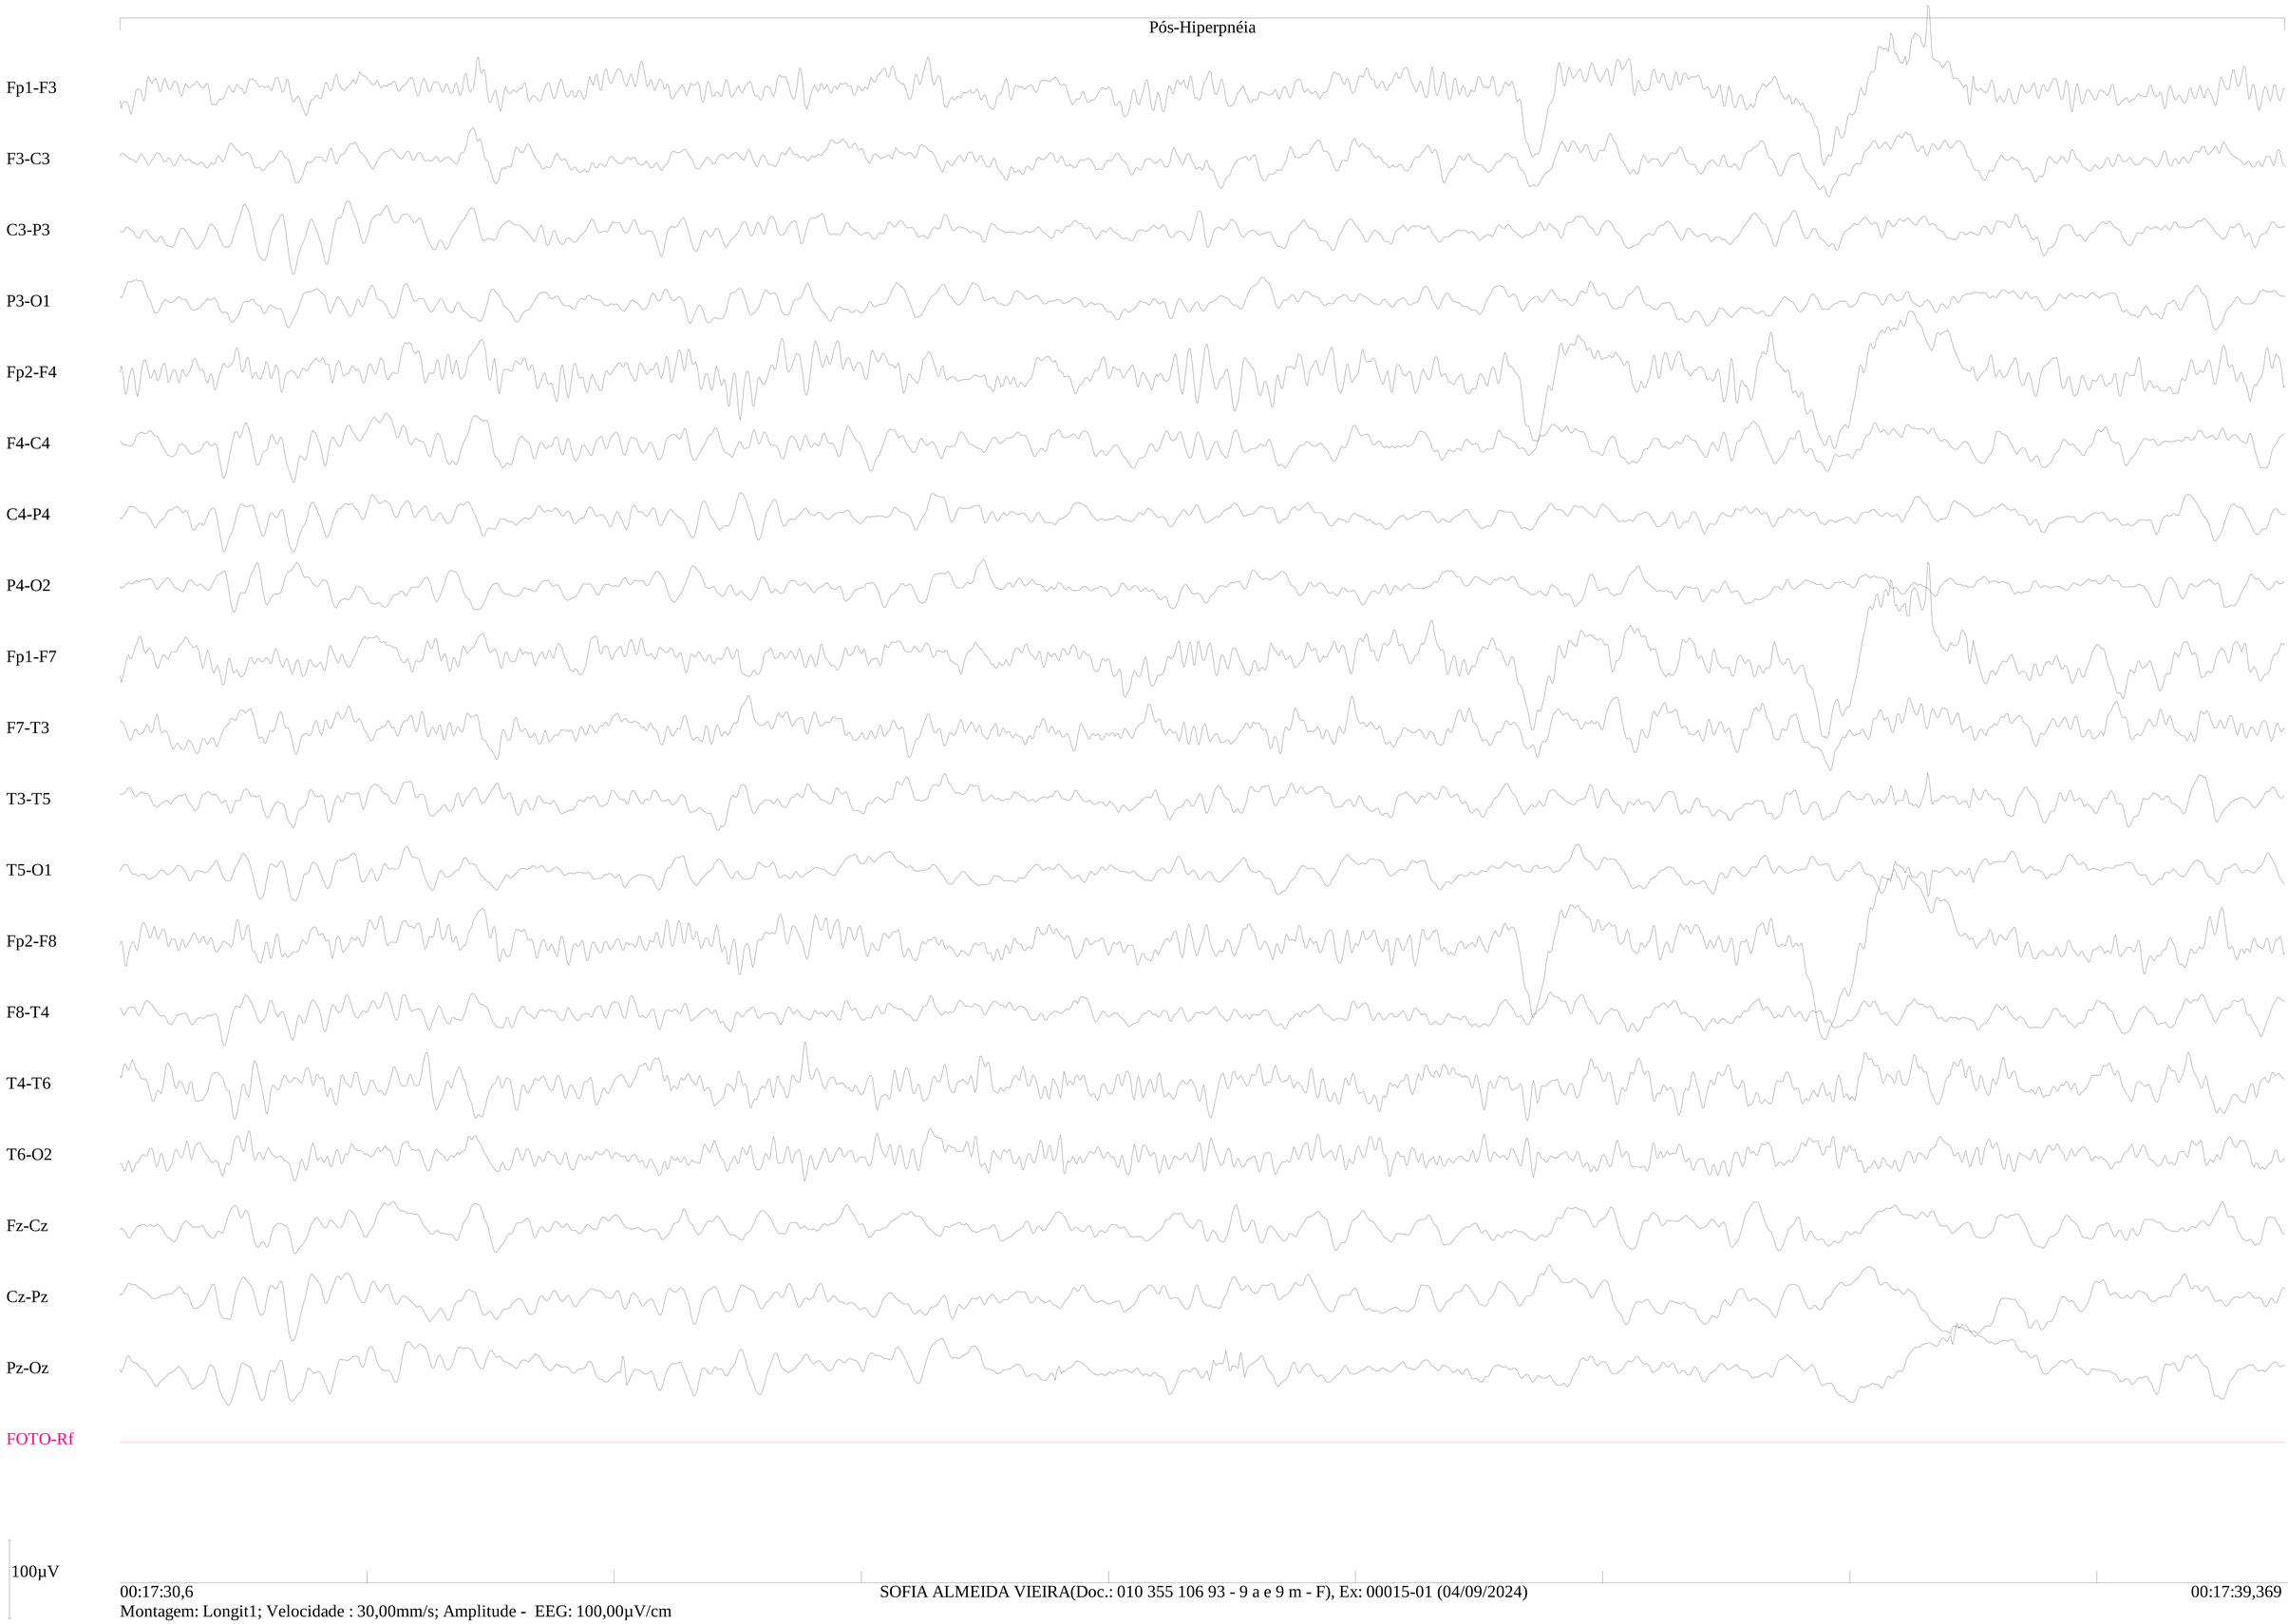
Pós-Hiperpnéia
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fz-Cz
Cz-Pz
Pz-Oz
FOTO-Rf
100µV
00:17:30,6
SOFIA ALMEIDA VIEIRA(Doc.: 010 355 106 93 - 9 a e 9 m - F), Ex: 00015-01 (04/09/2024)
00:17:39,369
Montagem: Longit1; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

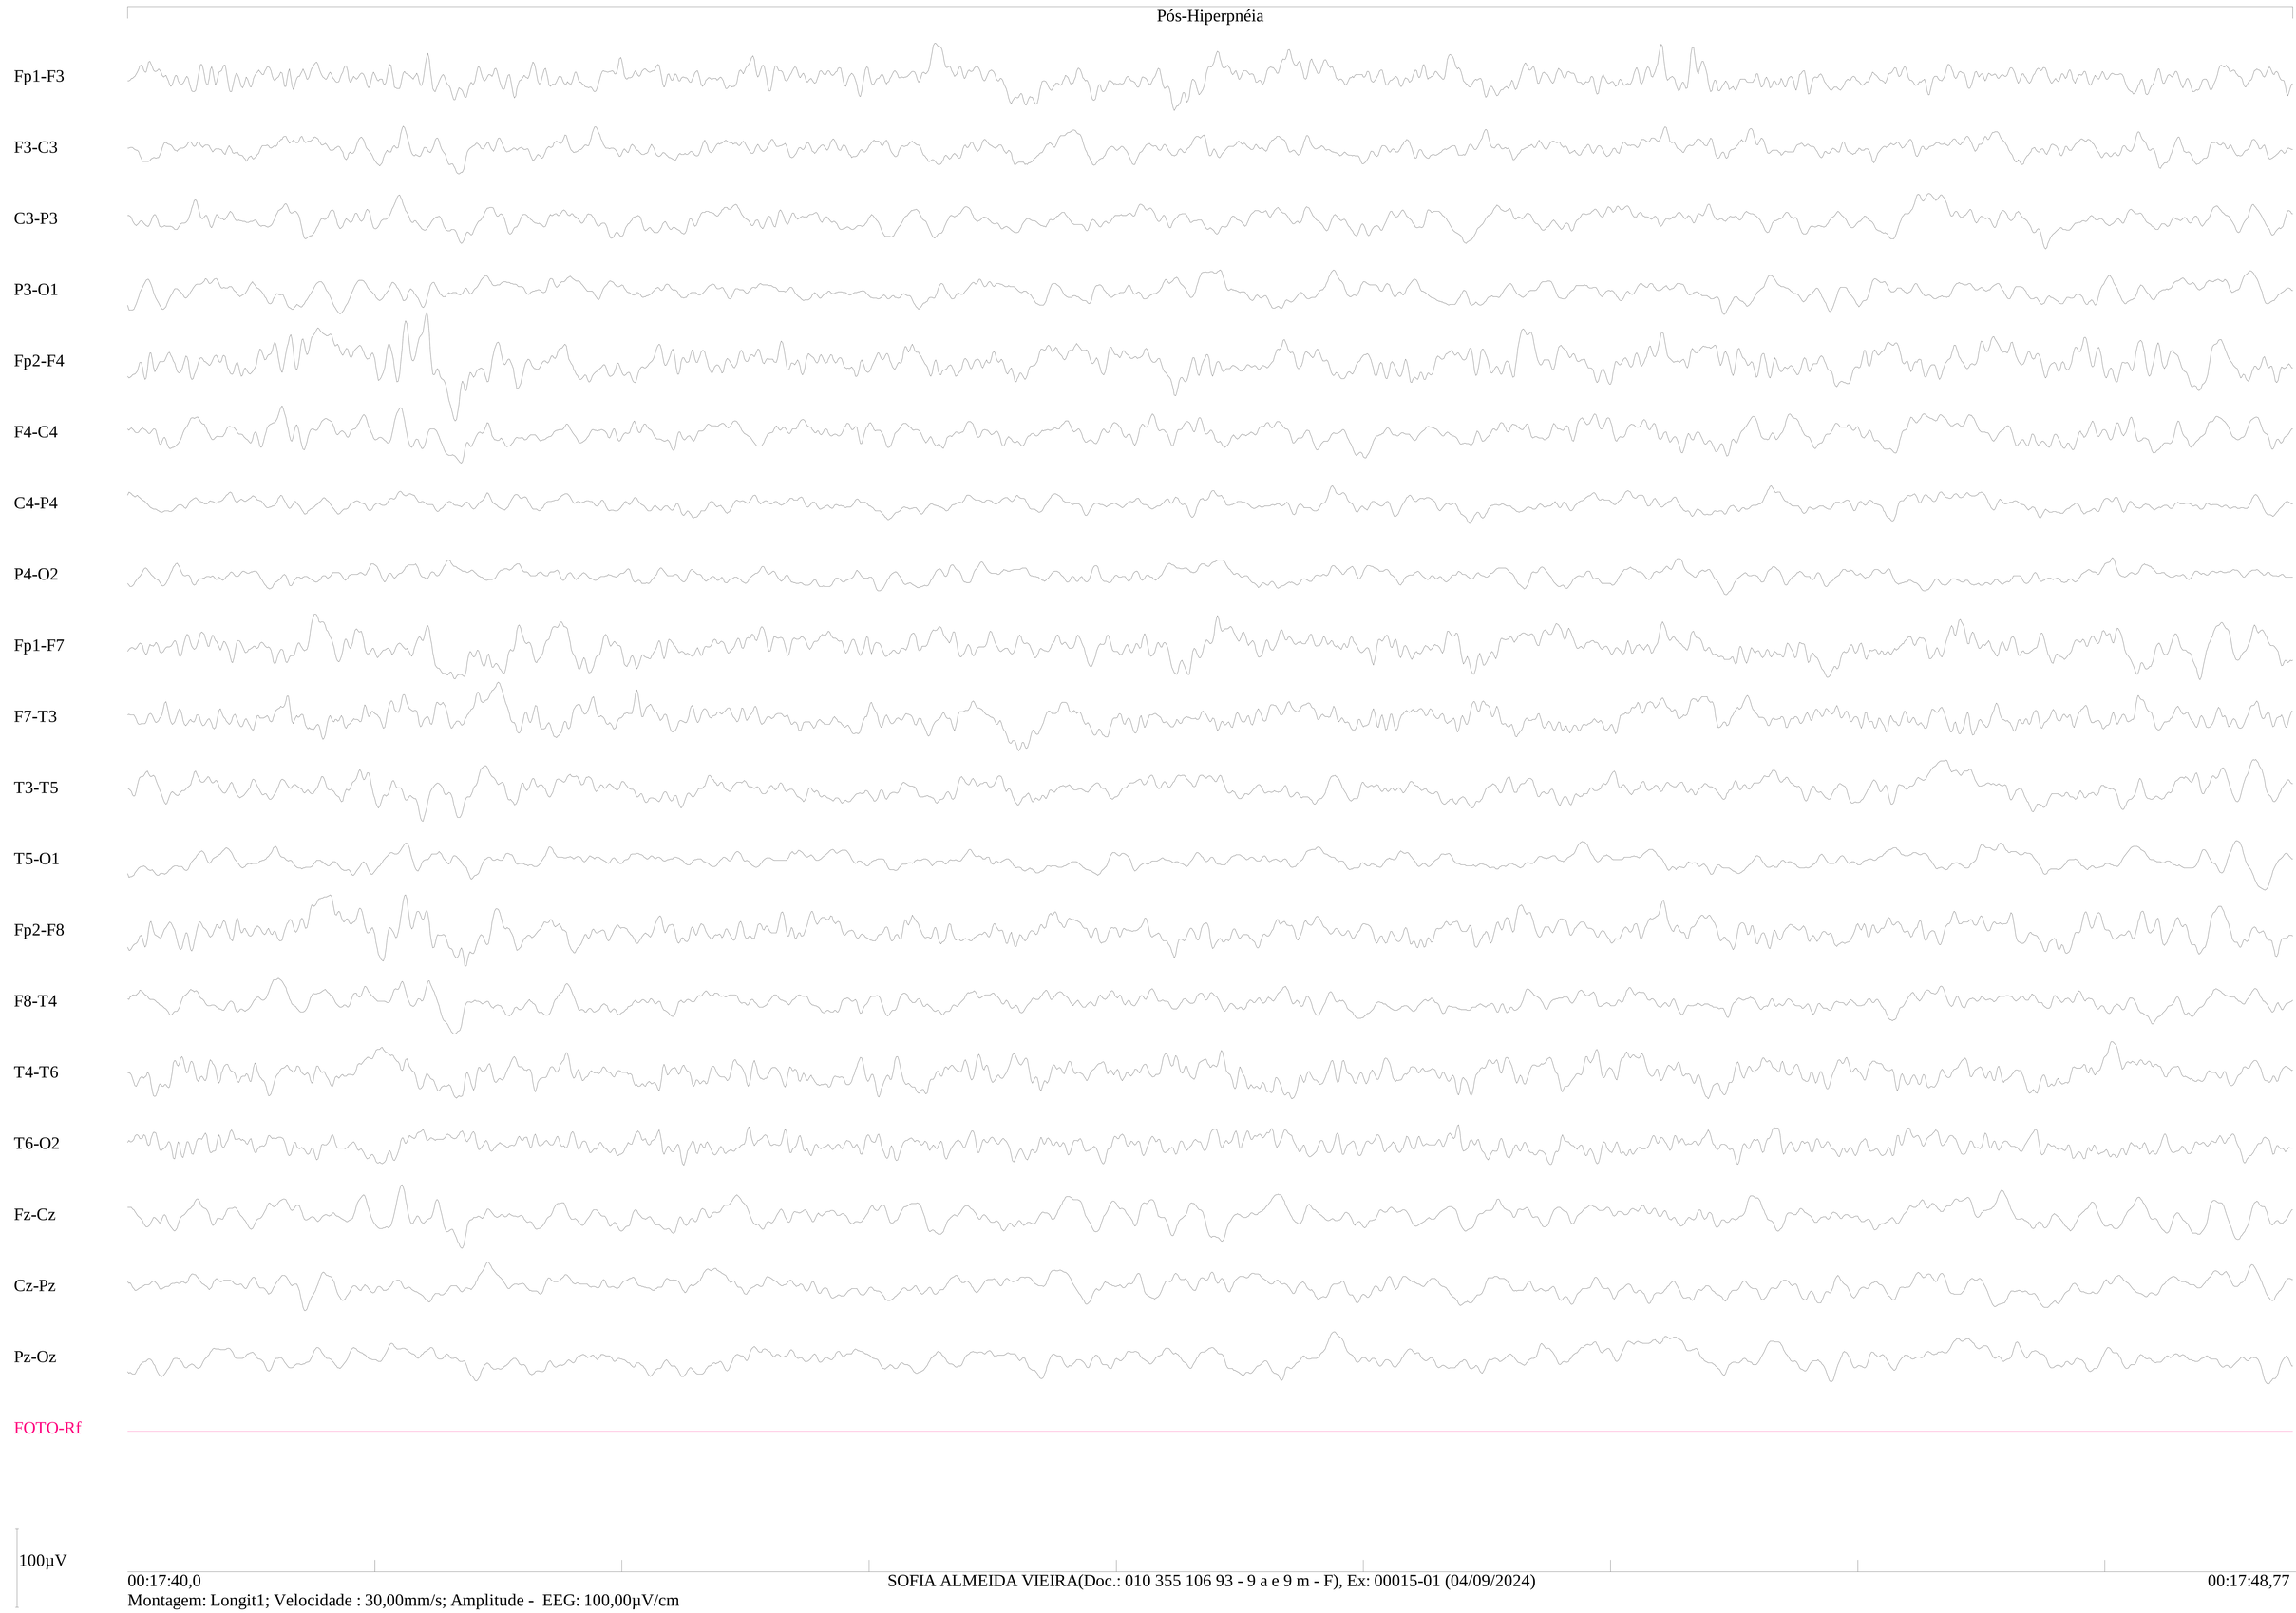
Pós-Hiperpnéia
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fz-Cz
Cz-Pz
Pz-Oz
FOTO-Rf
100µV
00:17:40,0
SOFIA ALMEIDA VIEIRA(Doc.: 010 355 106 93 - 9 a e 9 m - F), Ex: 00015-01 (04/09/2024)
00:17:48,77
Montagem: Longit1; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm